



Digital Blood Pressure Monitor

Model UA-1020

Instruction Manual
Original

ENGLISH

使用手册
翻譯

中文

사용 설명서
번역

한국어

Instruksi Manual
Terjemahan

Bahasa Indonesia

Manual Arahan
Terjemahan

Malay

ទូរអេការិន្យាន
រៀល

ภาษาไทย

Câm nang hướng dẫn
Bản dịch

Tiếng Việt

សេវាការណ៍
ច្បាប់បាត់ប្រា

ភាសាខ្មែរ

Manwal ng Tagubilin
Pagsasalin

Tagalog

Contents

Dear Customers	2
Preliminary Remarks	2
Precautions	2
Contraindications.....	3
Parts Identification.....	4
Symbols.....	5
Operation Mode	7
Using the Monitor	8
Installing / Changing the Batteries	8
Connecting the Air Hose	9
Connecting the AC Adapter.....	9
Adjusting the Built-in Clock	10
Selecting the Correct Cuff Size	11
Applying the Arm Cuff	11
How to Take Accurate Measurements.....	12
Measurement.....	12
After Measurement	12
Measurements	13
Normal Measurement.....	13
Measurement with the SET Pressure	14
Measurement with the Desired Systolic Pressure	14
Notes for Accurate Measurement	15
TriCheck™ Measurement	15
Recalling the Memory Data	17
What Is The IHB/AFib Indicator?	18
What Is The AFib?	18
Pressure Bar Indicator	18
WHO Classification Indicator	18
About Blood Pressure.....	19
What is Blood Pressure?	19
What is Hypertension and How is it Controlled?.....	19
Why Measure Blood Pressure at Home?.....	19
WHO Blood Pressure Classification	19
Blood Pressure Variations.....	19
Troubleshooting	20
Maintenance	21
Technical Data	21

Dear Customers

Congratulations on purchasing a state-of-the-art A&D blood pressure monitor. Designed for ease of use and accuracy, this device will facilitate your daily blood pressure regimen.

We recommend that you read through this manual carefully before using the device for the first time.

Preliminary Remarks

- The device is designed for use on adults, not newborns or infants.
- Environment for use. The device is for use to operate by yourself in the home healthcare environment.
- This device is designed to measure blood pressure and pulse rate of people for diagnosis.

Precautions

- Precision components are used in the construction of this device. Extremes in temperature, humidity, direct sunlight, shock or dust should be avoided.
- Clean the device and cuff with a dry, soft cloth or a cloth dampened with water and a neutral detergent. Never use alcohol, benzene, thinner or other harsh chemicals to clean the device or cuff.
- Avoid tightly folding the cuff or storing the hose tightly twisted for long periods, as such treatment may shorten the life of the components.
- Take care to avoid accidental strangulation of babies or infants with the hose and cable.
- Do not twist the air hose during measurement. This may cause injury due to continuous cuff pressure.
- The device and cuff are not water resistant. Prevent rain, sweat and water from soiling the device and cuff.
- Measurements may be distorted if the device is used close to televisions, microwave ovens, cellular telephones, X-ray or other devices with strong electrical fields.
- Wireless communication devices, such as home networking devices, mobile phones, cordless phones and their base stations, walkie-talkies can affect this blood pressure monitor.
Therefore, a minimum distance of 30 cm should be kept from such devices.
- Used equipment, parts and batteries are not treated as ordinary household waste, and must be disposed of according to the applicable local regulations.
- When the AC adapter is used, make sure that the AC adapter can be readily removed from the electrical outlet when necessary.
- When reusing the device, confirm that the device is clean.
- Do not modify the device. It may cause accidents or damage to the device.


- To measure blood pressure, the arm must be squeezed by the cuff hard enough to temporarily stop blood flow through the artery. This may cause pain, numbness or a temporary red mark to the arm. This condition will appear especially when measurement is repeated successively. Any pain, numbness, or red marks will disappear with time.
- Measuring blood pressure too frequently may cause harm due to blood flow interference. Check that the operation of the device does not result in prolonged impairment of blood circulation, when using the device repeatedly.
- Clinical testing has not been conducted on newborn infants and pregnant woman. Do not use on newborn infants or pregnant woman.
- If you have had a mastectomy, please consult a doctor before using the device.
- Do not let children use the device by themselves and do not use the device in a place within the reach of infants. It may cause accidents or damage.
- There are small parts that may cause a choking hazard if swallowed by mistake by infants.
- Do not touch the batteries, the DC jack and the patient at the same time. That may result in electrical shock.
- Unplug the AC adapter when not in use during the measurement.
- Use of accessories not detailed in this manual may compromise safety.
- Should the battery short-circuit, it may become hot and potentially cause burns.
- Allow the device to adapt to the surrounding environment before use (about one hour).
- Do not inflate without wrapping the cuff around the upper arm.

Contraindications


The following are precautions for proper use of the device.

- Do not apply the cuff to an arm with other medical electrical equipment attached. The equipment may not function properly.
- People who have a severe circulatory deficit in the arm must consult a doctor before using the device, to avoid medical problems.
- Do not self-diagnose the measurement results and start treatment by yourself. Always consult your doctor for evaluation of the results and treatment.
- Do not apply the cuff on an arm with an unhealed wound.
- Do not apply the cuff on an arm receiving an intravenous drip or blood transfusion. It may cause injury or accidents.
- Do not use the device where flammable gases such as anesthetic gases are present. It may cause an explosion.
- Do not use the device in highly concentrated oxygen environments, such as a high-pressure oxygen chamber or an oxygen tent. It may cause a fire or explosion.

Parts Identification

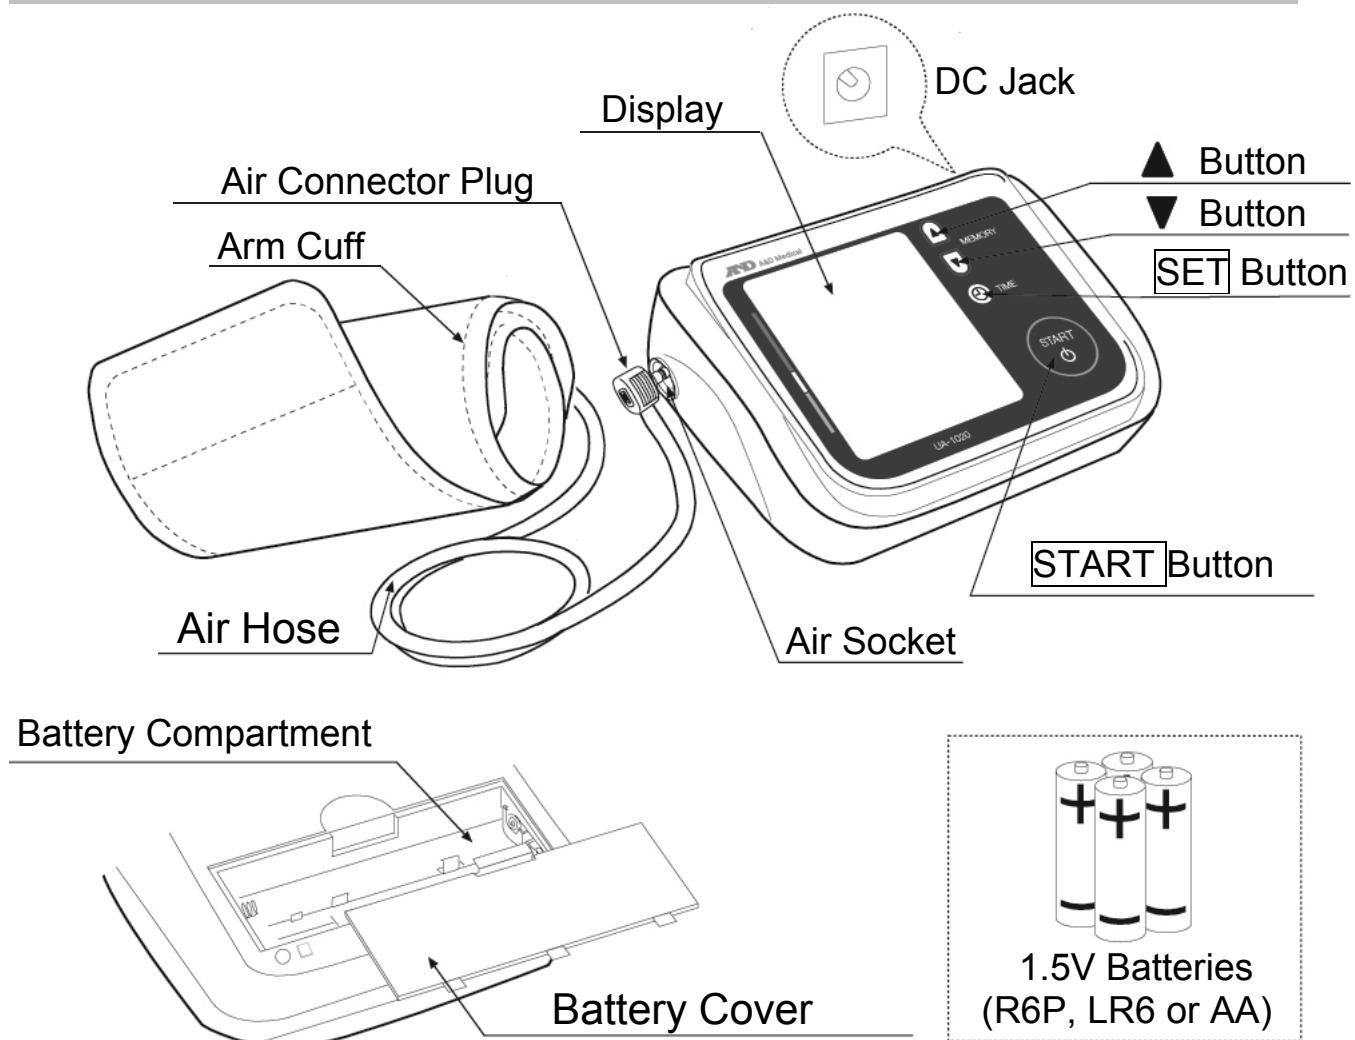

Display

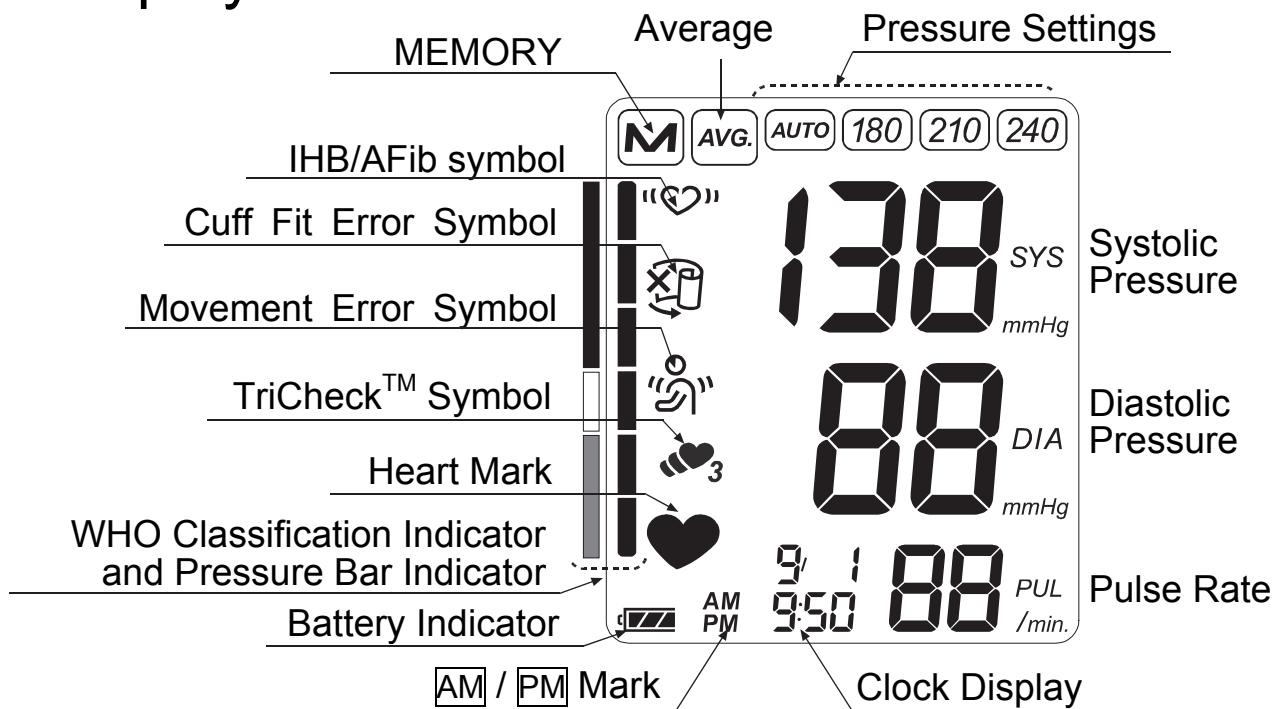

Symbols

Symbols that are printed on the device case

Symbols	Function / Meaning
	Standby and Turn the device on.
	Battery installation guide
	Direct current
SN	Serial number
	Manufacturer
2020	Date of manufacture
	Type BF: Cuff is designed to provide special protection against electrical shocks.
	Used equipment, parts and batteries are not treated as ordinary household waste, and must be disposed of according to the applicable local regulations.
	Refer to instruction manual / booklet
	Polarity of DC jack
IP	International protection symbol
	Keep dry

Symbols that appear on the display

Symbols	Function / Meaning	Recommended Action
	Appears while measurement is in progress. It blinks when the pulse is detected.	Measurement is in progress. Remain as still as possible.
	IHB/AFib symbol Appears when an irregular heartbeat is detected. It may light when a very slight vibration like shivering or shaking is detected.	_____
	TriCheck™ mode Takes three consecutive measurements automatically and displays the average values of the three measurements.	_____
	Appears when a body or arm movement is detected.	The reading may yield an incorrect value. Try the measurement again. Remain still during measurement.

Symbols	Function / Meaning	Recommended Action
	Appears during measurement when the cuff is applied loosely.	The reading may yield an incorrect value. Apply the cuff correctly, and try the measurement again.
	Previous measurements stored in MEMORY.	_____
	Average data	_____
	FULL BATTERY The battery power indicator during measurement.	_____
	LOW BATTERY The battery power is low when it blinks.	Replace all batteries with new ones when the mark blinks.
<i>Err</i>	Unstable blood pressure due to movement during measurement. The systolic and diastolic values are within 10 mmHg of each other. The pressure value did not increase during the inflation.	Try the measurement again. Remain still during measurement. Apply the cuff correctly, and try the measurement again.
<i>Err</i> <i>CUF</i>	The cuff is not applied correctly.	Apply the cuff correctly, and try the measurement again.
<i>E</i>	PUL DISPLAY ERROR The pulse is not detected correctly.	
<i>Err</i> <i>E</i>	Blood pressure monitor internal error	Remove the batteries and press the START button, and then install the batteries again. If the error still appears, contact the dealer.
SYS	Systolic blood pressure in mmHg	_____
DIA	Diastolic blood pressure in mmHg	_____
PUL	Pulse per minute	_____
AM	Appears when the average data is displayed. Data taken between 4:00 and 9:59	_____
PM	Appears when the average data is displayed. Data taken between 18:00 and 1:59	_____
	Pressure settings Indicates the pressure value previously set by the user.	_____

Operation Mode

1. Normal Measurement

Press the **START** button. Blood pressure is measured and the data is stored in memory. This device can store the last 90 measurements in memory.

2. Recalling the Data

Press the **▲** or **▼** button to recall the data in memory. The average of all measurements is displayed, as indicated in the figure at the right.

Then, each time the **▼** button is pressed, the memory data is displayed as follows.


Average of all AM (morning) measurements taken between 4:00 and 9:59.

Average of all PM (evening) measurements taken between 18:00 and 1:59.

Most recent data (No.n, in the example, No.35)


Last data (No.1)

For details on recalling the data, refer to "Recalling the Memory Data".

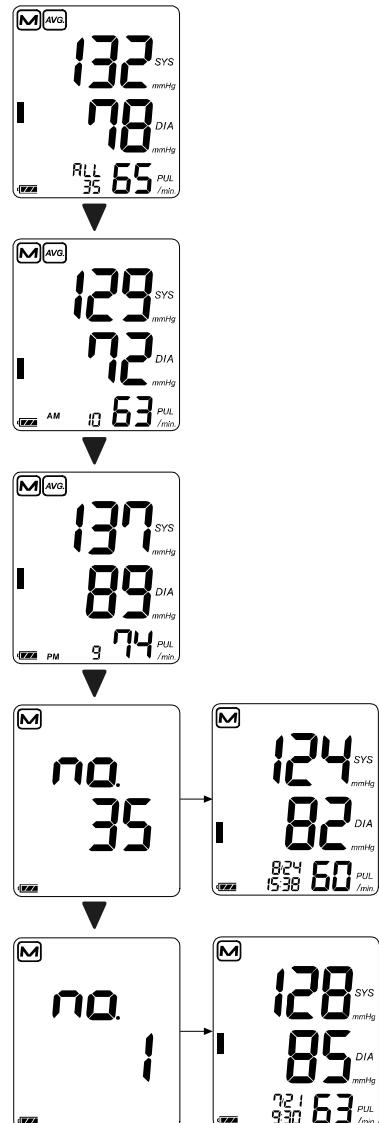

3. Deleting all Data Stored in Memory

Press both the **▲** and **▼** buttons. The **M** mark and the battery indicator appear. Press and hold both the **▲** and **▼** buttons until the illuminated **M** mark starts blinking to delete all data stored in memory.




4. Measurement with the Desired Systolic Pressure

Refer to page 14 for measurement with the desired systolic pressure.

Using the Monitor

Installing / Changing the Batteries

1. Remove the battery cover.
2. Remove the used batteries and insert new batteries into the battery compartment as shown, taking care that the polarities (+ and -) are correct.
Use only R6P, LR6 or AA batteries.
3. Attach the battery cover.

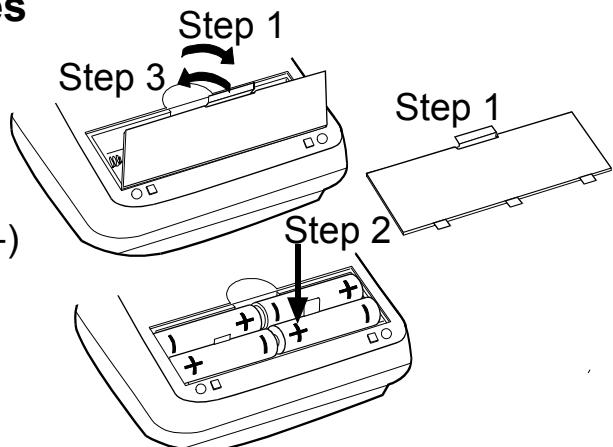


CAUTION

- Insert the batteries as shown in the battery compartment. If installed incorrectly, the device will not work.
- When  (LOW BATTERY mark) blinks on the display, replace all batteries with new ones. Do not mix old and new batteries. It may shorten the battery life, or cause the device to malfunction.
Replace the batteries two seconds or more after the device turns off.
If  (LOW BATTERY mark) appears even after the batteries are replaced, make a blood pressure measurement. The device may then recognize the new batteries.
-  (LOW BATTERY mark) does not appear when the batteries are drained.
- The battery life varies with the ambient temperature and may be shorter at low temperatures. Generally, four new LR6 batteries will last approximately for one year when used twice for measurement each day.
- Use the specified batteries only. The batteries provided with the device are for testing monitor performance and may have a limited life.
- Remove the batteries if the device is not to be used for a long time.
The batteries may leak and cause a malfunction.

Using the Monitor

Connecting the Air Hose


Insert the air connector plug into the air socket firmly.

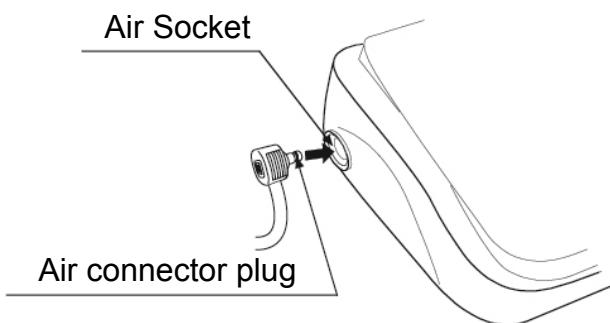

Connecting the AC Adapter

Insert the AC adapter plug into the DC jack.

Next, connect the AC adapter to an electrical outlet.

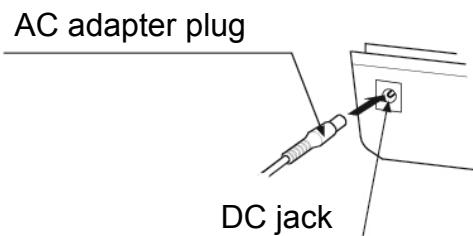

- Use the specified AC adapter.
(Refer to page 22.)
- When disconnecting the AC adapter from the electrical outlet, grasp and pull the AC adapter body out of the outlet.
- When disconnecting the AC adapter plug from the blood pressure monitor, grasp and pull the AC adapter plug out of the monitor.

Using the Monitor

Adjusting the Built-in Clock

Adjust the clock prior to use.

1. Press the **SET** button until the year starts blinking.
2. Select the year using the **▲** or **▼** button.
Press the **SET** button to set the current year and move to month/day selection. The date can be set anywhere between the years 2010 and 2059.
3. Select the month using the **▲** or **▼** button.
Press the **SET** button to set the current month and move to day selection.
4. Select the day using the **▲** or **▼** button.
Press the **SET** button to set the current day and move to hour/minute selection.
5. Select the hour using the **▲** or **▼** button.
Press the **SET** button to set the current hour and move to minute selection.
6. Select the minute using the **▲** or **▼** button.
(Press the **SET** button to go to the pressure setting mode. For details, refer to page 14.)
Press the **START** button to turn the device off.

Note: After three minutes of non-operation, the device will turn off automatically.


When the clock has not been set, the clock display indicates dashes as shown to the right.

When using the device for the first time, the clock is not adjusted.

When the device is disconnected from the power supply for more than 30 seconds, the set date, time and pressure value will be erased.

When the set date, time and pressure value are erased, please adjust again.

- Holding down the **▲** or **▼** button will change the value continuously.

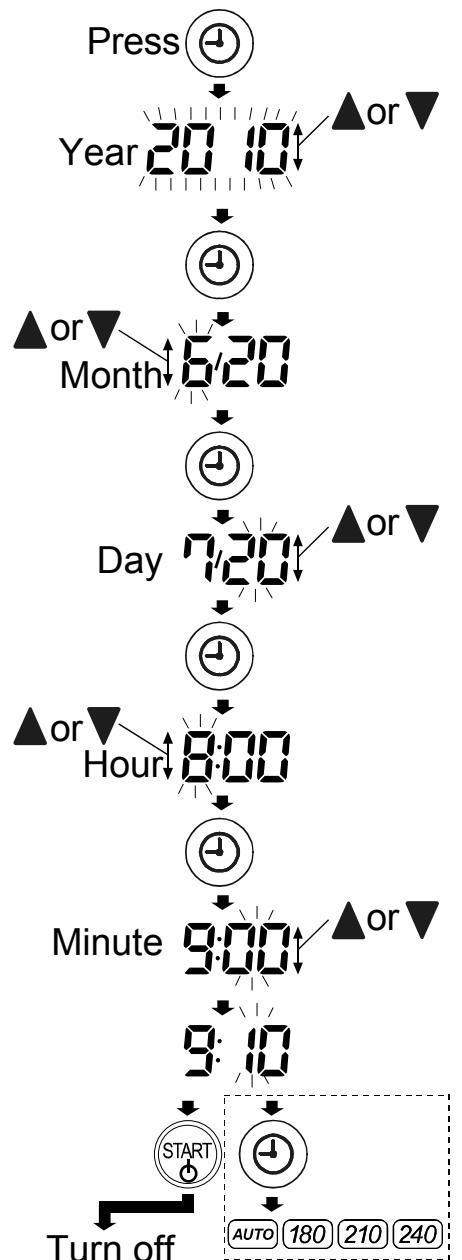

Pressing the **START** button will turn the device off anytime.

Pressure setting mode

Using the Monitor

Selecting the Correct Cuff Size

Using the correct cuff size is important for an accurate reading. If the cuff is not the proper size, the reading may yield an incorrect blood pressure value.


- The arm size is printed on each cuff.
- The arm cuff is a consumable. If it becomes worn, purchase a new one.

Arm Size	Recommended Cuff Size	Catalog Number
31 cm to 45 cm	Large Adult cuff	CUF-D-LA-ISO
22 cm to 42 cm	Wide range cuff	CUF-I-ISO
23 cm to 37 cm	Semi Large cuff	CUF-D-MA-ISO
22 cm to 32 cm	Adult cuff	CUF-F-A-ISO
16 cm to 24 cm	Small cuff	CUF-D-SA-ISO
17 cm to 32 cm	SmoothFit Adult cuff	CUF-G-A-ISO

Arm size: The circumference of the biceps.

Applying the Arm Cuff

1. Wrap the cuff around the upper arm, about 1-2 cm above the inside of the elbow, as shown. Place the cuff directly against the skin, as clothing may cause a faint pulse, and result in a measurement error.
2. Constriction of the upper arm, caused by tightly rolling up a shirtsleeve, may prevent accurate readings.

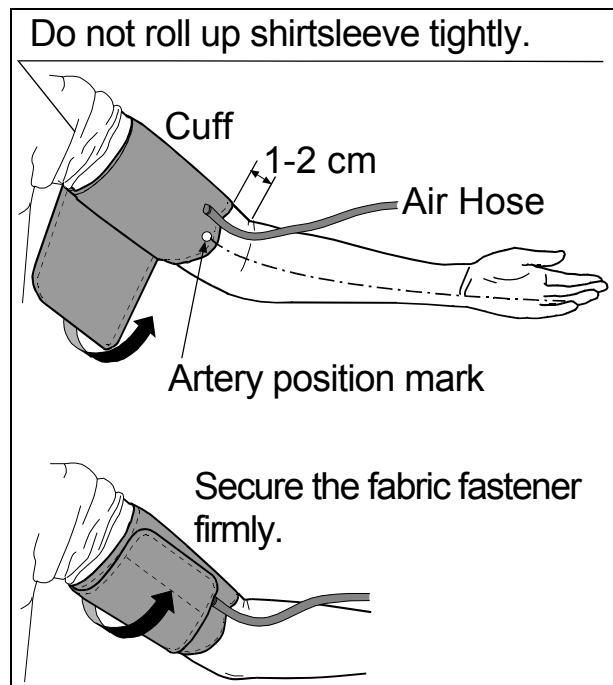

Symbols that are printed on the cuff

Symbols	Function/Meaning	Recommended Action
●	Artery Position Mark	Set the ● mark on the artery of the upper arm or in line with the ring finger on the inside of the arm.
[REF]	Catalog Number	_____
[LOT]	Lot Number	_____
[Mfg]	Manufacture	_____
[MD]	Medical Device	_____

Using the Monitor

How to Take Accurate Measurements

For the most accurate blood pressure measurement:

- Sit comfortably on a chair. Rest your arm on the table. Do not cross your legs. Keep your feet flat on the floor and straighten your back.
- Relax for about five to ten minutes before measurement.
- Place the center of the cuff at the same level as your heart.
- Remain still and keep quiet during measurement.
- Do not measure immediately after physical exercise or a bath. Rest for twenty or thirty minutes before taking the measurement.
- Try to measure your blood pressure at the same time every day.

Measurement

During measurement, it is normal for the cuff to feel very tight. (Do not be alarmed).

After Measurement

After measurement, press the **START** button to turn the device off.

Remove the cuff and record your data.

Note: The device has an automatic power shut-off function, which turns the device off approximately one minute after measurement.

Allow at least three minutes between measurements on the same person.


Measurements

Before measurement, refer to “Notes for Accurate Measurement” on page 15.

Normal Measurement

1. Place the cuff on the arm (preferably the left arm). Sit quietly during measurement.

At heart level



2. Press the **START** button.

All of the display segments are displayed.

Zero (0) is displayed blinking briefly.

The display changes, as indicated in the figure at the right, as the measurement begins. The cuff starts to inflate. It is normal for the cuff to feel very tight. A pressure bar indicator is displayed, on the left edge of the display, during the inflation.


Note: If you wish to stop inflation at any time, press the **START** button again.

Press



All of the display segments displayed

Zero display
Starts inflation



Pressurizing



Measurement in progress




Systolic pressure

Diastolic pressure

WHO classification

Pulse rate



Exhausts remaining air automatically

3. When inflation is complete, deflation starts automatically and **♥** (heart mark) blinks, indicating that the measurement is in progress. Once the pulse is detected, the mark blinks with each pulse beat.

Note: If an appropriate pressure is not obtained, the device starts to inflate again automatically. To avoid re-inflation, refer to “Measurement with the SET Pressure” on the next page.

4. When the measurement is complete, the systolic and diastolic pressure readings and pulse rate are displayed. The cuff exhausts the remaining air and deflates completely.

5. Press the **START** button to turn the device off. After one minute of non-operation, the device will turn off automatically.

Note: Allow at least three minutes between measurements on the same person.

Measurements

The UA-1020 is designed to detect the pulse and to inflate the cuff to a systolic pressure level automatically.


If re-inflation occurs repeatedly, use the following methods.

Measurement with the SET Pressure

During the blood pressure measurement, re-inflation may occur.


A fixed pressure value can be set to avoid re-inflation.

- At step 6 of the clock adjustment procedure (refer to page 10), press the **SET** button to go to the pressure setting mode. The current setting blinks.

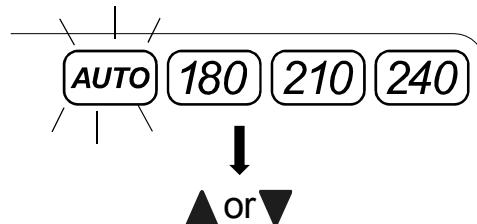

- Press the **▲** or **▼** button to select a pressure value about 30 mmHg or more above your expected systolic pressure from the following.

AUTO : Automatic pressurization (default value)
180 : Pressure value of 180 mmHg (fixed)
210 : Pressure value of 210 mmHg (fixed)
240 : Pressure value of 240 mmHg (fixed)

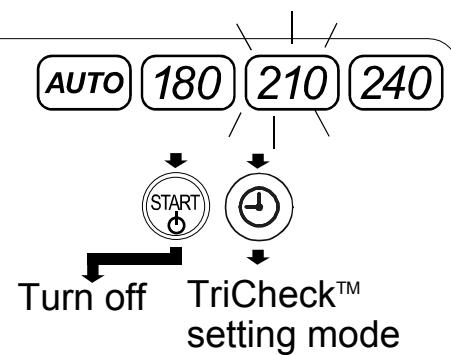


- Press the **SET** button to go to the TriCheck™ setting mode.
Press the **START** button to turn the device off. After three minutes of non-operation, the device will turn off automatically.
The next measurement will be performed with the new pressure value.

Measurement with the Desired Systolic Pressure

Use this method when re-inflation occurs repeatedly even if the pressure value is set to **240** in the procedure above or when the results are not displayed even if the pressure decreases to 20 mmHg or less.

- Place the cuff on the arm (preferably the left arm). At heart level



- Press and hold the **START** button until a number about 30 to 40 mmHg higher than your expected systolic pressure appears.

Press and hold the button

Release the button
at the desired
systolic pressure



- When the desired number is reached, release the **START** button to start measurement. Continue to measure your blood pressure as described on the previous page.

Refer to the previous page
for measurement

Notes for Accurate Measurement

- Sit down in a comfortable position. Place your arm on a table with your palm facing upward and the cuff at the same level as your heart.
- Relax for about five to ten minutes before taking a measurement. If you are excited or depressed by emotional stress, the measurement will reflect this stress as a higher (or lower) than normal blood pressure reading and the pulse reading will usually be faster than normal.
- An individual's blood pressure varies constantly, depending on what you are doing and what you have eaten. What you drink can have a very strong and rapid effect on your blood pressure.
- This device bases its measurements on the heartbeat. If you have a very weak or irregular heartbeat, the device may have difficulty determining your blood pressure.
- Should the device detect a condition that is abnormal, it will stop the measurement and display an error symbol. Refer to page 6 for the description of symbols.
- This device is intended for use by adults. Consult with your physician before using this device on a child. A child should not use this device unattended.
- The automatic blood pressure monitor's performance may be affected by excessive temperature or humidity, or altitude.

TriCheck™ Measurement


The TriCheck™ mode takes three consecutive measurements automatically and displays the average values of the three measurements.

Selecting the TriCheck™ Mode

1. In the pressure setting mode, press the **SET** button to enter the TriCheck™ setting mode. The current setting blinks.
2. Press the **▲** or **▼** button to turn the TriCheck™ mode ON or OFF.
ON: TriCheck™ mode
OFF: Normal measurement mode (default value)
3. Press the **START** or **SET** button to turn the device off. After three minutes of non-operation, the device will turn off automatically.

In the pressure setting mode,


Press 



The current setting blinks


▲ or **▼**

Change the setting



Measurement Using the TriCheck™ Mode

1. Press the **START** button.
All of the display segments are displayed.
Zero (0) is displayed blinking briefly and the first measurement starts.
2. When the measurement is complete, the systolic and diastolic pressure readings and pulse rate are displayed, then a one-minute countdown starts for the second measurement.
3. After one minute, the second measurement starts.
4. When the measurement is complete, the average readings of the first and second measurements are displayed, then a one-minute countdown starts for the third measurement.
5. After one minute, the third measurement starts.
6. When the measurement is complete, the average readings of the three measurements are displayed and stored in memory.

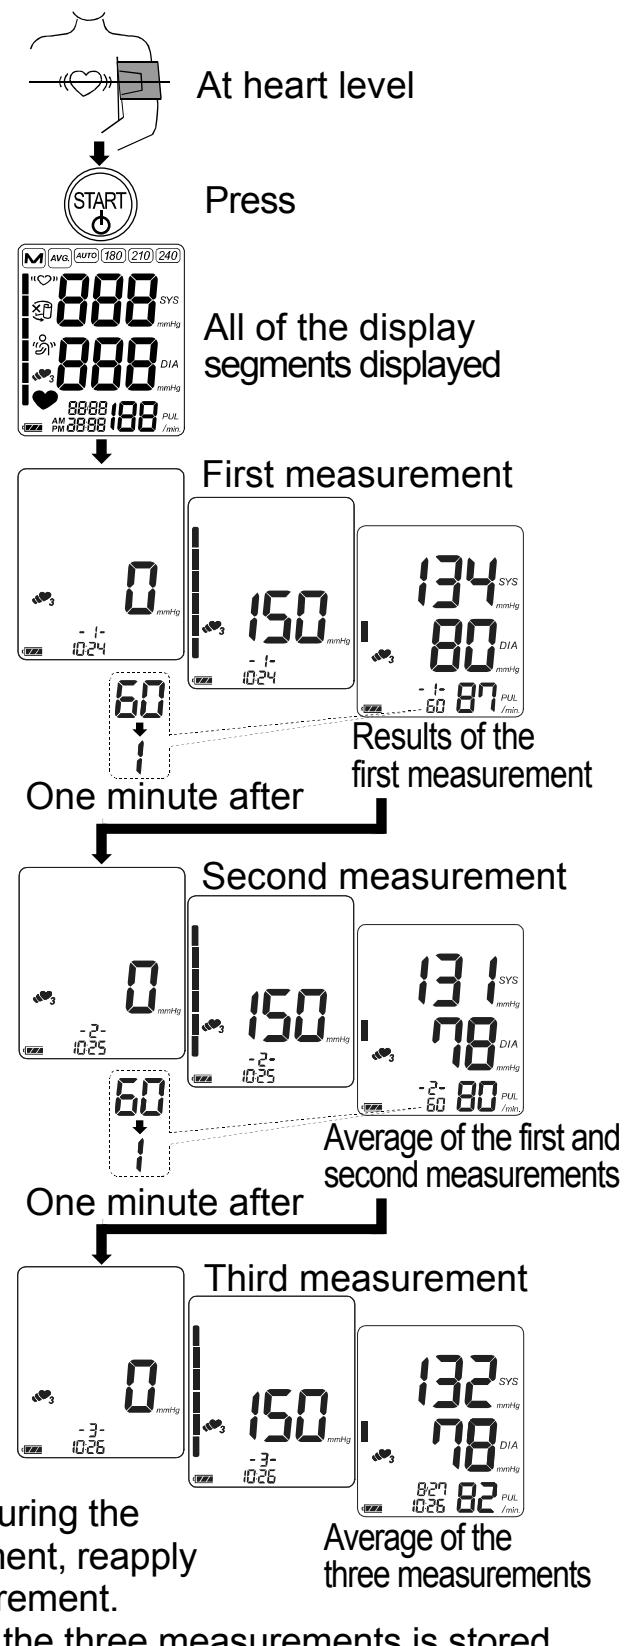

Notes:

- During the measurement, the TriCheck™ symbol is displayed.
 - To cancel the measurement, press the **START** button. In this case, no data is stored in memory.
 - When the cuff fit error symbol appears during the first measurement, cancel the measurement, reapply the cuff correctly and start a new measurement.
 - After measurement, the average data of the three measurements is stored in memory.
- No data will be stored, when canceling the measurements, before completion of the third measurement.

Recalling the Memory Data

Note: This device stores the last 90 measurements in memory.

1. Press the ▲ or ▼ button.
The average of all measurements and the number of data are displayed.
(If no data, "0" is displayed. Press the ▲, ▼ or START button to turn the device off.)
2. Each time the ▼ button (or the ▲ button to display the data in the reverse order) is pressed, the memory data is displayed as follows.


Average of all AM (morning) measurements taken between 4:00 and 9:59.
(In the example, 10 measurements.
If no data, "--" is displayed.)

Average of all PM (evening) measurements taken between 18:00 and 1:59.
(In the example, 9 measurements.
If no data, "--" is displayed.)

Most recent data (No.n, in the example, No.35)
Three seconds after the data number display, the measurement data is displayed.

⋮

Last data (No.1)
Three seconds after the data number display, the measurement data is displayed.
3. After the last data is displayed, press the ▼ button to return the average display of all measurements.
4. Press the START button to turn the device off. After one minute of non-operation, the device will turn off automatically.

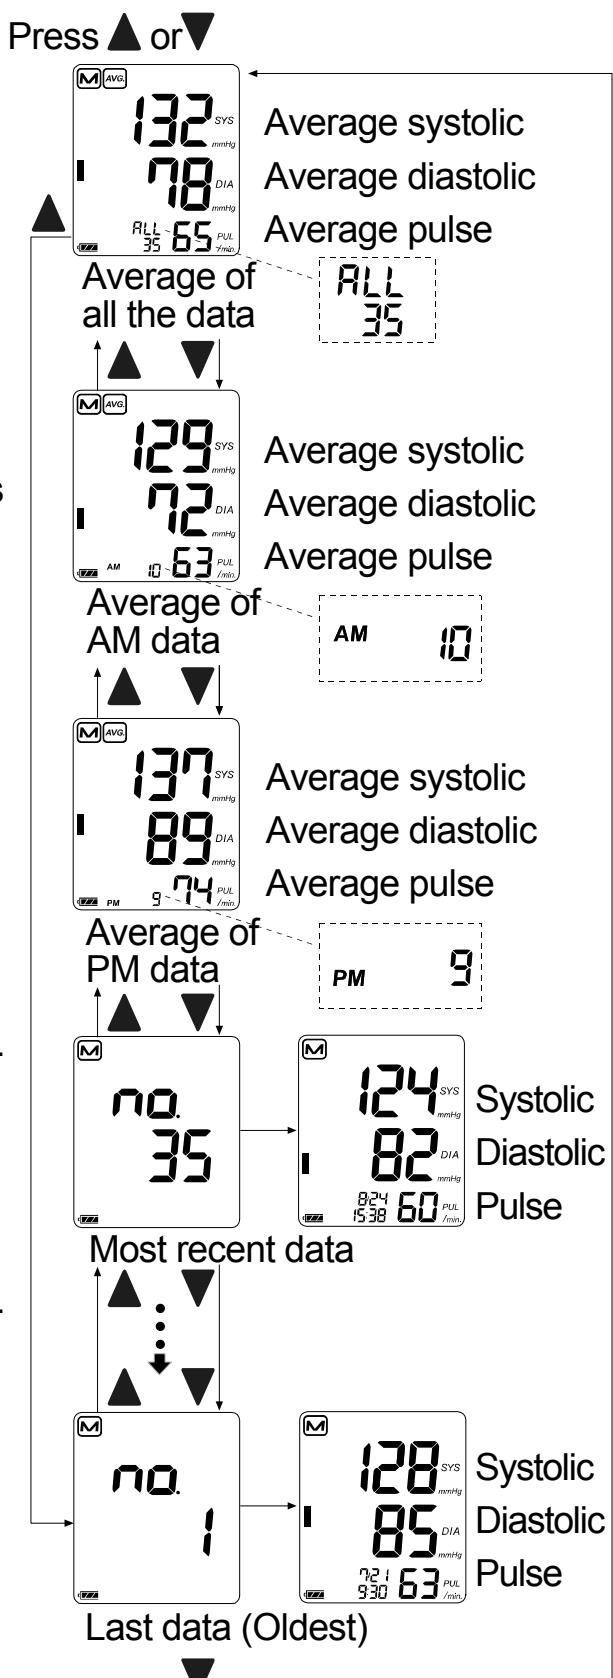

What Is The IHB/AFib Indicator?

When the monitor detects an irregular rhythm during the measurements, the IHB/AFib indicator will appear on the display with the measurement values.


Note: We recommend contacting your physician if you see this (♥) IHB/AFib indicator frequently.

What Is The AFib?

The heart contracts due to electrical signals occurring in heart and sends blood through the body. Atrial fibrillation (AFib) occurs when the electrical signal in the atrium becomes confused and leads to disturbances in the pulse interval. AFib can cause blood to stagnate in the heart, which can easily create clots of blood, a cause of stroke and heart attack.

Pressure Bar Indicator

The indicator monitors the progress of pressure during measurement.

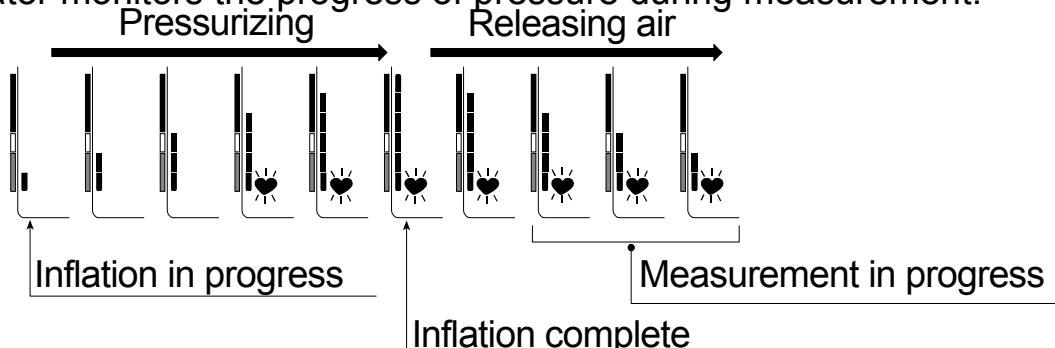

WHO Classification Indicator

Each segment of the bar indicator corresponds to the WHO blood pressure classification described on the next page.

WHO Classification Indicator

- Severe hypertension
- Moderate hypertension
- Mild hypertension
- High normal
- Normal
- Optimal

- : The indicator displays a segment, based on the current data, corresponding to the WHO classification.

Example:



Moderate hypertension



Mild hypertension



High normal

About Blood Pressure

What is Blood Pressure?

Blood pressure is the force exerted by blood against the walls of the arteries. Systolic pressure occurs when the heart contracts. Diastolic pressure occurs when the heart expands. Blood pressure is measured in millimeters of mercury (mmHg). One's natural blood pressure is represented by the fundamental pressure, which is measured first thing in the morning while one is still at rest and before eating.

What is Hypertension and How is it Controlled?

Hypertension, an abnormally high arterial blood pressure, if left unattended, can cause many health problems including stroke and heart attack. Hypertension can be controlled by altering lifestyle, avoiding stress, and with medication under a doctor's supervision.

To prevent hypertension or keep it under control:


- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Do not smoke | <input type="checkbox"/> Exercise regularly |
| <input type="checkbox"/> Reduce salt and fat intake | <input type="checkbox"/> Have regular physical checkups |
| <input type="checkbox"/> Maintain proper weight | |

Why Measure Blood Pressure at Home?

Blood pressure measured at a clinic or doctor's office may cause apprehension and can produce an elevated reading, 25 to 30 mmHg higher than that measured at home. Home measurement reduces the effects of outside influences on blood pressure readings, supplements the doctor's readings and provides a more accurate, complete blood pressure history.

WHO Blood Pressure Classification


Standards to assess high blood pressure, without regard to age, have been established by the World Health Organization (WHO), as shown in the chart.

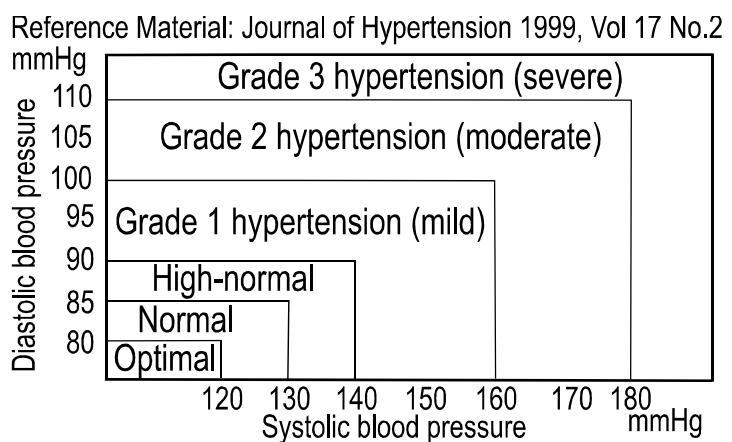

Blood Pressure Variations

An individual's blood pressure varies greatly on a daily and seasonal basis. It may vary by 30 to 50 mmHg due to various conditions during the day. In hypertensive individuals, variations are even more pronounced. Normally, the blood pressure rises while at work or play and falls to its lowest levels during sleep. So, do not be overly concerned by the results of one measurement.

Take measurements at the same time every day using the procedure described in this manual to get to know your normal blood pressure. Regular readings give a more comprehensive blood pressure history. Be sure to note the date and time when recording your blood pressure. Consult your doctor to interpret your blood pressure data.

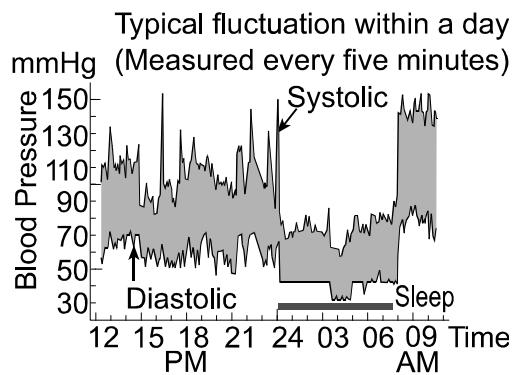

Troubleshooting

Problem	Possible Reason	Recommended Action
Nothing appears on the display, even when the device is turned on.	Batteries are drained. Battery terminals are not in the correct position.	Replace all batteries with new ones. Reinstall the batteries with negative and positive terminals matching those indicated on the battery compartment.
The cuff does not inflate.	Battery voltage is too low.  (LOW BATTERY mark) blinks. If the batteries are drained completely, the mark does not appear.	Replace all batteries with new ones.
The device does not measure. Readings are too high or too low.	The cuff is not applied properly. You moved your arm or body during measurement. The cuff position is not correct. _____	Apply the cuff correctly. Make sure you remain still and quiet during measurement. Sit comfortably and still. Place your arm on a table with your palm facing upward and the cuff at the same level as your heart. If you have a very weak or irregular heartbeat, the device may have difficulty in determining your blood pressure.
Other	The value is different from that measured at a clinic or doctor's office. _____	Refer to "Why Measure Blood Pressure at Home?". Remove the batteries. Place them back properly and try the measurement again.

Note: If the actions described above do not solve the problem, contact the dealer. Do not attempt to open or repair this product, as any attempt to do so will make your warranty invalid.

Maintenance

Do not open the device. It uses delicate electrical components and an intricate air unit that could be damaged. If you cannot fix the problem using the troubleshooting instructions, contact the authorized dealer in your area or our customer service department. The A&D customer service will provide technical information, spare parts and units to authorized dealers.

The device was designed and manufactured for a long service life. However it is generally recommended to have the device inspected every 2 years, to ensure proper functioning and accuracy. Please contact the authorized dealer in your area or A&D for maintenance.

Technical Data

Type	UA-1020
Measurement method	Oscillometric measurement
Measurement range	Pressure: 0 - 299 mmHg Systolic pressure: 60 - 279 mmHg Diastolic pressure: 40 - 200 mmHg Pulse: 40 - 180 beats / minute
Measurement accuracy	Pressure: ± 3 mmHg Pulse: ± 5 %
Rating range	DC 6V 3W
Power supply	4 x 1.5V batteries (R6P, LR6 or AA) or AC adapter (TB-233C INPUT: AC 100 – 240V 50 / 60 Hz 0.15A) (Not included)
Number of measurements	Approx. 1000 measurements, when AA alkaline batteries are used, with pressure value of 180 mmHg at room temperature of 23°C
Classification	Internally powered ME equipment (Supplied by batteries) / Class II (Supplied by adapter) Continuous operation mode
Clinical test	According to ISO81060-2 : 2013 In the clinical validation study, K5 was used on 85 subjects for determination of diastolic blood pressure.
EMD	IEC 60601-1-2: 2014

Memory	Last 90 measurements
Operating condition	+10 to +40 °C / 15 to 85 %RH / 800 to 1060 hPa
Transport / Storage conditions	-20 to +60 °C / 10 to 95 %RH / 700 to 1060 hPa
Dimensions	Approx. 140 [W] x 60 [H] x 105 [D] mm
Weight	Approx. 285 g, excluding the batteries
Ingress protection	Device: IP20
Applied part	Cuff Type BF 
Useful life	Device: 5 years (when used six times a day) Cuff: 2 years (when used six times a day) AC adapter: 5 years (when used six times a day)

Accessory AC adapter	The adapter is to connect the blood pressure monitor to a power source at home.
TB-233C	Please contact your local A&D dealer for purchasing. The AC adapter is required to be inspected or replaced periodically.

Symbols that are printed on the AC adapter

Symbols	Function / Meaning
	For indoor use only
	Class II device
	Thermal fuse
	Fuse
	EC directive device label
	EAC certification device label
	Polarity of AC adapter plug

Accessories sold separately

Cuff

Catalog Number	Cuff Size	Arm Size
CUF-D-LA-ISO	Large Adult cuff	31 cm to 45 cm
CUF-I-ISO	Wide range cuff	22 cm to 42 cm
CUF-D-MA-ISO	Semi Large cuff	23 cm to 37 cm
CUF-F-A-ISO	Adult cuff	22 cm to 32 cm
CUF-D-SA -ISO	Small cuff	16 cm to 24 cm
CUF-G-A-ISO	SmoothFit Adult cuff	17 cm to 32 cm

AC adapter

Catalog Number	Plug (Outlet type)
TB-233C	Type C

Note: Specifications are subject to change without prior notice.

IP classification is the degrees of protection provided by enclosures in accordance with IEC 60529. This device is protected against solid foreign objects of 12 mm diameter and greater such as a finger. This device is not protected against water.

MEMO

目錄

親愛的顧客.....	3
使用前注意事項	3
用前須知	3
禁忌	4
零件說明.....	5
符號	6
操作模式.....	8
1.正常測量	8
2.查閱數據	8
3.刪除所有已儲存的資料	8
4.以合理的收縮壓測量	8
使用血壓計.....	9
安裝/更換電池	9
使用血壓計.....	10
連接充氣軟管	10
連接交流電轉接器	10
使用血壓計.....	11
調整內建時鐘	11
使用血壓計.....	12
選擇合適的袖帶 尺寸	12
套上手臂袖帶	12
使用血壓計.....	13
如何進行精確測量	13
測量	13
測量後	13
測量	14
正確測量	14
測量	15
以設定的血壓測量	15
以合理的收縮壓測量	15
正確測量的注意事項	16
TriCheck™ 測量	16
選用 TriCheck™ 模式	16
使用 TriCheck™ 模式測量	17
查閱數據	18
什麼是心律不整/心房顫動 (IHB/AFib) 指示燈？	19
什麼是心房顫動 (AFib) ?	19
血壓柱指示燈	19
WHO 分類指示燈	19
關於血壓	20
什麼是血壓？	20
什麼是高血壓及如何控制？	20
為什麼在家測量血壓？	20
WHO 血壓分類	20

血壓變化	20
疑難排解	21
維護保養	22
技術資料	22

親愛的顧客

多謝選購 A&D 高科技電子血壓計，這款血壓計是目前市場上最先進的血壓計之一。本血壓計不僅易於使用，而且十分精準，將成為您每日血壓管理的最佳助手。

建議您在首次使用血壓計之前仔細閱讀本手冊。

使用前注意事項

- 本血壓計僅適用於成年人，請勿用於新生兒或嬰幼兒。
- 使用環境：本血壓計適合在家庭照護環境下自行使用。
- 本血壓計適用於測量血壓和脈搏，以作診斷之用。

用前須知

- 本血壓計採用精密部件製造。請勿曝露於極端溫度、高濕、陽光直射、震盪或多塵環境下。
- 清潔血壓計及袖帶時，請使用乾軟布或蘸水及中性洗滌劑的布。請勿使用酒精、苯、稀釋劑或其他刺激性化學品清潔血壓計及袖帶。
- 請避免長期間過度用力折疊袖帶或在軟管緊緊彎曲狀態下存放裝置，否則可能損壞相關部件。
- 使用軟管及連接線時請務必當心，以免發生意外勒殺嬰兒或幼兒事故。
- 測量過程中請勿扭擰充氣軟管，否則可能因為持續的袖帶壓力造成傷害。
- 本血壓計及袖帶不防水，因此應避免淋雨、沾汗及沾水。
- 若測量時靠近其他能發射強力電子場的裝置如電視機、微波爐、手提電話、X光等，測量數據或會出錯。
- 家庭網絡裝置、流動電話、無線電話及其基座主機以及對講機等無線通訊裝置，可能會影響本血壓計。
因此，本產品應該與這些裝置保持至少0.3公尺的距離。
- 使用過的裝置、零件及電池不能作為一般家庭廢物處理。你應按照適當法律處理。
- 使用交流電轉接器時，請確保交流電轉接器可在必要時隨時從電源插座上拔下。
- 再次使用血壓計時，請確認血壓計是乾淨的。
- 請勿改裝血壓計，否則可能造成意外或損壞血壓計。
- 測量血壓時，袖帶必須在手臂上束緊，以使動脈血流暫時停止。這可能會造成手臂疼痛、麻木或出現暫時性紅印。尤其是在連續測量時會發生這種情況。疼痛、麻痺或紅印，都會在一段時間後消失。


- 過於頻繁測量血壓可能會因為血流干擾而造成傷害。如需多次使用裝置，請留意裝置操作時間是否過長以免妨礙血液循環。
- 尚未對新生兒及孕婦進行臨床測試。請勿對新生兒或孕婦使用。
- 如果您曾接受乳房切除術，請在使用前諮詢醫生。
- 請勿讓兒童自行使用血壓計，亦不要在幼兒接觸得到的地方使用血壓計，否則可能會造成意外或傷害。
- 內含小零件，如被幼兒誤食，可能會導致窒息。
- 請勿同時觸碰電池、直流插座和患者，否則可能會導致觸電。
- 測量時若無需使用交流電轉接器，請拔除該插頭。
- 使用非本手冊所載的附件，可能會影響安全。
- 如果電池短路，可能會發熱，並有可能造成灼傷。
- 使用前（約 1 小時）先讓血壓計適應周圍的環境。
- 袖帶未纏繞於上臂時請勿充氣。

禁忌



以下是正確使用血壓計的注意事項。

- 請勿與其他醫療電子器材同時使用。否則設備可能無法正常工作。
- 手臂血液迴圈不良的人士，必須在使用血壓計之前諮詢醫生，以免引起醫療問題。
- 請勿自行判斷測量結果並自行決定療程。請務必向醫生諮詢結果評估及治療。
- 請勿將袖帶套在傷口未癒合的手臂上。
- 請勿將袖帶套在接受靜脈滴注或輸血的手臂上。否則可能會造成傷害或意外。
- 請勿在有易燃氣體（如麻醉氣體）的地方使用血壓計，否則可能會導致爆炸。
- 請勿在高濃度氧氣環境（如高壓氧氣艙或氧氣帳）中使用血壓計，否則可能會引起火災或爆炸。


零件說明

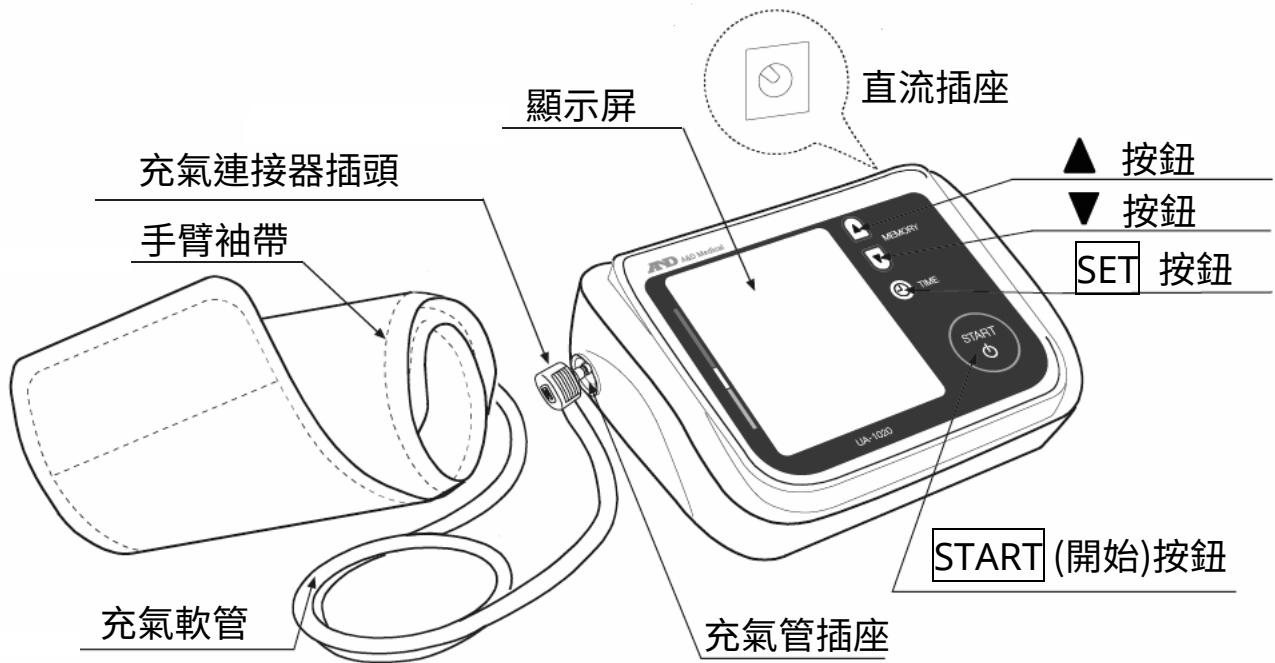

電池盒

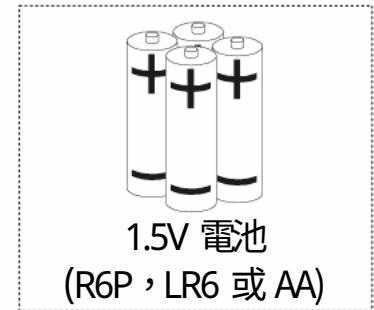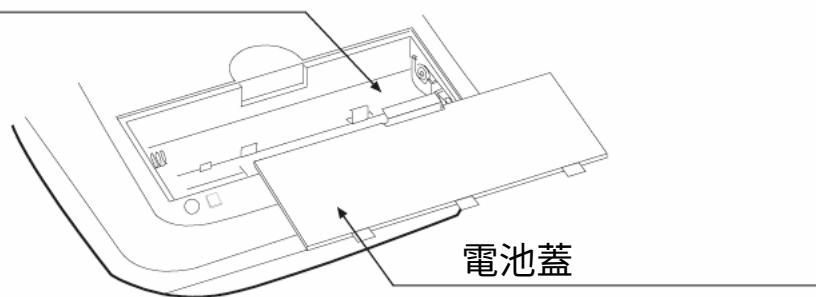

顯示屏

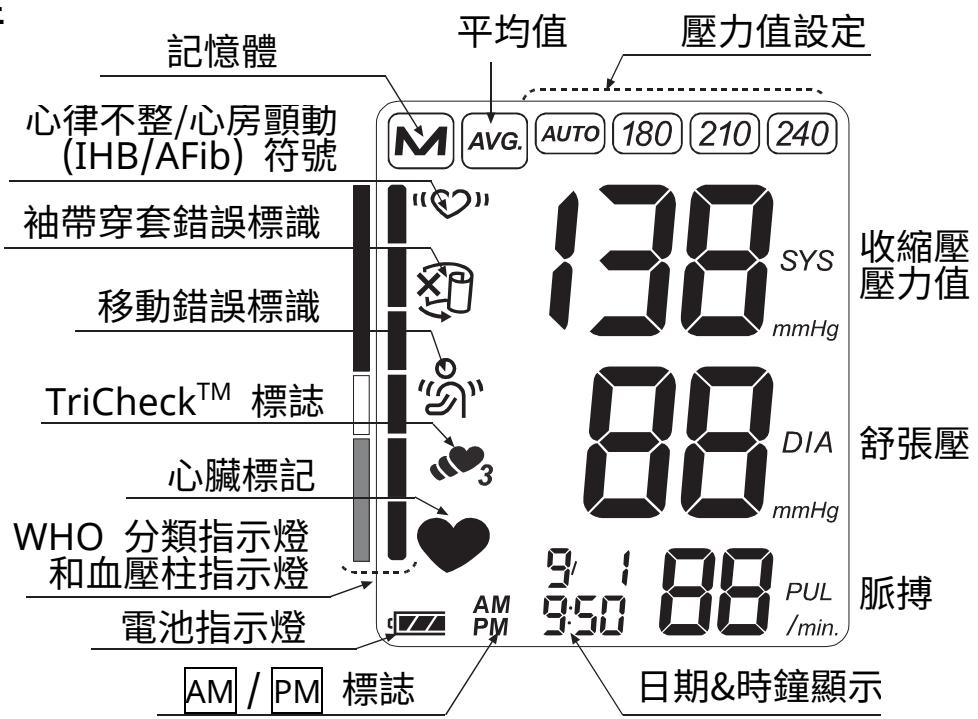

符號

印於裝置外殼的符號

符號	功能/含義
待機及開啟血壓計。	待機及開啟血壓計。
(+) R6(LR6,AA) (-)	電池安裝指示
---	直流電
SN	序號
工厂	生產商
2020	生產日期
	BF 型：袖帶為防觸電設計。
	使用過的裝置、零件及電池不能作為一般家庭廢物處理。你應按照適當法律處理。
	請參閱使用手冊 / 小冊子
	直流插座極性
IP	國際保護標識
	保持乾燥

顯示屏上顯示的符號

符號	功能/含義	建議操作
	在測量中時顯示。偵測到脈搏時閃爍。	測量正在進行中。請盡量保持不動。
	心律不整/心房顫動 (IHB/AFib) 符號 偵測到心律不整時顯示。 偵測到輕微顫動如顫抖或震動時，燈則亮起。	——
	TriCheck™ 模式 自動連續測量三次並展示該三次測量的平均值。	——
	偵測到身體或手臂移動時會出現。	可能會得到不正確的值讀數。嘗試重新測量。 測量時保持不動。

符號	功能/含義	建議操作
	測量期間袖帶佩戴鬆弛時出現。	可能會得到不正確的值讀數。正確套上袖帶並再次測量。
	儲存在記憶體中的過往測量值。	_____
	平均值	_____
	電量充足 測量過程中的電量指示燈。	_____
	電量低 電池電量低時閃爍。	標記閃爍時將所有電池更換為新電池。
	若測量期間移動身體將導致血壓值不穩定。	嘗試重新測量。 測量時保持不動。
	收縮壓和舒張壓均在 10 mmHg 內時顯示。	正確套上袖帶並再次測量。
	充氣過程中，壓力值不增加時顯示。	
	袖帶未正確套上。	
	脈搏顯示錯誤 脈搏不能正確測到時。	
	血壓計內部錯誤	取出電池並按下 START (開始)按鈕，然後再次裝入電池。如仍出現錯誤，請聯絡經銷商。
SYS	收縮壓以 mmHg 表示	_____
DIA	舒張壓以 mmHg 表示	_____
PUL	脈搏每分鐘速率	_____
AM	直到顯示屏上的平均資料為止。 表示資料於 4:00 到 9:59 之間取得	_____
PM	直到顯示屏上的平均資料為止。 表示資料於 18:00 到 1:59 之間取得	_____
	壓力值設定 表示使用者先前設定的血壓值。	_____

操作模式

1. 正常測量

按下 **START** (開始)按鈕量度所得之血壓資料儲存在記憶體內。本裝置可儲存最近的 90 次測量。

2. 查閱數據

按下 **▲** 或 **▼** 按鈕以查詢載於記憶體內的數據。顯示所有測量的平均值，如右圖所示。

每次按下該 **▼** 按鈕資料會如下列方式顯示。



4:00 到 9:59 之間測量的所有上午 (AM) 資料平均值。

18:00 到 1:59 之間測量的所有下午 (PM) 資料平均值。

最新數據 (No.n，如例，No.35)


最後一筆數據 (No.1)

如需瞭解更多關於如何查閱數據，請參閱「查閱數據」。



3. 刪除所有已儲存的資料

按下 **▲** 及 **▼** 按鈕。將會顯示 **M** 標誌及電池指示燈。按住 **▲** 及 **▼** 按鈕直到 **M** 標記開始閃爍以刪除所有已儲存的資料。




4. 以合理的收縮壓測量

(有關如何以預期收縮壓測量，請參閱第15頁。)

使用血壓計

安裝/更換電池

1. 拆下電池蓋。
2. 取出用過的電池，如圖所示將新電池裝入電池盒，請注意極性 (+ 與 -) 須正確。
請只使用 R6P、LR6 或 AA 電池。
3. 裝回電池蓋。

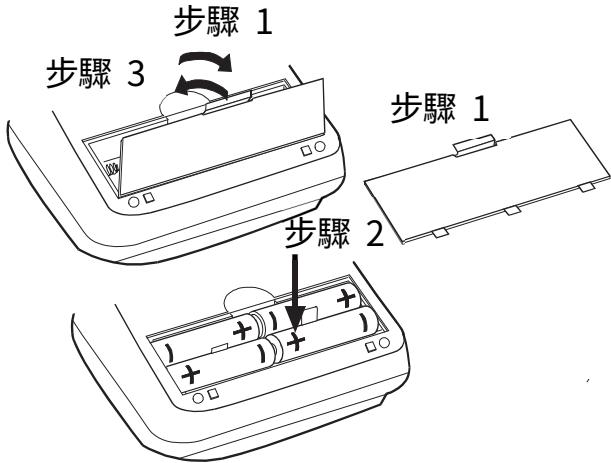


注意

- 如圖所示，將電池裝入電池盒中。如果安裝錯誤，血壓計便無法工作。
- 若顯示屏上 (電池電量不足符號)閃爍，請將所有電池更換為新電池。
請勿新舊電池混用。否則可能會縮短電池的壽命，或導致血壓計發生故障。
待血壓計關閉兩秒或更長時間後再更換電池。
如在更換電池後仍然顯示 (電池電量不足符號)，請嘗試測量血壓。裝置
或會能確認新電池已裝入。
- 若電池電量耗盡， (電池電量不足符號)不會顯示。
- 電池壽命因環境溫度而異，在低溫環境下，電池壽命可能會縮短。一般而言，
若每天測量兩次，四顆全新的 LR6 電池約可使用一年。
- 請只使用指定的電池。裝置隨附的電池僅供測試顯示屏效能使用，電力可能
有限。
- 如果長時間不使用血壓計，請取出電池。
否則電池可能會漏液，進而導致故障。

使用血壓計


連接充氣軟管

將充氣連接器插頭牢牢插入充氣管插座。

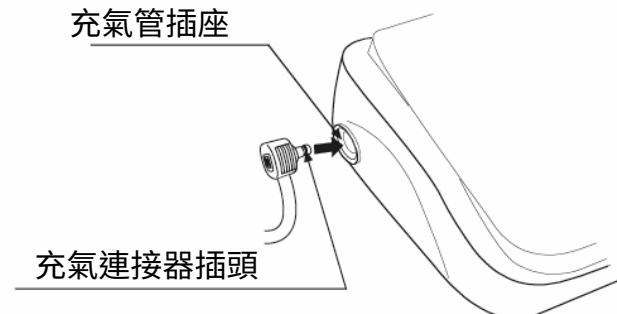

連接交流電轉接器 (需另外購買)

將交流電轉接器插頭插入直流插座。
然後連接交流電轉接器與電源插座。

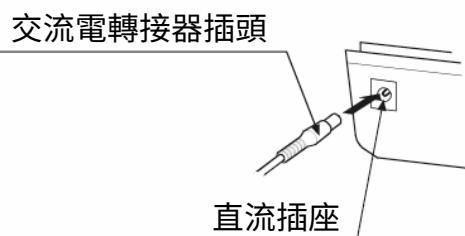

- 請只使用指定的交流電轉接器。
(請參閱第22頁。)
- 從電源插座中拔出交流電轉接器時，抓住交流電轉接器機身並從電源插座中拔出。
- 從血壓計中拔出交流電轉接器插頭時，抓住交流電轉接器插頭並從血壓計中拔出。

使用血壓計

調整內建時鐘

使用前調整時鐘。

1. 按住 **SET** 按鈕，直到年份開始閃爍。
2. 使用 **▲** 或 **▼** 按鈕選擇年份。
按下 **SET** 按鈕，設定目前年份，並移到月/日選擇。日期可設定為 2010 到 2059 年之間的任何一天。
3. 使用 **▲** 或 **▼** 按鈕選擇年份。
按下 **SET** 按鈕，設定目前月份，並移到日期選擇。
4. 使用 **▲** 或 **▼** 按鈕選擇年份。
按下 **SET** 按鈕，設定目前日期，並移到時/分選擇。
5. 使用 **▲** 或 **▼** 按鈕選擇年份。
按下 **SET** 按鈕，設定目前小時，並移到分鐘選擇。
6. 使用 **▲** 或 **▼** 按鈕選擇年份。
(按下 **SET** 按鈕進入血壓設定模式。請參閱第15。)
按下 **START** (開始)按鈕以關閉裝置。

註：如三分鐘內沒有任何操作，裝置會自動關機。

若未設定時鐘，時間顯示屏上會如右圖所指示一樣顯示。

首次使用血壓計時，時鐘會處於原廠設定。

如裝置離開電源超過30秒，所設置的日期，時間和血壓值將會移除。當所設置的日期，時間和血壓值被移除，請重新設定。

- 按下 **▲** 或 **▼** 按鈕會繼續變更數值。



使用血壓計

選擇合適的袖帶尺寸

使用合適的袖帶尺寸對獲得準確的讀數很重要。如果袖帶的尺寸不合適，可能會得到不正確的血壓值讀數。

- 適用的手臂尺寸印在每條袖帶上。
- 手臂袖帶是消耗品。如已磨損，請購買新的袖帶。

手臂尺寸	推薦袖帶尺寸	目錄編號
31 cm 到 45 cm	成人大號袖帶	CUF-D-LA-ISO
22 cm 到 42 cm	寬範圍袖帶	CUF-I-ISO
23 cm 到 37 cm	半大號袖帶	CUF-D-MA-ISO
22 cm 到 32 cm	成人袖帶	CUF-F-A-ISO
16 cm 到 24 cm	小號袖帶	CUF-D-SA-ISO
17 cm 到 32 cm	SmoothFit 成人袖帶	CUF-G-A-ISO


手臂尺寸：二頭肌的圓周。

套上手臂袖帶

1. 將袖帶纏繞到上臂上，距離手肘內側上方約 1-2 cm，如圖所示。

將袖帶直接貼在皮膚上，因為衣物可能會導致脈搏微弱，造成測量錯誤。

2. 捲起襯衣袖子導致上臂有束縛感，可能會無法測出正確讀數。

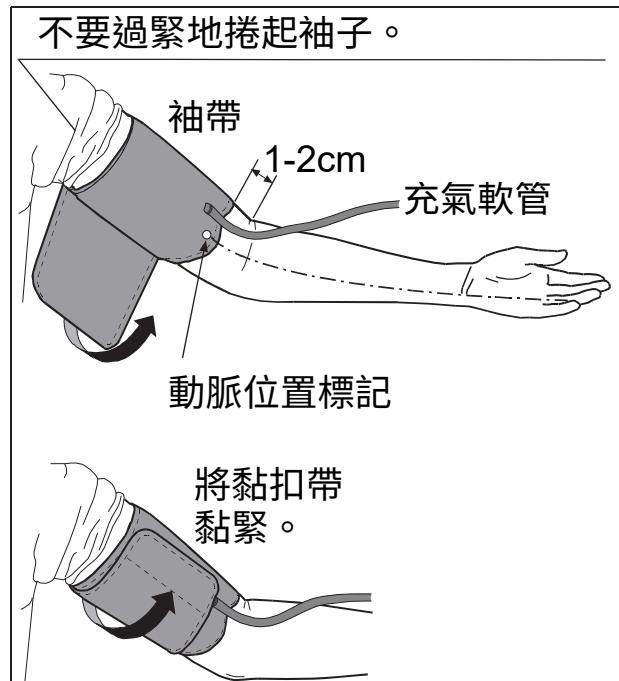

印在袖帶上的符號

符號	功能/意思	建議操作
●	動脈位置標記	請將 ● 標記置於上臂動脈，或與無名指呈一直線的手臂內側。
REF	目錄編號	_____
LOT	批號	_____
MF	製造商	_____
MD	醫療器材	_____

使用血壓計

如何進行精確測量

為獲得最準確的血壓測量：

- 在椅子上坐好並放鬆，將手臂放在桌子上。請避免採用雙腳交叉的坐姿，將雙腳平放在地板上，背部挺直。
- 測量前放鬆約 5 至 10 分鐘。
- 袖帶中心處要與心臟保持同一高度。
- 測量時請保持不動並且應避免說話。
- 請勿在運動或洗澡後立即進行測量。休息 20 或 30 分鐘後再測量。
- 請在每天的同一時間測量血壓。

測量

測量過程中，覺得袖帶很緊是正常的。(請勿過度驚慌)。

測量後

按下 **START** (開始)按鈕以關閉裝置。
解開袖帶並記錄您的資料。

註： 裝置具備自動關機功能，會在測量後約一分鐘自動關閉裝置。
對同一人測量時，需要間隔至少 3 分鐘。


測量

測量前請參閱載於第16頁的正確測量的注意事項。

正確測量

1. 將袖帶纏在手臂上（最好纏在左臂上）。測量時保持不動。
2. 按下 **START** (開始)按鈕。
所有顯示部分隨即顯示。
零 (0)會短暫閃爍。
測量開始時，顯示會發生變化，如右圖所示。
袖帶開始充氣。感到袖帶很緊是正常的。充氣時會在屏幕左方顯示血壓柱指示燈。
注意： 如要在任何時候停止充氣，請再次按下 **START** (開始)按鈕。
3. 充氣完成後，開始自動放氣，並且 **♥** (心臟標記) 會閃爍，這表示測量正在進行中。偵測到脈搏後，標記會隨著每次脈搏跳動閃爍。
注意： 如未達到適當的壓力，血壓計會再次開始自動充氣。
為避免重新充氣，請參閱載於下頁的「以設定的血壓測量」一節。
4. 測量完成時，會顯示收縮壓和舒張壓讀數以及脈搏。
袖帶會排出剩餘空氣並完全放氣。
5. 按下 **START** (開始)按鈕以關閉血壓計。
如一分鐘內沒有任何操作，裝置會自動關機。

注意： 對同一人連續測量前需間隔至少 3 分鐘。

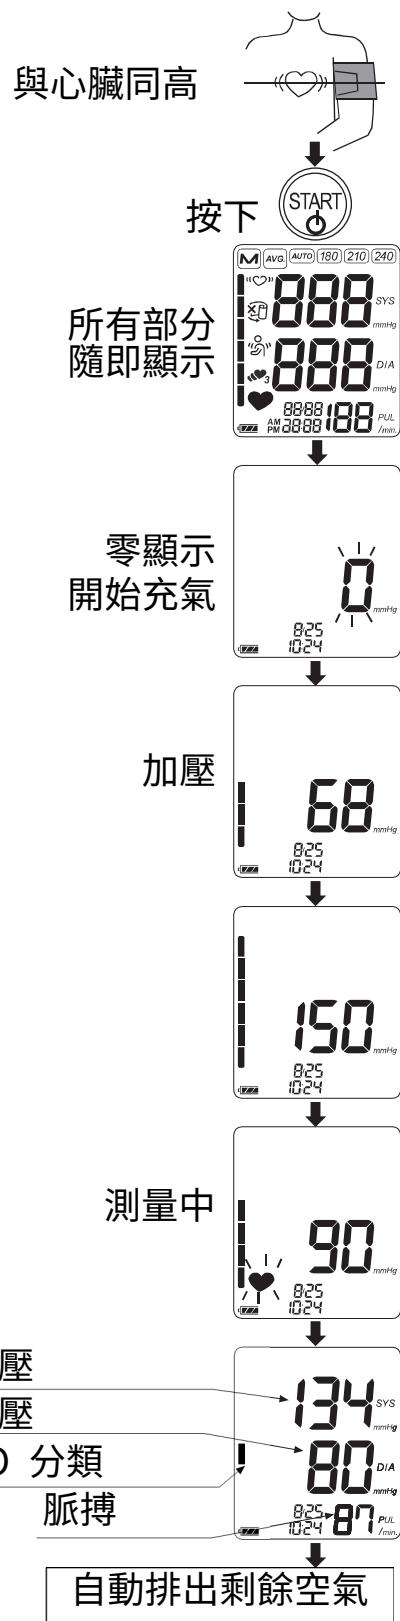

測量


UA-1020專為自動偵測脈搏及為袖帶充氣至收縮壓水平設計。
如果重複進行再充氣，請採取以下方法。

以設定的血壓測量


血壓測量過程中的注意事項。

設定穩定的血壓值能避免重新充氣。

- 在設定時鐘的第6步，(請參閱第 11頁)，按下 **SET** 按鈕以進入壓力值設定模式。目前設定閃爍。

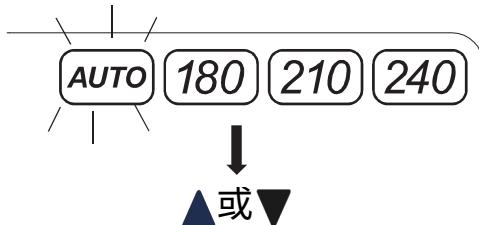

- 按下 **▲** 或 **▼** 按鈕從以下選擇血壓值大約比您期望收縮壓高 30 mmHg 或更多的壓力值。

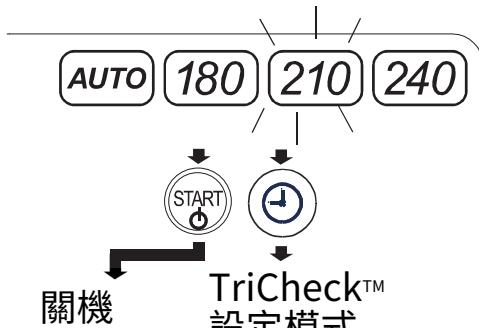

AUTO : 自動加壓 (預設值)

180 : 血壓值 180 mmHg (固定)

210 : 血壓值 210 mmHg (固定)

240 : 血壓值 240 mmHg (固定)


- 按下 **SET** 按鈕進入 **TriCheck™** 設定模式。
按下 **START** (開始)按鈕以關閉裝置。
如三分鐘內沒有任何操作，裝置會自動關機。
下一次測量將會以新的血壓值進行。

關機 TriCheck™
 設定模式

以合理的收縮壓測量

如壓力值按照上述方式調至 **240** 仍然出現重新充氣的情況，或在血壓值跌至 20 mmHg 結果仍未顯示，此方法同樣適用。

- 將袖帶纏在手臂上 (最好纏在左臂上) 。
- 按住 **START** (開始)按鈕，直到出現較預期收縮壓高 30 至 40 mmHg 的數字為止。
- 達到所需數字時，鬆開 **START** (開始)按鈕，以開始測量。接著繼續按前頁所述方法測量您的血壓。

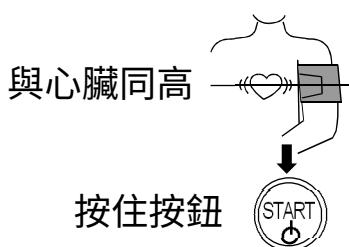

在達到合理的收縮
壓時鬆開按鈕



請參閱前頁所載方法

正確測量的注意事項

- 以舒適的姿勢坐下。將手臂放在桌子上，手掌朝上，使袖帶與心臟處於同一高度。
- 測量前放鬆約 5 或 10 分鐘。如果因為情緒壓力而過於激動或壓抑，測量值會高於（或低於）正常血壓讀數，且脈搏讀數亦較正常為快。
- 人的血壓是不斷變化的，這取決於當時在做什麼及當時的飲食。飲料對血壓有強烈而快速的影響。
- 本血壓計根據心跳測量血壓。如果您的心跳十分微弱或不規律，血壓計可能會很難測到您的血壓。
- 如果血壓計偵測到異常狀況，將會停止測量並顯示錯誤符號。有關符號的說明，請參閱第 6 頁。
- 本血壓計適合成年人使用。對兒童使用本血壓計之前，請諮詢您的醫生。兒童應在監督下使用本血壓計。
- 自動血壓計的效能可能受到過高溫度、濕度或海拔高度影響。

TriCheck™ 測量


TriCheck™ 模式自動連續測量三次並展示該三次測量的平均值。

選用TriCheck™ 模式

1. 在血壓設定模式內按下 **SET** 按鈕進入 TriCheck™ 設定模式。目前設定閃爍。
2. 按下 **▲** 或 **▼** 按鈕以開啓或關閉 TriCheck™ 模式。
開啓：TriCheckTM 模式
關閉：正常測量模式（預設值）
3. 按下 **START** (開始)或 **SET** 按鈕以關閉裝置。如三分鐘內沒有任何操作，裝置會自動關機。

在血壓設定模式

按下 



目前設定閃爍

▲或**▼**

變更設定




使用TriCheck™ 模式測量

1. 按下 **START** (開始)按鈕。
所有顯示部分隨即顯示。
零 (0)會短暫閃爍，隨後首次測量將會開始。
2. 測量完成時，會顯示收縮壓和舒張壓讀數以及脈率。一分鐘倒計時會開始，然後開始第二次測量。
3. 一分鐘倒計時後，開始第二次測量。
4. 測量完成時，會顯示首兩次的平均讀數。隨後一分鐘倒計時會開始，然後開始第三次測量。
5. 一分鐘倒計時後，開始第三次測量。
6. 測量完成時，會顯示三次的平均讀數。隨後會儲存在記憶體內。

註：

- 測量過程中會顯示TriCheck™。
- 取消測量，按下 **START** (開始)按鈕量度所得之血壓資料儲存在記憶體內。
- 當在第一次測量時出現袖帶不合適符號，請取消測量並重新正確套上袖帶，再重新測量。
- 測量完成時，會顯示三次的平均讀數。隨後會儲存在記憶體內。
在完成第三次測量前取消測量的話，資料將不會儲存。

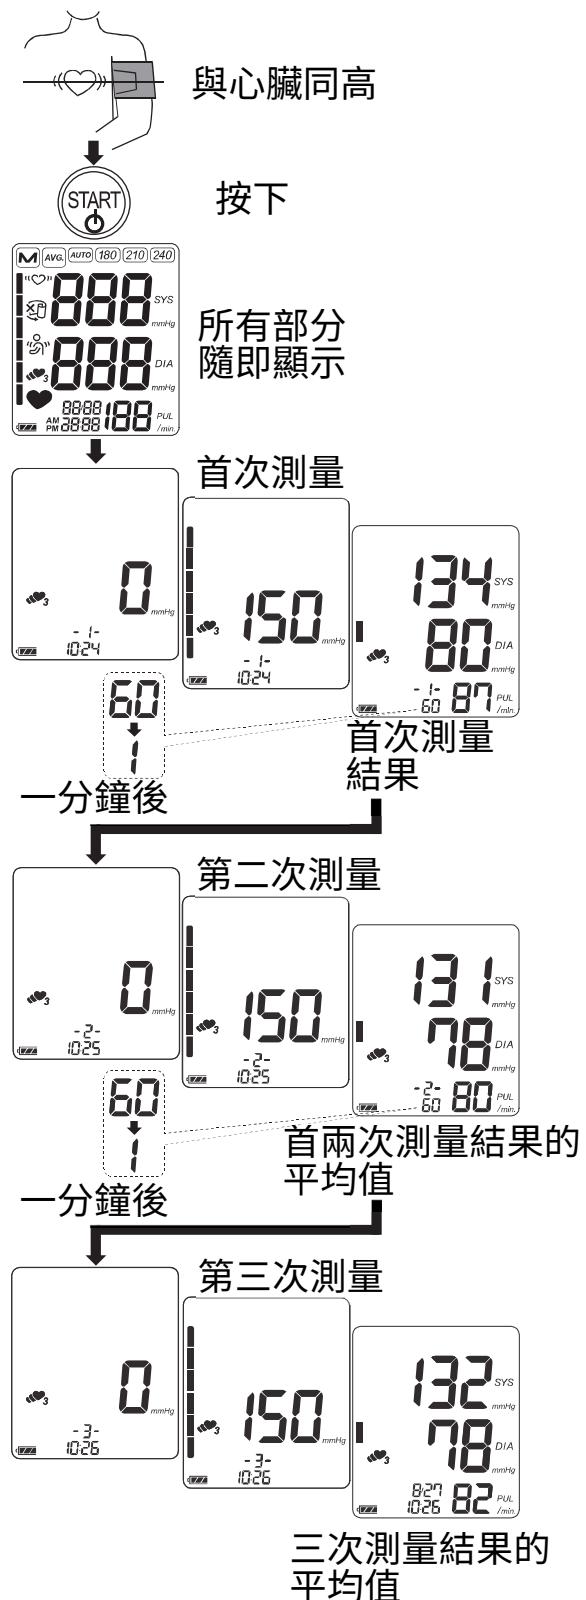

查閱數據

註： 本裝置可儲存最近的 90 次測量。

1. 按下 **▲** 或 **▼** 按鈕。
會顯示所有測量的平均值和資料數量。
(若沒有資料，會顯示「0」。按下 **▲**，
▼ 或 **START** (開始)按鈕以關閉裝置。)
2. 每次按下該 **▼** 按鈕 (或 **▲** 按鈕以反向
展示資料)，資料會如下列方式顯示。


4:00 到 9:59 之間測量的所有上午
(AM) 資料平均值。
(例如，第10次測量。
若沒有資料，會顯示「--」。)

18:00 到 1:59 之間測量的所有下午
(PM) 資料平均值。
(例如，第9次測量。
若沒有資料，會顯示「--」。)

最新數據 (No.n，如例，No.35)
展示測量資料編號後 3 秒將會顯示該
次測量的數據。

⋮

最後一筆數據 (No.1)
展示測量資料編號後 3 秒將會顯示該
次測量的數據。
3. 顯示最後一筆數據後，按下 **▼** 按鈕以
查看所有資料的平均值。
4. 按下 **START** (開始)按鈕以關閉裝
置。如一分鐘內沒有任何操作，裝置
會自動關機。

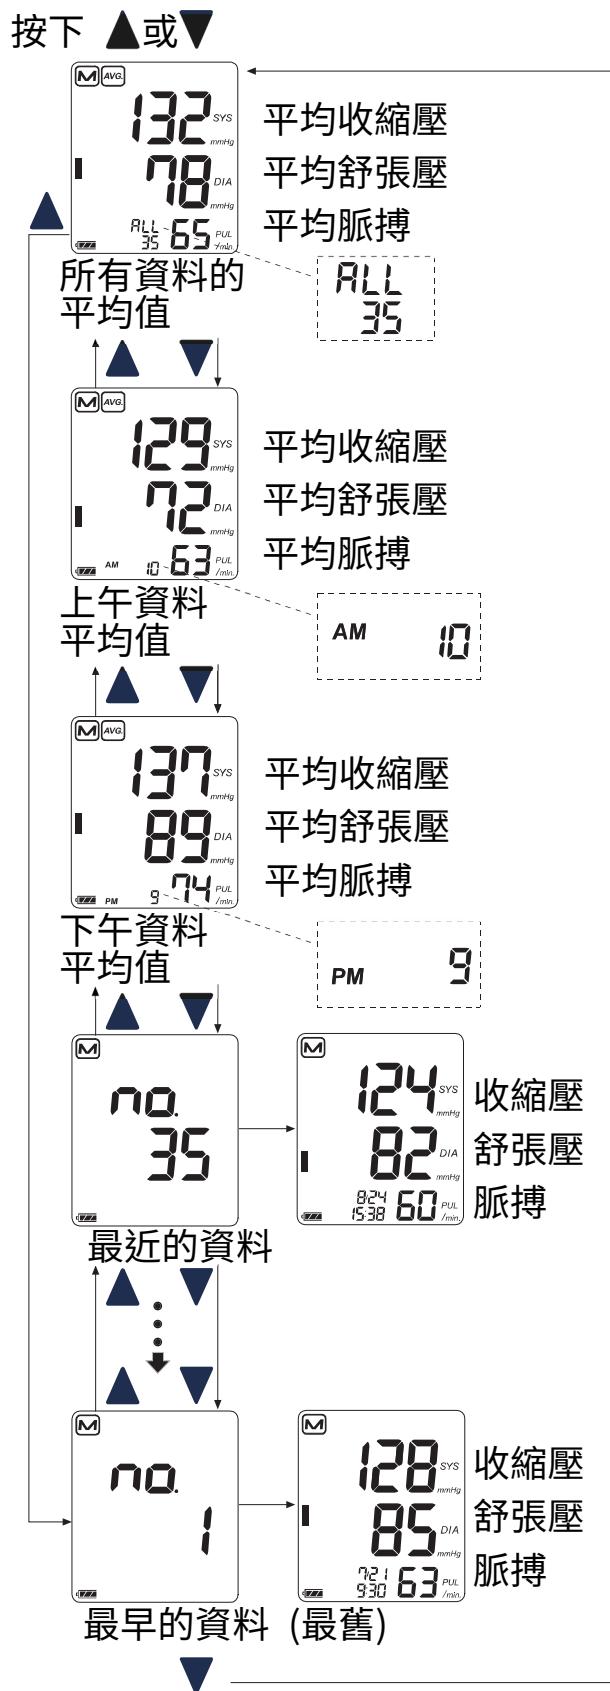

什麼是心律不整/心房顫動 (IHB/AFib) 指示燈？

血壓計在測量期間偵測到心律不整時，心律不整/心房顫動指示燈將出現在顯示屏上，並顯示測量值。


注意：如果頻繁出現  心律不整/心房顫動 (IHB/AFib) 指示燈，我們建議您儘快求醫。

什麼是心房顫動 (AFib)？

心臟出現電訊號導致心臟收縮，並將血液輸送全身。當心房中的電訊號變得紊亂時，則出現心房顫動，導致脈搏間歇混亂。心房顫動可導致血液滯留在心臟中，這很容易造成血塊，引發中風和心臟病發作。

血壓柱指示燈


指示燈可顯示測量期間的壓力變化。

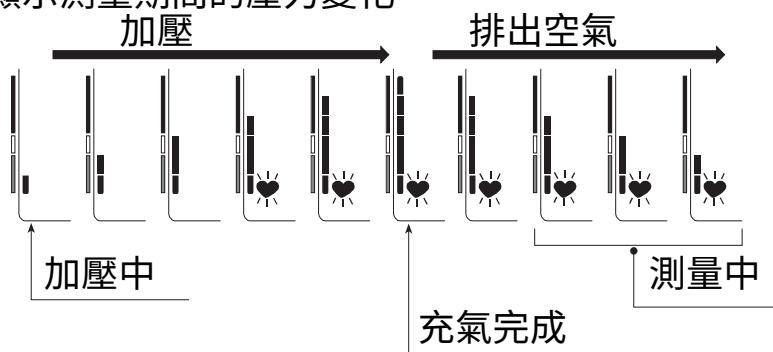

WHO 分類指示燈

血壓柱指示燈的每個區段對應下頁所述的 WHO 血壓分類。

WHO 分類指示燈



- ：此指示燈顯示的區段以目前數據為基礎，對應 WHO 分類。

例子：



關於血壓

什麼是血壓？

血壓是血液對動脈血管壁施加的壓力。心臟收縮時產生的壓力為收縮壓。心臟舒張時產生的壓力為舒張壓。血壓以毫米汞柱 (mmHg) 計。每個人的正常血壓均透過基礎血壓表示，需要清晨仍在休息或尚未進食時測量。

什麼是高血壓及如何控制？

高血壓即異常動脈高血壓，如果不予理會，可能會引發諸多健康問題，包括中風及心臟病發作。高血壓可透過改變生活方式、避免壓力及在醫生監督下服用藥物的方式來控制。

為防止高血壓或對其進行控制：

- 不要吸煙
- 減少鹽及脂肪的攝入
- 經常運動
- 定期體檢
- 維持適當體重


為什麼在家測量血壓？

在診所或醫生辦公室測量血壓可能會引發恐懼，致使讀數比在家測量時高 25 至 30 mmHg。在家測量能降低外部因素對血壓讀數的影響，並作為對醫生讀數的補充，以及提供更準確、更全面的血壓記錄。

WHO 血壓分類

世界衛生組織 (WHO) 已設定了評估高血壓的標準，與年齡無關，如下表所示。


參考資料：高血壓雜誌 1999 年，第 17 卷 2 號

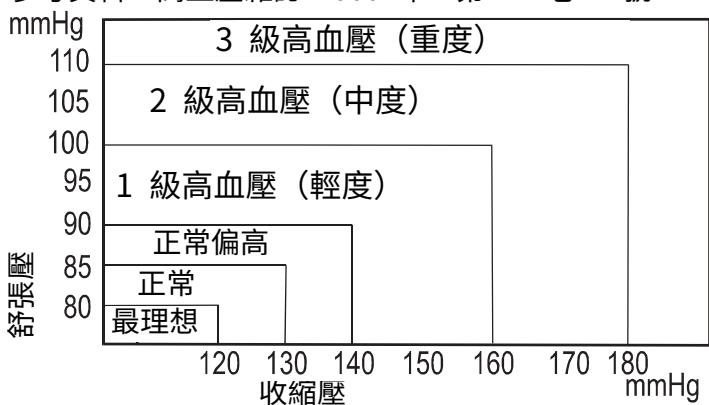

血壓變化

一個人的血壓因日期及季節而顯著不同，在一天中，可能會因各種條件而變化 30 - 50 mmHg。對於高血壓患者，變化會更為明顯。一般情況下，血壓會在工作或玩耍時升高，並在睡眠時降至最低水平。因此，請勿過度在意一次測量的結果。

請按照本手冊中的步驟在每天的同一時間測量血壓，以便得知正常血壓。定期讀數會提供更全面的血壓記錄。在記錄血壓時務必記下日期及時間。請諮詢醫生以解釋您的血壓資料。

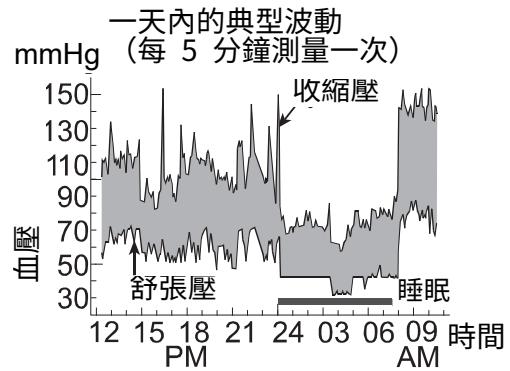

疑難排解

問題	可能的原因	建議操作
顯示屏沒有任何顯示，即使開啟電源亦然。	電池電量用盡。 電池端位置不正確。	將所有電池更換為新電池。 重新安裝電池，正負極與電池盒標示的一致。
袖帶不充氣。	電池電壓過低。 ■ (電池電量不足符號)閃爍。如果電池電量用盡，標記不會顯示。	將所有電池更換為新電池。
血壓計無法測量。 讀數過高或過低。	袖帶未正確纏繞。 測量時移動手臂或身體。 袖帶位置不正確。 _____	正確纏繞袖帶。 測量時請保持不動並且應避免說話。 放鬆坐好並保持不動。 將手臂放在桌子上，手掌朝上，使袖帶和心臟處於同一高度。 如果您的心跳十分微弱或不規律，血壓計可能會很難測到您的血壓。
其他	數值與診所或醫生診室測得的值不同。 _____	請參閱「為什麼在家測量血壓？」 取出電池。正確裝回電池，並再次進行測量。

註： 如果採取上述解決方法仍未能解決問題，請聯絡經銷商。請勿嘗試拆開或修理本產品，否則可能會使保用失效。

維護保養

請勿將血壓計拆開。它是採用精密電子部件和容易損壞的複雜空氣組件製造的。如果按照疑難排解說明問題仍無法解決，請聯絡您所在區域的授權經銷商或我們的客戶服務部。A&D 客戶服務部將向授權經銷商提供技術資料、備用零件及裝置。

本血壓計是為持久耐用而設計與製造的。但通常建議每 2 年對血壓計進行一次定期檢查，以確保功能正常及測量準確。請聯絡您所在區域的授權經銷商或 A&D 進行維護保養。

技術資料

類型	UA-1020
測量方法	示波測量
測量範圍	壓力： 0 - 299 mmHg 收縮壓： 60 - 279 mmHg 舒張壓： 40 - 200 mmHg 脈搏： 40 - 180 次/分鐘
測量精度	壓力： ±3 mmHg 脈搏： ±5 %
測量範圍	DC 6V 3W
電源	4 x 1.5V 電池 (R6P、LR6 或 AA) 或 交流電轉接器 (TB-233C 輸入：AC 100 – 240V 50/60 Hz 0.15A) (需另外購買)
測量次數	約使用 AA 鹼性電池，23 °C 的室溫下血壓值為 180 mmHg 時，約可測量 1000 次。
分類	內部供電 ME 設備 (由電池提供)/ II 類 (由轉接器提供) II 類 (由轉接器提供) 連續操作模式
臨床測試	根據 ISO81060-2 : 2013 在臨床驗證研究中，85 位受試者以K5測量舒張壓。 IEC 60601-1-2: 2014
機電延遲 (EMD)	最近 90 個測量值
記憶體	+10 到 +40 °C / 15 到 85 %RH / 800 到 1060 hPa
操作環境	-20 至 +60 °C / 10 至 95 %RH / 700 至 1060 hPa
運輸/存放條件	

尺寸	約140[W] x60[H] x105[D] mm
重量	約285 克，不包括電池
防水防塵	血壓計： IP20
隨附零件	BF 型袖帶 
使用壽命	血壓計：5 年 (若一天使用六次) 袖帶：2 年 (若一天使用六次) 交流電轉接器：5 年 (若一天使用六次)

交流電轉接器

TB-233C

用於在家連接血壓計和電源。

請聯絡當地 A&D 經銷商購買。

交流電轉接器需定期檢查或更換。

印在交流電轉接器上的符號

符號	功能/含義
	僅供室內使用
	II 類裝置
	溫度保險絲
	保險絲
	EC 指令裝置標誌
	EAC 認證裝置標誌
	交流電轉接器插頭極性

配件單獨銷售

袖帶

目錄編號	袖帶尺寸	手臂尺寸
CUF-D-LA-ISO	成人大號袖帶	31 cm 到 45 cm
CUF-I-ISO	寬範圍袖帶	22 cm 到 42 cm
CUF-D-MA-ISO	半大號袖帶	23 cm 到 37 cm
CUF-F-A-ISO	成人袖帶	22 cm 到 32 cm
CUF-D-SA -ISO	小號袖帶	16 cm 到 24 cm
CUF-G-A-ISO	SmoothFit 成人袖帶	17 cm 到 32 cm

交流電轉接器

目錄編號	插頭 (插座類型)
TB-233C	C 型

注意：規格如有變更，恕不另行事先通知。

IP 分類是根據 IEC 60529 由外殼提供的保護程度。本血壓計可防止直徑 12 mm 及更大的固體異物 (如手指) 進入。本血壓計不防水。

備註

목차

목차	1
고객님께	3
머리말	3
주의 사항	3
금기 사항	4
각부 설명	5
기호	6
작동 모드	8
1. 일반 측정	8
2. 데이터 불러오기	8
3. 메모리에 저장된 모든 데이터 삭제	8
4. 희망 최고 혈압으로 측정	8
모니터 사용	9
배터리 삽입/교체	9
모니터 사용	10
에어 호스 연결	10
AC 어댑터 연결	10
모니터 사용	11
내장 시계 조정	11
모니터 사용	12
올바른 커프 사이즈 선택	12
팔 커프 착용	12
모니터 사용	13
정확하게 측정하는 방법	13
측정	13
측정 후	13
측정	14
일반 측정	14
측정	15
설정된 혈압으로 측정	15
희망 최고 혈압으로 측정	15
정확한 측정을 위한 참고 사항	16
TriCheck™ 측정	16
TriCheck™ 모드 선택	16
TriCheck™ 모드를 이용한 측정	17
메모리 데이터 불러오기	18
IHB/AFib 표시기란?	19
AFib 란?	19
압력 바 표시기	19
WHO 혈압 등급 표시기	19
혈압에 대하여	20
혈압이란?	20
고혈압 관리의 필요성	20
집에서 혈압을 측정해야 하는 이유는 무엇일까요	20
WHO 혈압 분류	20

혈압의 변동	20
문제 해결	21
유지보수	22
사 양	22

고객님께

첨단 A&D 자동전자혈압계를 구입해 주셔서 감사드립니다. 사용 시 편리함과 정확성에 중점을 두고 설계된 본 기기는 일상 생활에서 혈압 관리를 편리하게 도와드립니다.

※ 본 제품은 “의료기기”입니다. 기기를 처음 사용하기 전에 본 사용 설명서를 자세히 읽으십시오.

머리말

- 이 기기는 신생아나 유아가 아닌 성인에게 사용하도록 설계되었습니다.
- 사용 환경. 이 기기는 홈 헬스케어 환경에서 혼자 사용할 수 있습니다.
- 사용 목적. 혈압의 비관혈적 측정에 이용하는 전자식 기기로 커프는 자동적으로 가압하며 일반적으로 수축기 및 확장기 혈압에 대해 심박수를 표시합니다.
- 이 기기는 진단을 위해 사람의 혈압과 맥박수를 측정하도록 설계되었습니다.

주의 사항

- 사용시 주의사항을 반드시 읽어 주십시오.
- 이 기기의 구성에는 정밀 부품이 사용되었습니다. 온도, 습도, 직사광선, 충격 또는 먼지가 많은 곳에서는 사용을 피해야 합니다.
- 기기와 커프를 부드러운 마른 천 또는 물과 중성 세제에 적신 천으로 닦으십시오. 알코올, 벤젠, 시너 또는 기타 강한 화학물질을 사용하여 기기나 커프를 청소하지 마십시오.
- 구성품의 수명이 단축될 수 있으므로 장기간 커프를 단단히 접어두거나 호스를 단단히 비틀어 보관하지 마십시오.
- 호스와 케이블에 아기 또는 영유아가 질식할 위험이 있으니 주의하십시오.
- 측정 중에 에어 호스를 비틀지 마십시오. 커프 압력이 지속적으로 가해져 부상을 입을 수 있습니다.
- 기기와 커프에는 방수 기능이 없습니다. 기기와 커프가 비, 땀 및 물에 오염되지 않도록 하십시오.
- 기기를 텔레비전, 전자레인지, 휴대전화, X-레이 또는 강한 전기장이 있는 기타 기기 가까이에서 사용하면 측정치가 왜곡될 수 있습니다.
- 휴네트워크 기기, 휴대전화, 무선 전화기 및 전화기 거치대, 휴대용 무선 통신기와 같은 무선 통신 기기는 혈압 모니터에 영향을 끼칠 수 있습니다.
따라서 이러한 기기로부터 30 cm 이상 거리를 유지해야 합니다.
- 사용한 기기, 부품 및 배터리는 일반 가정용 쓰레기로 취급되지 않으며 해당 지역 규정에 따라 폐기해야 합니다.
- AC 어댑터를 사용하는 경우 필요 시 AC 어댑터를 전기 콘센트에서 쉽게 분리할 수 있는지 확인하십시오.


- 기기를 다시 사용할 때 기기가 깨끗한지 확인하십시오.
- 기기를 개조하지 마십시오. 사고가 발생하거나 기기가 손상될 수 있습니다.
- 혈압을 측정하려면 동맥을 통과하는 혈류가 일시적으로 멈출 수 있도록 커프로 팔을 충분히 강하게 압박해야 합니다. 이로 인해 팔에 통증, 무감각 또는 일시적인 붉은 자국이 나타날 수 있습니다. 특히 측정을 여러 번 연속적으로 반복할 때 이러한 현상이 잘 나타납니다. 통증, 무감각 또는 붉은 자국은 시간이 지나면 사라집니다.
- 혈압을 너무 자주 측정하면 혈류 장애로 인해 상해를 입을 수 있습니다. 기기를 반복적으로 사용하는 경우, 기기의 작동으로 인해 혈액 순환에 장기적 손상이 생기지 않는지 확인하십시오.
- 신생아 및 임산부에 대한 임상 시험은 실시되지 않았습니다. 신생아나 임산부에게 사용하지 마십시오.
- 유방 절제술을 받은 적이 있다면 기기를 사용하기 전에 의사와 상담하십시오.
- 어린이가 혼자서 기기를 사용하도록 하지 말고 유아의 손이 닿지 않는 곳에서 기기를 작동하여 주십시오. 사고나 손상을 초래할 수 있습니다.
- 유아가 실수로 삼킬 경우 질식 위험을 일으킬 수 있는 작은 부품이 있으니, 주의하여 주십시오.
- 배터리, DC 잭 및 환자를 동시에 만지지 마십시오. 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
- 측정 중 사용하지 않는 AC 어댑터는 분리하십시오.
- 본 설명서에 나와있지 않은 액세서리를 사용하면 위험할 수 있습니다.
- 배터리가 단선되면 뜨거워져 화상을 입을 수 있습니다.
- 사용하기 전에 기기를 주변 환경에 적응시키십시오(약 1시간).
- 커프를 상박에 감싸지 않은 상태에서 팽창시키지 마십시오.
- 혈관 내 접근, 치료 또는 동정맥 단락이 이루어지는 사지에 커프를 둘러서 압력을 가하면 일시적으로 혈류를 간섭하기 때문에 환자에게 상해를 입힐 수도 있습니다.

금기 사항


다음은 기기의 올바른 사용을 위한 예방 조치입니다.

- 팔에 다른 전자 의료 장비가 부착된 상태에서 커프를 착용하지 마십시오. 장비가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 팔에 심각한 혈행 장애가 있는 사람은 의료 문제를 방지하기 위하여 기기 사용 전 반드시 의사와 상의해야 합니다.
- 측정된 결과를 근거로 자가 진단하여 치료를 시작하지 마십시오. 결과 평가와 진단은 항상 의사와 상의하여 주십시오.
- 완치되지 않은 상처가 있는 팔에 커프를 착용하지 마십시오.
- 정맥 주사 또는 혈액 수혈을 받고 있는 팔에 커프를 착용하지 마십시오. 부상이나 사고가 발생할 수 있습니다.
- 마취 가스와 같은 인화성 가스가 있는 곳에서는 이 기기를 사용하지 마십시오. 폭발의 위험이 있습니다.
- 고압 산소 챔버 또는 산소 텐트와 같은 고농축 산소 환경에서는 본 기기를 사용하지 마십시오. 화재나 폭발의 위험이 있습니다.

각부 설명

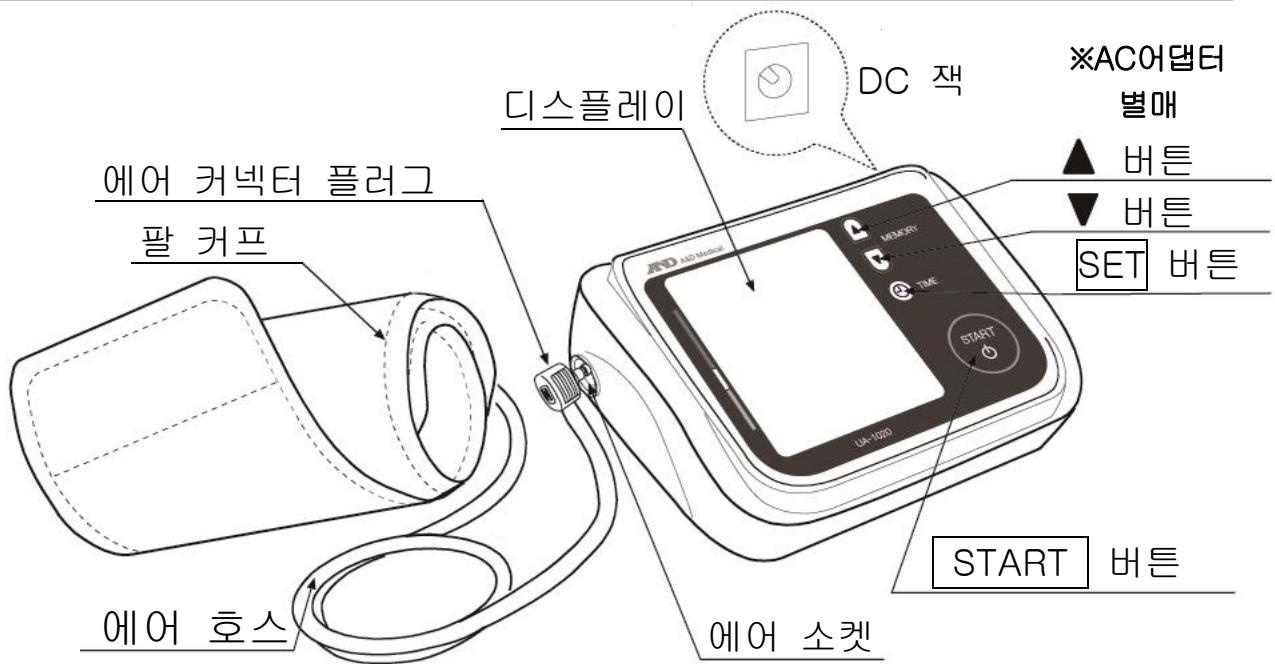


배터리 함

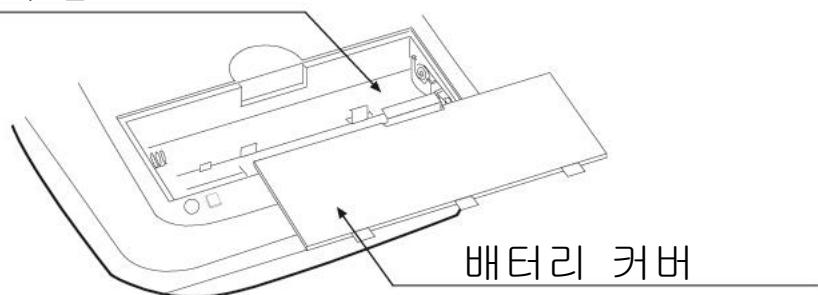

1.5V 배터리
(R6P, LR6 또는 AA)

디스플레이

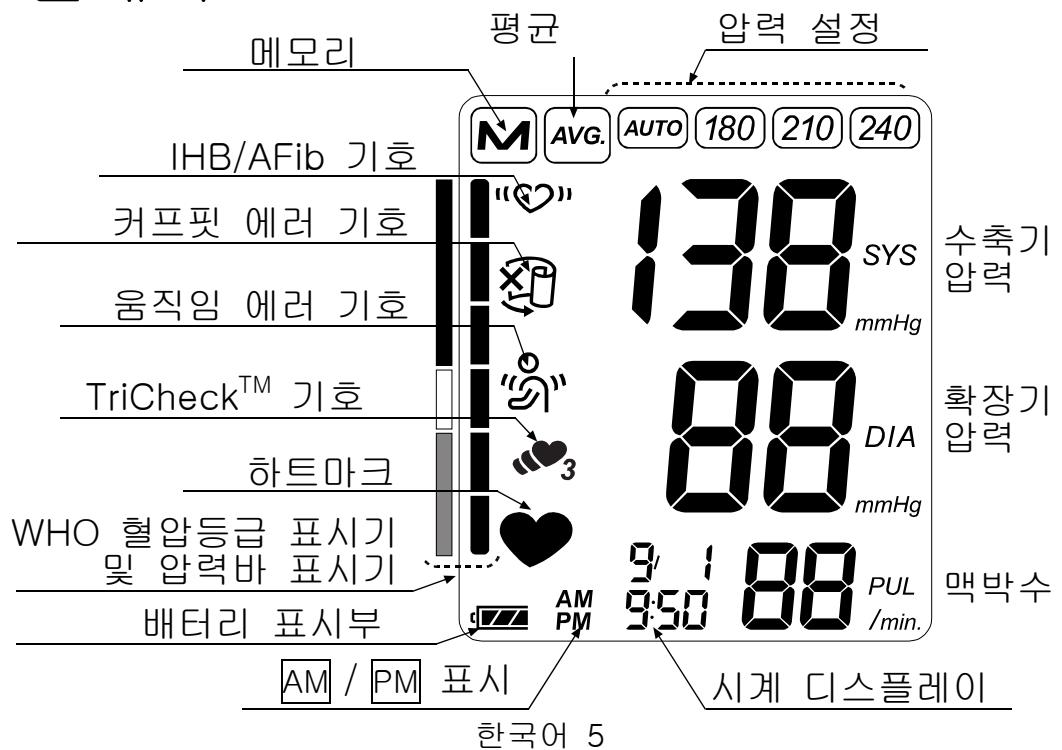

기호

기기 케이스에 인쇄된 기호

기호	기능/의미
⌚	대기 모드 및 기기 켜기
(+) [R6(LR6,AA)] (-)	배터리 설치 안내
---	직류
SN	일련 번호
🏭	제조사
2020	제조년
🏃	형식 BF: 감전 방지를 위해 특수하게 설계된 커프입니다.
☒	사용한 기기, 부품 및 배터리는 일반 가정용 쓰레기로 취급되지 않으며 해당 지역 규정에 따라 폐기해야 합니다.
ⓘ	사용 설명서/부클릿 참조
⎓⎓⎓	DC 잭의 극성
IP	국제 보호 기호
☔	건조하게 유지

디스플레이에 나타나는 기호

기호	기능/의미	권고 조치
❤	측정이 진행되는 동안 나타납니다. 맥박이 감지되면 깜박입니다.	측정이 진행 중입니다. 가능한 한 움직이지 마십시오.
((Heart))	IHB/AFib 기호 불규칙맥파나 심방세동이 감지될 때 나타납니다. 떨림이나 흔들림과 같은 매우 미세한 진동이 감지될 때 켜질 수 있습니다.	_____
3	TriCheck™ 모드 자동으로 세 번 연속 측정을 하며 이 세 측정치의 평균 값이 표시됩니다.	_____
🏃	신체 또는 팔 움직임이 감지되면 나타납니다.	판독값이 올바르지 않을 수 있습니다. 측정을 다시 시도하십시오. 측정 중에는 가만히 계십시오.

기호	기능/의미	권고 조치
	커프를 느슨하게 착용하고 측정 중인 경우 표시됩니다.	판독값이 올바르지 않을 수 있습니다. 커프를 바르게 착용하고 측정을 다시 시도하십시오.
	메모리에 저장된 이전 측정값.	_____
	평균 데이터	_____
	배터리 완충 측정 중 배터리 전원을 표시합니다.	_____
	배터리 부족 깜박이면 배터리가 부족한 것입니다.	표시가 깜박이면 모든 배터리를 새 것으로 교체하십시오.
<i>Err</i>	측정 중 움직임으로 인한 불안정한 혈압.	측정을 다시 시도하십시오. 측정 중에는 가만히 계십시오.
	수축기 및 이완기 값이 서로 10mmHg 이내입니다.	
	커프가 팽창하는 동안 압력 값이 증가하지 않았습니다.	
<i>Err</i> <i>LUF</i>	커프를 올바르게 착용하지 않았습니다.	커프를 바르게 착용하고 측정을 다시 시도하십시오.
<i>E</i>	PUL 표시 오류 펄스가 올바로 감지되지 않았습니다.	
<i>Err</i> <i>E</i>		배터리를 꺼내고 START 버튼을 누른 다음 배터리를 다시 삽입하십시오. 오류가 계속 나타나면 대리점에 문의하십시오.
<i>Err</i> <i>9</i>	혈압 모니터 내부 오류	
SYS	수축기 혈압(mmHg)	_____
DIA	확장기 혈압(mmHg)	_____
PUL	분당 맥박수	_____
AM	평균 데이터가 표시될 때 나타납니다. 4:00 ~ 9:59 사이에 측정된 데이터	_____
PM	평균 데이터가 표시될 때 나타납니다. 18:00 ~ 1:59 사이에 측정된 데이터	_____
AUTO 180 210 240	압력 설정 사용자가 이전에 설정한 압력 값을 가리킵니다.	_____

작동 모드

1. 일반 측정

[START] 버튼을 누릅니다. 혈압이 측정되고 데이터가 메모리에 저장됩니다. 이 기기는 최근 90건의 측정 값을 메모리에 저장할 수 있습니다.

2. 데이터 불러오기

▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 메모리의 데이터를 불러옵니다. 오른쪽 그림과 같이 모든 측정치의 평균이 표시됩니다.

그 후, ▼ 버튼을 누를 때마다 메모리 데이터가 다음과 같이 표시됩니다.


4:00 ~ 9:59 사이에 측정된 모든 AM(오전) 측정치의 평균

18:00 ~ 1:59 사이에 측정된 모든 PM(오후) 측정치의 평균

가장 최근 데이터
(No.n, 예시에서는 No.35)


가장 최근 데이터(No.1)

데이터 불러오기에 대한 자세한 내용은 "메모리 데이터 불러오기"를 참조하십시오.



3. 메모리에 저장된 모든 데이터 삭제

▲ 와 ▼ 버튼을 모두 누릅니다. [M] 표시와 배터리 표시부가 나타납니다. [M] 표시가 깜빡이기 시작할 때까지 ▲ 와 ▼ 버튼을 동시에 길게 누르면 메모리에 저장된 모든 데이터가 삭제됩니다.




4. 희망 최고 혈압으로 측정

희망 최고 혈압을 이용한 측정에 대해서는 15페이지를 참조하십시오.

모니터 사용

배터리 삽입/교체

1. 배터리 커버를 분리합니다.
2. 사용한 배터리를 꺼내고 극성 (+ 및 -)이 맞는지 확인하면서 그림과 같이 새 배터리를 배터리 함에 삽입합니다.
R6P, LR6 또는 AA 배터리만 사용하십시오.
3. 배터리 커버를 닫아 주십시오.

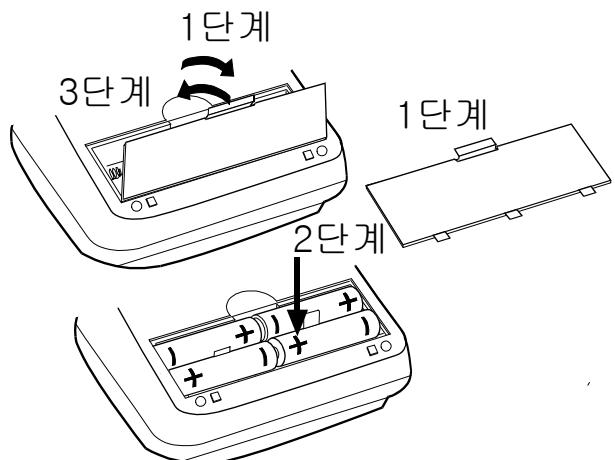


주의

- 배터리 함: 배터리 함에 배터리를 삽입하십시오. 잘못 장착하면 기기가 작동하지 않습니다.
- (배터리 부족 표시)가 디스플레이에서 깜빡이면 모든 배터리를 새 것으로 교체하십시오. 사용하던 배터리와 새 배터리를 혼용하여 사용하지 마십시오. 배터리 수명이 단축되거나 기기가 오작동할 수 있습니다.
기기가 꺼지고 2초 이상 지난 후 배터리를 교체하십시오.
배터리를 교체한 후에도 (배터리 부족 표시)가 나타나면 혈압을 측정해 보십시오. 그러면 기기가 새 배터리를 인식할 수 있습니다.
- 배터리가 방전되면 (배터리 부족 표시)가 나타나지 않습니다.
- 배터리 수명은 주변 온도에 따라 다르며 저온에서는 더 짧을 수 있습니다. 일반적으로 4개의 새 LR6 배터리는 매일 두 번씩 측정할 경우 약 1년간 사용하실 수 있습니다.
- 지정된 배터리만 사용하십시오. 기기와 함께 제공되는 배터리는 테스트용 배터리로 수명이 짧을 수 있습니다.
- 기기를 오랫동안 사용하지 않는 경우 배터리를 분리하십시오.
배터리가 새서 오작동을 일으킬 수 있습니다.

모니터 사용

에어 호스 연결


에어 커넥터 플러그를
에어 소켓에 확실하게
삽입합니다.

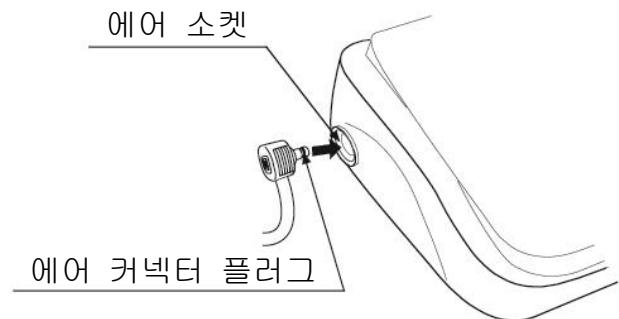

AC 어댑터 연결

AC 어댑터 플러그를 DC 잭에
삽입합니다.

그 다음, AC 어댑터를 전기
콘센트에 연결합니다.

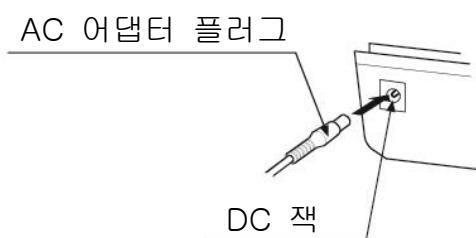

- 지정된 AC 어댑터를 사용합니다.
(22페이지 참조.)
- AC 어댑터를 콘센트에서 분리할 때에는 AC 어댑터의 몸체 부분을
붙잡고 콘센트에서 당겨 빼냅니다.
- AC 어댑터 플러그를 헬ップ 모니터에서 분리할 때에는 모니터의 AC
어댑터 플러그를 붙잡고 당깁니다.

모니터 사용

내장 시계 조정

사용 전에 내장 시계를 맞춥니다.

- 연도가 깜박이기 시작할 때까지 **SET** 버튼을 길게 누릅니다.
- ▲ 또는 ▼ 버튼을 사용하여 연도를 선택합니다.
[SET] 버튼을 눌러 현재 연도를 설정하고 월/일 선택으로 이동합니다. 2010년부터 2059년까지의 모든 날짜를 설정할 수 있습니다.
- ▲ 또는 ▼ 버튼을 사용하여 월을 선택합니다.
[SET] 버튼을 눌러 현재 월을 설정하고 날짜 선택으로 이동합니다.
- ▲ 또는 ▼ 버튼을 사용하여 날짜를 선택합니다.
[SET] 버튼을 눌러 현재 날짜를 설정하고 시간/분 선택으로 이동합니다.
- ▲ 또는 ▼ 버튼을 사용하여 시간을 선택합니다.
[SET] 버튼을 눌러 현재 시간을 설정하고 분 선택으로 이동합니다.
- ▲ 또는 ▼ 버튼을 사용하여 분을 선택합니다.
[SET] 버튼을 눌러 압력 설정 모드로 갑니다. (자세한 내용은 15페이지 참조.)
[START] 버튼을 눌러 기기를 끕니다.

참고: 3분 동안 조작하지 않으면 기기가 자동으로 꺼집니다.


시계가 설정되어 있지 않으면 - - / - - 오른쪽에 나와 있는 것처럼 시계 표시부에 대시가 표시됩니다.

기기를 처음 사용할 때
시계가 조정되지 않았습니다.

기기가 30초 이상 전원에서 분리되는 경우, 설정된 날짜, 시간, 압력 값이 지워집니다.

설정된 날짜, 시간, 압력 값이 지워지면 다시 조정하십시오.

- ▲ 또는 ▼ 버튼을 길게 누르면 값이 계속 변경됩니다.

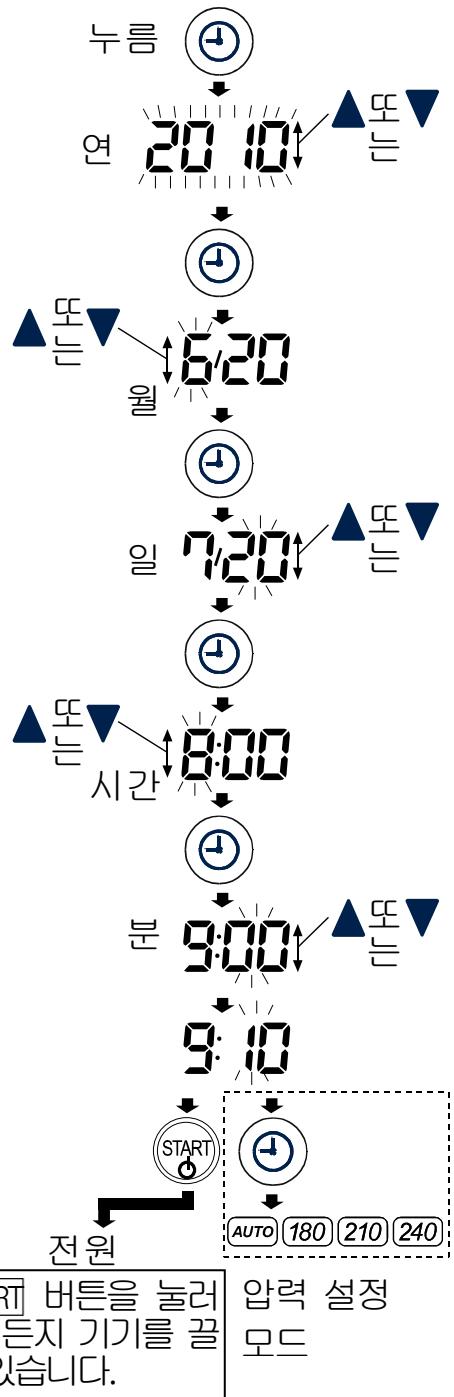

전원

[START] 버튼을 눌러 언제든지 기기를 끌 수 있습니다.

압력 설정 모드

모니터 사용

올바른 커프 사이즈 선택

정확한 판독을 위해서는 올바른 사이즈의 커프를 이용하는 것이 중요합니다.
커프가 적절한 사이즈가 아니면 부정확한 혈압값이 나올 수 있습니다.


- ▣ 팔 사이즈가 각 커프에 인쇄되어 있습니다.
- ▣ 팔 커프는 소모품입니다. 커프가 낡으면 새 것을 구입하십시오.

팔 사이즈	권장 커프 사이즈	카탈로그 번호
31 cm ~ 45 cm	대형 성인용 커프	CUF-D-LA-ISO
22 cm ~ 42 cm	와이드 커프	CUF-I-ISO
23 cm ~ 37 cm	준대형 커프	CUF-D-MA-ISO
22 cm ~ 32 cm	성인용 커프	CUF-F-A-ISO
16 cm ~ 24 cm	소형 커프	CUF-D-SA-ISO
17 cm ~ 32 cm	SmoothFit 성인용 커프	CUF-G-A-ISO

팔 사이즈: 이두박근 둘레.

팔 커프 착용

1. 그림과 같이 팔꿈치 안쪽 위로 약 1~2cm 떨어진 상박 주위를 커프로 감쌉니다.
옷 위로 커프를 감싸면 맥박이 약해져 측정 오류가 발생할 수 있으므로 커프를 피부에 직접 달도록 착용하여 주십시오.
2. 셔츠를 너무 조이게 걸어 올리면 상박이 압박되어 측정이 부정확할 수 있습니다.

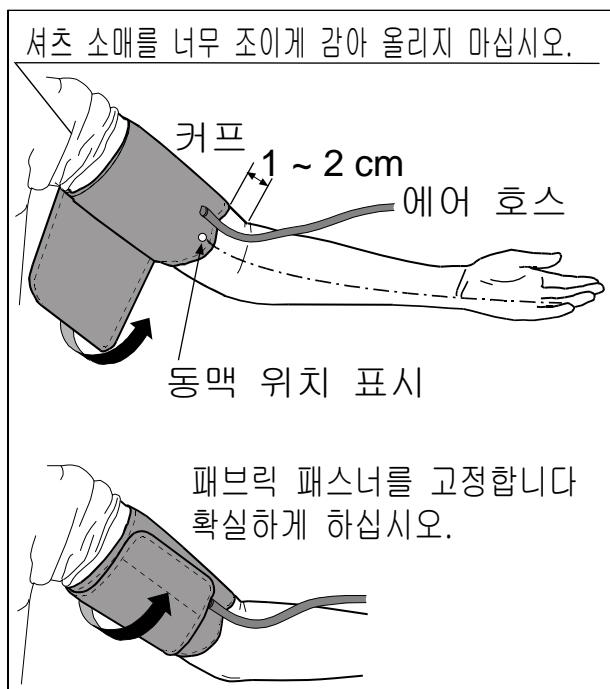

커프에 인쇄된 기호

기호	기능/의미	권고 조치
●	동맥 위치 표시	● 표시를 상박의 동맥에 맞추거나 팔 안쪽에서 약지와 일직선이 되도록 맞춥니다.
[REF]	카탈로그 번호	_____
[LOT]	로트 번호	_____
[Mfg]	제조사	_____
[MD]	의료 기기	_____

모니터 사용

정확하게 측정하는 방법

최대한 정확하게 혈압을 측정하려면 다음과 같이 하십시오.

- 의자에 편안하게 앉습니다. 팔을 테이블 위에 올려 놓습니다. 다리를 꼬지 마십시오. 바닥에 발을 평평하게 대고 등을 똑바로 세우십시오.
- 5분에서 10분간 휴식을 취한 다음에 측정합니다.
- 커프의 중심을 심장과 같은 높이에 둡니다.
- 측정 중에 말하거나 움직이지 말고 가만히 계십시오.
- 운동이나 목욕 직후에는 측정하지 마십시오. 측정하기 전에 20~30분 동안 휴식을 취하십시오.
- 매일 같은 시간에 혈압을 측정합니다.

측정

측정하는 동안 커프가 꽉 조이는 느낌이 드는 것은 정상입니다.
(놀라지 마십시오.)

측정 후

측정 후 **START** 버튼을 눌러 기기를 끕니다.
커프를 벗기고 데이터를 기록합니다.

참고: 본 기기에는 자동 전원 차단 기능이 있어 측정 후 약 1분이 지나면
기기가 꺼집니다.

동일한 사람이 연속 측정할 때는 최소 3분의 간격을 두십시오.

측정

측정하기 전에 16 페이지의 정확한 측정을 위한 참고 사항ⁱⁱ을 참조하십시오.

일반 측정

1. 커프를 팔(가능하면 왼쪽 팔)에 착용합니다. 조용히 가만히 앉아 측정하십시오.

2. **START** 버튼을 누릅니다.

디스플레이 칸의 모든 내용이 표시됩니다. 영(0)이 잠깐 동안 표시되어 깜박입니다. 측정이 시작되면 오른쪽 그림과 같이 디스플레이가 변경됩니다. 커프가 팽창하기 시작합니다. 커프가 꽉 조이게 느껴지는 것은 정상입니다. 팽창하는 동안 표시부의 왼쪽 가장자리에 압력 막대 표시기가 표시됩니다.

참고: 팽창을 멈추고 싶다면 언제든지 **START** 버튼을 다시 누릅니다.

3. 팽창이 완료되면 자동으로 수축이 시작되고 측정이 진행 중임을 나타내는 **♥** (하트마크)가 깜박입니다. 박동이 감지되면 각 맥동과 함께 심장 표시가 깜박입니다.


참고: 적절한 압력에 도달하지 못한 경우, 기기가 자동으로 다시 팽창하기 시작합니다.

재팽창하지 않게 하려면 다음 페이지의 "설정된 혈압으로 측정"을 참조하십시오.

4. 측정이 완료되면 수축기 혈압 및 확장기 혈압과 맥박수가 표시됩니다. 커프에 남아 있는 공기가 배출되고 완전히 수축됩니다.

5. **START** 버튼을 눌러 기기를 끕니다. 1분 동안 조작하지 않으면 기기가 자동으로 깨집니다.

참고: 동일한 사람이 연속으로 측정할 때는 최소 3분의 간격을 두십시오.

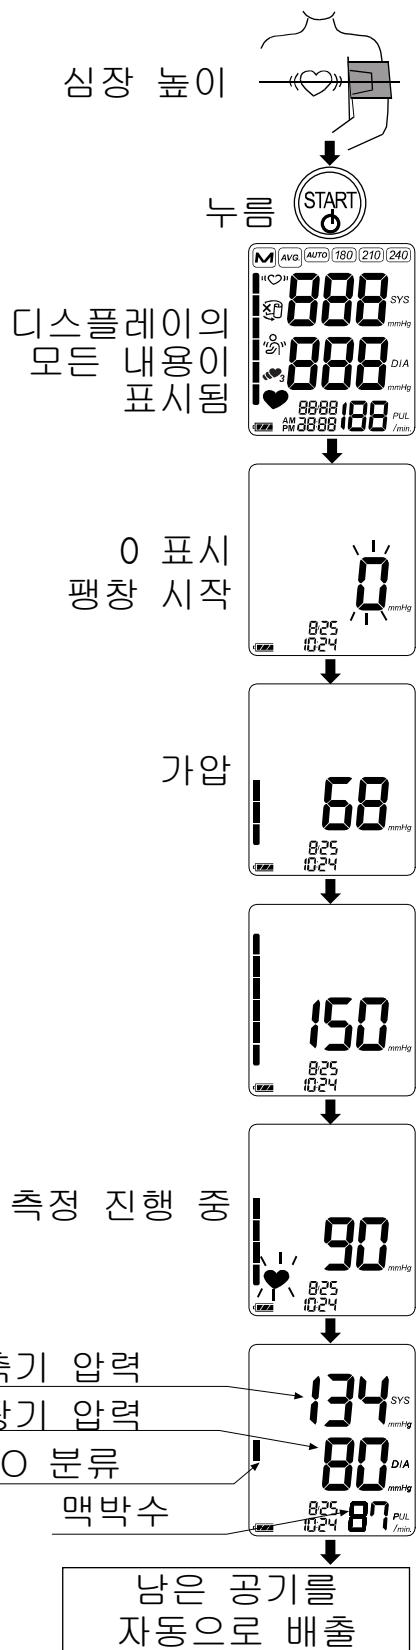


측정

UA-1020은 맥박을 감지하고 수축기 압력 수준까지 자동으로 커프를 가압하도록 설계되어 있습니다.
재팽창이 반복되면 다음 방법을 따르십시오.

설정된 혈압으로 측정


혈압 측정 도중에 재팽창이 일어날 수 있습니다.
이런 재팽창을 막기 위해 고정된 압력 값을 설정할 수 있습니다.

- 시계 설정 절차의 6번째 단계에서(11페이지 참조) **SET** 버튼을 눌러 압력 설정 모드로 갑니다. 현재 설정이 깜빡입니다.

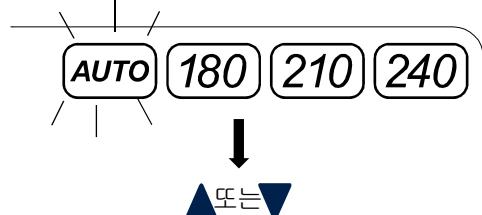

- ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 압력 값을 다음의 예상 수축기 혈압보다 약 30 mmHg 이상 높게 선택합니다.

AUTO	: 자동 가압(기본 값)
180	: 180 mmHg의 압력 값(고정)
210	: 210 mmHg의 압력 값(고정)
240	: 240 mmHg의 압력 값(고정)

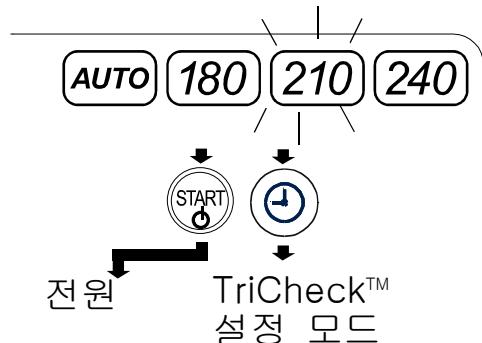


- SET** 버튼을 눌러 TriCheck™ 설정 모드로 갑니다.
START 버튼을 눌러 기기를 끕니다. 3분 동안 조작하지 않으면 기기가 자동으로 꺼집니다.
다음 측정은 새로운 압력 값으로 실시됩니다.

희망 최고 혈압으로 측정

상기 절차에서 압력 값이 **240** 으로 설정되어 있는데도 반복적으로 재팽창이 발생하거나 압력이 20 mmHg 이하로 떨어져도 결과가 표시되지 않을 때 이 방법을 사용하십시오.

- 커프를 팔(가능하면 왼쪽 팔)에 착용합니다.

심장 높이



- 예상 최고 혈압보다 약 30 ~ 40 mmHg 높은 숫자가 나타날 때까지 **START** 버튼을 길게 누릅니다.

버튼을 길게 누름



- 원하는 숫자에 도달하면 **START** 버튼을 눌러 측정을 시작합니다.
이전 페이지에서 설명한 대로 계속해서 혈압을 측정합니다.

희망 최고
혈압에서 버튼을
놓으십시오



이전 페이지의 측정
방법을 참조하십시오.

정확한 측정을 위한 참고 사항

- 편안한 자세로 앉으십시오. 손바닥이 위를 향하고 커프를 가슴과 같은 높이에 위치시킨 상태로 테이블에 팔을 올려 놓습니다.
- 5분에서 10분간 휴식을 취한 다음에 측정합니다. 감정적으로 흥분하거나 우울하면 이러한 감정적 자극이 측정 결과에 영향을 미쳐 혈압 수치가 정상 혈압보다 높거나 낮게 표시되고 맥박은 일반적으로 더 빨라집니다.
- 개인의 혈압은 활동과 식사 내용에 따라 지속적으로 변합니다. 마시는 음료는 혈압에 매우 강하고 빠르게 영향을 미칠 수 있습니다.
- 본 기기는 심장 박동을 기반으로 혈압을 측정합니다. 심장 박동이 매우 약하거나 부정맥이 있는 경우 기기가 혈압을 측정하기 어려울 수 있습니다.
- 기기에 이상이 있을 경우에는 측정이 중단되고 오류 기호가 표시됩니다. 6페이지의 기호 설명을 참조하십시오.
- 이 기기는 성인용으로 고안되었습니다. 이 기기를 어린이에게 사용하기 전에 의사와 상담하십시오. 어린이가 혼자서 기기를 사용하지 않도록 합니다.
- 자동혈압계의 성능 및 혈압측정시의 성능에 영향을 미칠 수 있는 환경적 또는 동작상의 요인에는 동맥경화, 관류저하, 당뇨, 연령, 임신, 임신중독, 신장질환, 환자의 움직임, 떨림, 오한 등이 있습니다.
- 과도한 온도, 습도 또는 고도에서는 자동 혈압 모니터의 성능이 영향을 받을 수 있습니다.

TriCheck™ 측정


TriCheck™ 모드에서는 자동으로 세 번 연속 측정을 하며 이 세 측정치의 평균 값이 표시됩니다.

TriCheck™ 모드 선택

1. 압력 설정 모드에서 **SET** 버튼을 눌러 TriCheck™ 설정 모드로 들어갑니다. 현재 설정이 깜빡입니다.
2. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 TriCheck™ 모드를 켜거나 끕니다.
ON: TriCheck™ 모드
OFF: 일반 측정 모드(기본 값)
3. **START** 또는 **SET** 버튼을 눌러 기기를 끕니다. 3분 동안 조작하지 않으면 기기가 자동으로 꺼집니다.

압력 설정 모드에서


누름



현재 설정이 깜빡입니다.



설정을 변경합니다.




TriCheck™ 모드를 이용한 측정

1. **START** 버튼을 누릅니다.
디스플레이 칸의 모든 내용이 표시됩니다.
영(0)이 잠깐 동안 표시되어 깜박이고 첫 번째 측정이 시작됩니다.
2. 측정이 완료되면 수축기 압력 및 확장기 압력과 맥박수가 표시되고, 1분 후 두 번째 측정까지 카운트다운이 시작됩니다.
3. 1분 후 두 번째 측정이 시작됩니다.
4. 측정이 완료되면 첫 번째와 두 번째 측정의 평균 판독값이 표시되고, 1분 후 세 번째 측정까지 카운트다운이 시작됩니다.
5. 1분 후 세 번째 측정이 시작됩니다.
6. 측정이 완료되면 세 번의 측정의 평균 판독값이 표시되고 메모리에 저장됩니다.

참고:

- 측정 중에 TriCheck™ 기호가 표시됩니다.
- 측정을 취소하려면 **START** 버튼을 누릅니다. 이 경우, 메모리에 저장되는 데이터가 없습니다.
- 첫 번째 측정 도중 커프 장착 오류 기호가 나타나는 경우, 측정을 취소하고 커프를 올바르게 다시 착용한 후 새로 측정을 시작하십시오.
- 측정 후에는 세 번의 측정의 평균 데이터가 메모리에 저장됩니다.
세 번째 측정이 완료되기 전에 측정을 취소하면 아무 데이터도 저장되지 않습니다.

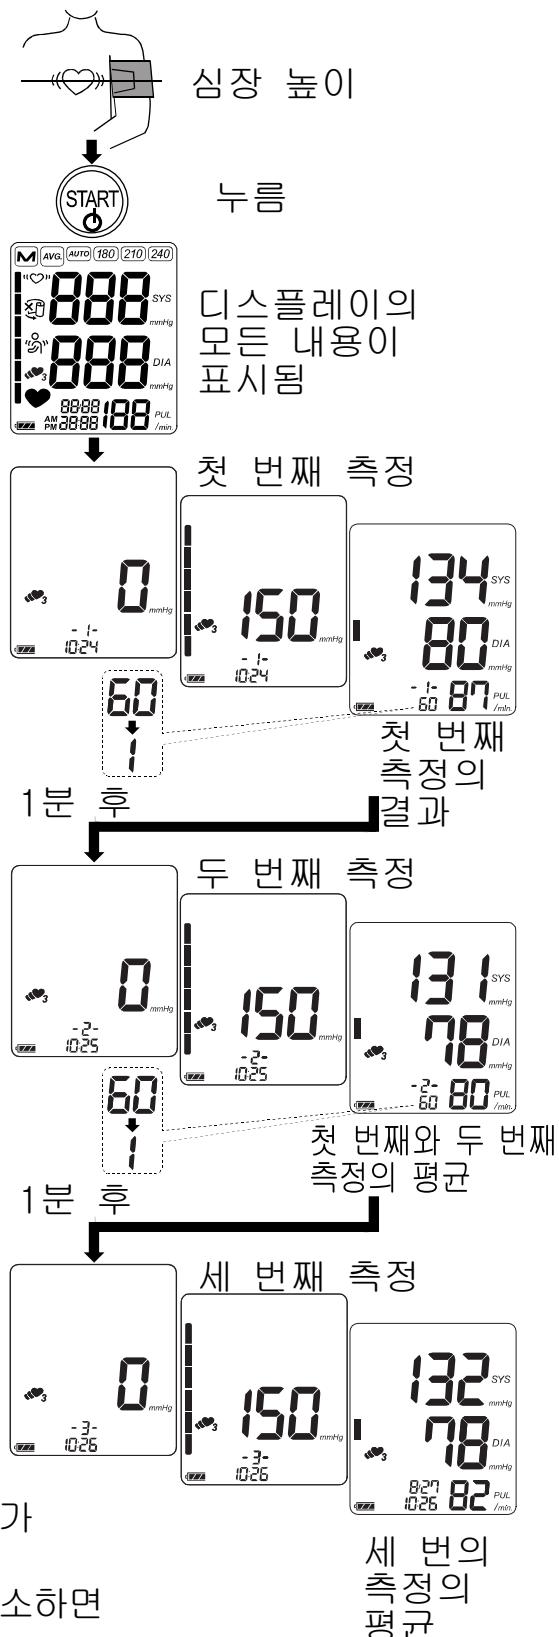

메모리 데이터 불러오기

참고: 이 기기는 최근 90건의 측정 값을 메모리에 저장합니다.

- ▲ 또는 ▼ 버튼을 누릅니다.
모든 측정의 평균과 데이터 수가 표시됩니다.
(데이터가 없으면 "0"이 표시됩니다.)
▲, ▼ 또는 START 버튼을 눌러 기기를 끕니다.)
- ▲ 버튼(또는 ▼ 버튼, 데이터를 역순으로 표시하는 경우)을 누를 때마다 메모리 데이터가 다음과 같이 표시됩니다.


4:00 ~ 9:59 사이에 측정된 모든 AM(오전) 측정치의 평균
(예시에서는 10건의 측정.
데이터가 없는 경우 "--"가 표시됩니다.)

↓
18:00 ~ 1:59 사이에 측정된 모든 PM(오후) 측정치의 평균
(예시에서는 9건의 측정.
데이터가 없는 경우 "--"가 표시됩니다.)

↓
가장 최근 데이터
(No.n, 예시에서는 No.35)
데이터 번호가 표시되고 3초 후에 측정 데이터가 표시됩니다.

⋮

↓
가장 최근 데이터(No.1)
데이터 번호가 표시되고 3초 후에 측정 데이터가 표시됩니다.
- 가장 최근 데이터가 표시된 후 ▼ 버튼을 누르면 모든 측정치의 평균이 다시 표시됩니다.
- START 버튼을 눌러 기기를 끕니다. 1분 동안 조작하지 않으면 기기가 자동으로 깨집니다.

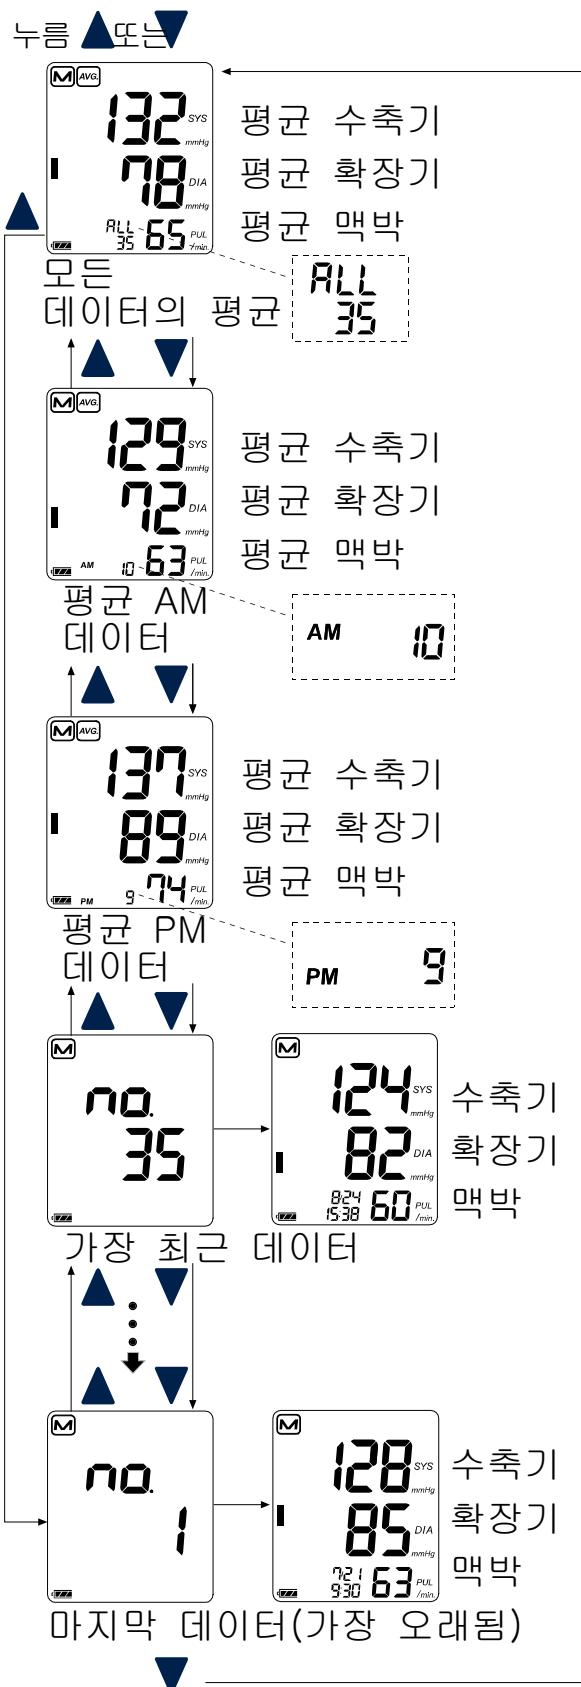

IHB/AFib 표시기란?

모니터가 측정 중에 불규칙한 리듬을 감지하면 IHB/AFib 표시기가 측정 값과 함께 디스플레이에 나타납니다.


참고: 이  IHB/AFib 표시기가 자주 나타나면 의사와 상의할 것을 권합니다.

AFib란?

심장은 심장에서 발생하는 전기 신호로 인해 수축하고 신체를 통해 혈액을 보냅니다. 심방 세동(AFib)은 심방의 전기 신호가 혼란스러워져 맥박 간격의 교란을 유발할 때 발생합니다. AFib는 응혈을 쉽게 일으켜 혈액이 심장에 정체되는 원인이 될 수 있으며, 그로 인해 뇌졸중과 심장 마비가 발생할 수 있습니다.

압력 바 표시기


이 표시기는 측정 중 압력의 진행을 모니터합니다.

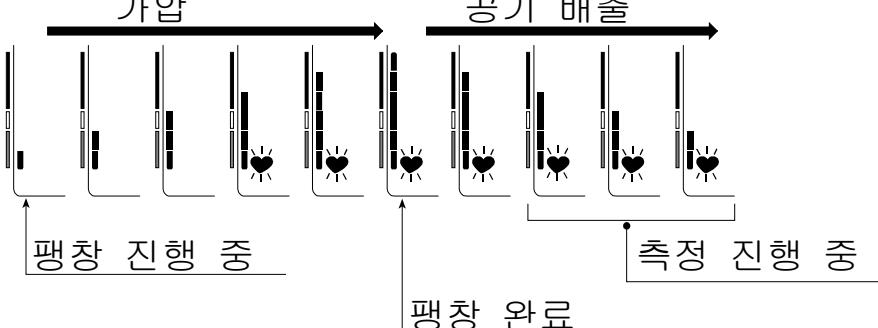

WHO 혈압 등급 표시기

막대 표시기의 각 세그먼트는 다음 페이지에 설명된 WHO 혈압 분류 기준에 해당합니다.

WHO 분류 표시기

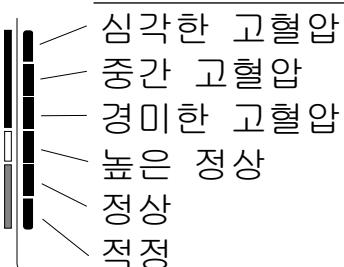

- : 이 표시기는 현재 데이터를 바탕으로 WHO 분류에 따라 세그먼트를 표시합니다.

예시:



중간 고혈압



경미한 고혈압



높은 정상

혈압에 대하여

혈압이란?

혈압은 혈액이 동맥 혈관벽에 가하는 힘입니다. 수축기 압력은 심장이 수축할 때 발생합니다. 확장기 압력은 심장이 팽창할 때 발생합니다. 혈압은 수은주의 높이, 즉 밀리미터 머큐리(mmHg)로 측정됩니다. 사람의 자연 혈압은 아침에 일어나서 공복으로 휴식을 취한 상태로 측정했을 때의 기본 압력으로 표현됩니다.

고혈압 관리의 필요성

비정상적으로 높은 동맥 혈압을 의미하는 고혈압은 방치했을 때 뇌졸중이나 심장 마비 같은 많은 건강 문제를 일으킬 수 있습니다. 고혈압은 생활 습관을 바꾸거나 스트레스를 줄이거나 의사의 지시에 따라 약물 치료를 수행함으로써 조절할 수 있습니다.

고혈압을 예방하거나 관리하려면:

- 금연하기
- 규칙적으로 운동하기
- 짜고 지방이 많은 음식 줄이기
- 정기 검진 받기
- 정상 체중 유지하기

집에서 혈압을 측정해야 하는 이유는 무엇일까요?

진료소나 의사 진찰실에서 측정된 혈압은 긴장을 유발하여 집에서 측정한 것보다 25–30 mmHg 높은 수치를 나타낼 수 있습니다. 가정에서 측정한 혈압은 혈압 측정에 미치는 외부 영향을 줄이고 의사의 판독 값을 보완하며 보다 정확하고 완전한 혈압 기록을 제공합니다.

WHO 혈압 분류


세계보건기구(WHO)에서는 본 차트와 같이 나이와 상관없이 고혈압을 평가할 수 있는 기준을 수립했습니다.

혈압의 변동


개인의 혈압은 하루 동안에도 변하고 계절별로도 크게 달라집니다. 하루 동안 다양한 조건으로 인해 30에서 50 mmHg까지 달라질 수

있습니다. 고혈압 환자의 경우 변동 폭이 더욱 뚜렷합니다. 일반적으로 업무 시간이나 몸을 움직일 때 혈압이 올라가고 수면 중에는 혈압이 최저 수준으로 떨어집니다. 따라서 한 번의 측정 결과에 지나치게 관심을 두지 마십시오.

참고 자료: Journal of Hypertension 1999, Vol 17 No.2

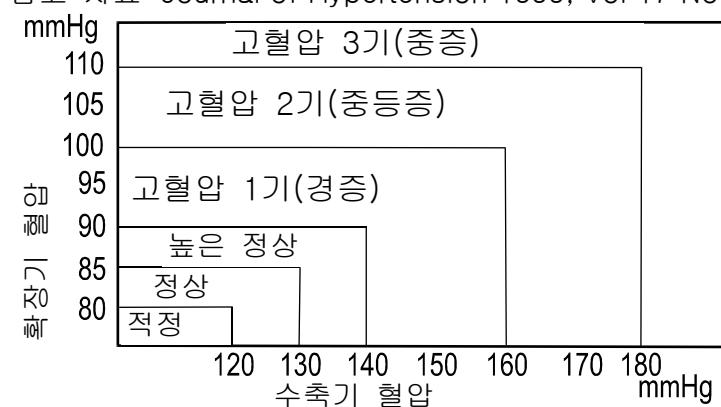

이 설명서에 설명된 절차에 따라 매일 같은 시간에 혈압을 측정하면 정상 혈압을 알 수 있습니다. 정기적인 수치가 보다 포괄적인 혈압 이력을 제공합니다. 혈압을 측정할 때의 날짜와 시간을 적어 두십시오. 의사와 상의하여 혈압 데이터를 해석하십시오.

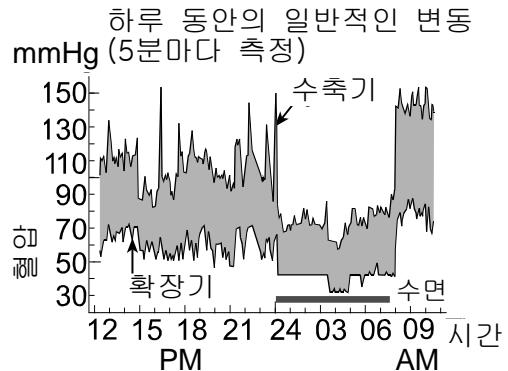

문제 해결

문제	가능한 원인	권고 조치
전원을 켜도 표시부에 아무 것도 나타나지 않습니다.	배터리가 방전되었습니다. 배터리 단자가 정확한 위치에 있지 않습니다.	모든 배터리를 새 것으로 교체하십시오. 배터리 함의 표시에 따라 음극과 양극 단자를 맞추어 배터리를 다시 설치하십시오.
커프가 팽창하지 않습니다.	배터리 전압이 너무 낮습니다. ▣ (배터리 부족 표시)가 깜빡입니다. 배터리가 완전히 방전되면 이 표시가 나타나지 않습니다.	모든 배터리를 새 것으로 교체하십시오.
장치가 측정을 수행하지 않습니다. 판독 값이 너무 높거나 낮습니다.	커프를 제대로 작용하지 않았습니다.	커프를 바르게 착용하십시오.
	측정 중에 팔이나 몸을 움직였습니다.	측정 중에 몸을 움직이지 말고 조용히 계십시오.
	커프 위치가 올바르지 않습니다.	편안하게 가만히 앉으십시오. 손바닥이 위를 향하고 커프를 가슴과 같은 높이에 위치시킨 상태로 테이블에 팔을 올려 놓습니다.
	_____	심장 박동이 매우 약하거나 부정맥이 있는 경우 기기가 혈압을 측정하기 어려울 수 있습니다.
기타	측정 값이 진료소나 의사 진찰실에서 측정한 값과 다릅니다.	"집에서 혈압을 측정해야 하는 이유는 무엇일까요"를 참조하십시오.
	_____	배터리를 제거하십시오. 배터리를 다시 끼우고 측정을 다시 시도하십시오.

참고: 위에 설명한 방법으로 문제가 해결되지 않으면 판매 대리점에 문의하십시오. 본 제품을 개봉하거나 개조하면 보증이 무효화됩니다.

유지보수

기기를 열지 마십시오. 본 제품에는 섬세한 전기 부품과 복합 공기 장치가 사용되었기 때문에 손상 위험이 있습니다. 문제 해결 지침을 이용하여 문제를 해결할 수 없는 경우 해당 지역의 공인 판매점이나 당사 고객 서비스 부서에 문의하십시오. A&D 고객 서비스 부서에서는 공인 판매점에 기술 정보, 부품 및 장치를 제공합니다.

이 기기는 장기간 사용하도록 설계 및 제조되었습니다. 그러나 적절한 기능과 정확성을 보장하기 위해 2년마다 기기 검사를 받는 것이 좋습니다. 해당 지역의 공인 판매점이나 A&D에 유지, 관리를 문의하십시오.

사양

명칭	수입원 : 한국에이엔디(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 33 맨하탄빌딩 817 ·자동전자혈압계, UA-1020
수입품목인증번호	수인 13-896호
측정 방법	오실로메트릭법
측정 범위	압력: 0~299mmHg 수축기 압력: 60 ~ 279 mmHg 확장기 압력: 40 ~ 200 mmHg 맥박: 40 ~ 180박/분
측정 정확도	압력: ±3mmHg 맥박: ±5%
정격 범위	DC 6V 3W
전원 공급	1.5V 배터리 4개(R6P, LR6 또는 AA) 또는 AC 어댑터(6V, 500mA),(미포함/ 반드시 정품 어댑터를 구매하여 사용하시기 바랍니다)
측정 횟수	약 AA 알카라인 배터리를 사용 시 23 °C의 실온에서 180 mmHg의 압력 값으로 약 1000회 측정.
분류	내부 전원 ME 장비(배터리 사용) / Class II(어댑터 사용) 연속 작동 모드
임상 시험	ISO81060-2 : 2013에 따름 임상 시험에서 K5는 85명의 확장기 혈압을 측정하는 데 사용되었습니다.

시험 규격	제 의기변 10-03-20210402-0486호(2021.09.29) 한국기계전기전자시험연구원 IEC 60601-1-2: 2014
메모리	최근 90건 측정치
작동 조건	+10 ~ +40 °C / 15 ~ 85 %RH / 800 ~ 1,060 hPa
운송 / 보관 조건	-20 ~ +60 °C / 10 ~ 95 %RH / 700 ~ 1,060 hPa
크기	약 140 [W] x 60 [H] x 105 [D] mm
무게	약 285 g, 배터리 제외
보호등급	기기: IP20
장착부	커프 형식 BF 
사용 수명	기기: 5년(하루 6회 사용 기준) 커프: 2년(하루 6회 사용 기준) AC 어댑터: 5년(하루 6회 사용 기준)

액세서리 AC 어댑터 TB-233C 이 어댑터는 혈압 모니터를 가정 전압에 연결하기 위한 용도입니다.
현지 A&D 판매 대리점에 연락하여 구입하시기 바랍니다.
AC 어댑터는 주기적으로 검사하거나 교체해야 합니다.

AC 어댑터에 인쇄된 기호

기호	기능/의미
	실내 전용
	클래스 II 기기
	온도 퓨즈
	퓨즈
	EC 지침안 준수 기기 라벨
	EAC 인증 기기 라벨
	AC 어댑터 플러그 극성

별도 판매 액세서리 커프

카탈로그 번호	커프 사이즈	팔 사이즈
CUF-D-LA-ISO	대형 성인용 커프	31 cm ~ 45 cm
CUF-I-ISO	와이드 커프	22 cm ~ 42 cm
CUF-D-MA-ISO	준대형 커프	23 cm ~ 37 cm
CUF-F-A-ISO	성인용 커프	22 cm ~ 32 cm
CUF-D-SA -ISO	소형 커프	16 cm ~ 24 cm
CUF-G-A-ISO	SmoothFit 성인용 커프	17 cm ~ 32 cm

AC 어댑터

카탈로그 번호	플러그(콘센트 유형)
TB-233C	형식 C

참고: 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

IP 분류는 IEC 60529에 따라 외부 케이스가 제공하는 보호 등급입니다. 본 기기는 손가락 같은 12 mm 직경 이상의 이물질로부터 보호됩니다. 본 기기는 방수 기능이 없습니다.

수입원 : 한국에이엔디(주)

서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 33 맨하탄빌딩 817

제조의뢰자 : A&D Company, Limited

일본, 1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585 Japan

제조자 : A&D Electronics(Shenzhen) Co.,Ltd.

중국, 1-5/F, Building #4, Heungchangrong High Tech Industry Park, Shangnan East Road, Hongtian, Shajing, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, 518125, P.R. China

첨부문서 작성연월일 : 2025년 1월 15일 작성 <3제판>

Daftar Isi

Pelanggan yang Terhormat.....	2
Keterangan Awal	2
Tindakan Pencegahan.....	2
Kontraindikasi	3
Identifikasi bagian–bagian alat.....	5
Simbol	6
Mode Pengoperasian	8
Menggunakan Monitor	9
Memasang/Menukar Baterai	9
Menyambungkan Selang Udara.....	10
Menghubungkan Adaptor AC	10
Menyetel Jam Built-in	11
Memilih Ukuran Manset yang Tepat	12
Menggunakan Manset Lengan	12
Cara Mendapatkan Pengukuran yang Akurat.....	13
Pengukuran	13
Setelah Pengukuran	13
Pengukuran	14
Pengukuran Normal.....	14
Pengukuran dengan Tekanan SET.....	15
Pengukuran dengan Tekanan Sistolik yang Diinginkan.	15
Catatan untuk Pengukuran yang Akurat	16
Pengukuran TriCheck™	16
Menampilkan Kembali Data Memori	18
Apa itu Indikator IHB/AFib?	19
Apa itu AFib?	19
Indikator Batang Tekanan	19
Indikator Klasifikasi WHO	19
Tentang Tekanan Darah	20
Apa itu Tekanan Darah?.....	20
Apa itu Hipertensi dan Bagaimana cara Mengatasinya? ...	20
Kenapa perlu Mengukur Tekanan Darah di Rumah?	20
Klasifikasi Tekanan Darah WHO.....	20
Variasi Tekanan Darah.....	21
Penyelesaian masalah	21
Pemeliharaan	22
Data Teknis	23

Pelanggan yang Terhormat

Selamat atas pembelian monitor tekanan darah A&D canggih Anda. Dirancang agar mudah digunakan serta akurat. Alat ini akan mempermudah rejimen tekanan darah harian Anda.

Kami menyarankan agar Anda membaca buku panduan ini secara saksama sebelum menggunakan untuk pertama kali.

Keterangan Awal

- Alat ini dirancang untuk digunakan pada orang dewasa, bukan untuk anak yang baru lahir atau bayi.
- Lingkungan penggunaan. Alat ini dimaksudkan agar digunakan oleh Anda sendiri di lingkungan perawatan kesehatan rumah.
- Alat ini dirancang untuk mengukur tekanan darah dan denyut nadi manusia untuk keperluan diagnosis.

Tindakan Pencegahan

- Komponen yang presisi digunakan dalam pembuatan alat ini. Hindari alat dari suhu ekstrem, kelembapan, sinar matahari langsung, goncangan atau debu.
- Bersihkan alat dan manset dengan kain lembut yang kering atau kain yang dibasahi dengan air dan deterjen netral. Jangan gunakan alkohol, benzena, thinner atau bahan kimia keras lainnya untuk membersihkan alat atau manset.
- Hindari melipat manset dengan kencang atau menyimpan selang yang dililit kuat untuk waktu yang lama, hal seperti itu akan mempersingkat masa pakai komponen alat.
- Berhati-hatilah agar bayi tidak tercekik selang dan kabel.
- Jangan melilit selang udara pada saat melakukan pengukuran. Hal ini dapat menyebabkan cedera akibat tekanan yang terus menerus pada manset.
- Alat dan manset tidak tahan air. Jangan biarkan alat dan manset terkena hujan, keringat dan air.
- Pengukuran dapat berubah jika alat digunakan di dekat televisi, oven mikrogelombang, ponsel, sinar-X atau perangkat lainnya yang memiliki medan magnet yang kuat.
- Alat komunikasi nirkabel, seperti perangkat jaringan rumah, ponsel, telepon kabel dan BTS serta walkie-talkie dapat mempengaruhi monitor tekanan darah ini.
Oleh karena itu, tempatkan alat dengan jarak minimum 30 cm dari perangkat-perangkat tersebut.
- Jangan menangani peralatan, komponen-komponen alat dan baterai yang digunakan seperti sampah rumah tangga yang biasa, semua bekas penggunaan alat harus dibuang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

- Saat adaptor AC digunakan, pastikan adaptor AC dapat dengan mudah dilepas dari outlet listrik bila perlu.
- Pastikan bahwa alat telah bersih sebelum digunakan kembali.
- Jangan memodifikasi alat. Hal tersebut dapat menyebabkan kecelakaan atau kerusakan pada alat.
- Untuk mengukur tekanan darah, lengan harus diapit dengan cukup kuat oleh manset agar dapat menghentikan aliran darah sementara melalui pembuluh nadi. Hal ini dapat menimbulkan rasa sakit, mati rasa atau tanda merah sementara pada lengan. Kondisi ini akan muncul khususnya ketika pengukuran dilakukan secara berturut-turut.
Rasa sakit, mati rasa, atau tanda merah akan hilang seiring berjalannya waktu.
- Melakukan pengukuran tekanan darah terlalu sering dapat membahayakan akibat dari gangguan pada aliran darah. Lakukan pemeriksaan agar pengoperasian alat tidak mengakibatkan gangguan sirkulasi darah jangka panjang ketika menggunakan alat secara berulang-ulang.
- Uji klinis belum dilakukan pada bayi yang baru lahir dan ibu hamil. Jangan menggunakan alat pada bayi yang baru lahir dan ibu hamil.
- Jika Anda pernah melakukan mastektomi, konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan alat.
- Jangan biarkan anak-anak menggunakan alat sendiri dan jauhkan dari jangkauan bayi. Hal tersebut dapat menyebabkan kecelakaan atau kerusakan pada alat.
- Ada beberapa komponen kecil alat yang dapat menyebabkan bahaya tersedak jika tidak sengaja tertelan oleh bayi.
- Jangan menyentuh baterai, konektor DC, dan pasien pada saat yang sama. Hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Lepaskan adaptor AC ketika tidak sedang menggunakan alat untuk pengukuran.
- Penggunaan aksesoris tidak dijelaskan di manual ini dan hal tersebut kemungkinan dapat membahayakan keselamatan.
- Jika baterai mengalami korsleting, maka baterai bisa menjadi panas dan terbakar.
- Berikan waktu kepada alat agar beradaptasi dengan lingkungan sekitar sebelum menggunakannya (sekitar satu jam).
- Jangan memompa alat tanpa memasang manset pada lengan atas.



Kontraindikasi

Berikut ini adalah tindakan pencegahan untuk cara penggunaan alat yang benar.


- Jangan menggunakan manset pada lengan yang dipasang peralatan medis listrik lain. Alat kemungkinan tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.
- Orang yang mengalami defisit peredaran darah pada lengan harus berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan alat ini agar terhindar dari masalah medis.

- Jangan mendiagnosis sendiri hasil pengukuran dan memulai perawatan dengan diri Anda sendiri. Selalulah konsultasikan kepada dokter Anda tentang evaluasi hasil dan perawatan.
- Jangan menggunakan manset pada lengan dengan luka yang belum sembuh.
- Jangan menggunakan manset pada lengan yang sedang diinfus intravena atau transfusi darah. Hal tersebut dapat menyebabkan cedera atau petaka.
- Jangan menggunakan alat di dekat gas mudah terbakar dan gas anestesi. Hal tersebut dapat mengakibatkan ledakan.
- Jangan menggunakan alat di lingkungan dengan oksigen berkonsentrasi tinggi, seperti ruangan dengan oksigen bertekanan tinggi atau tenda oksigen. Hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan.

Identifikasi bagian-bagian alat

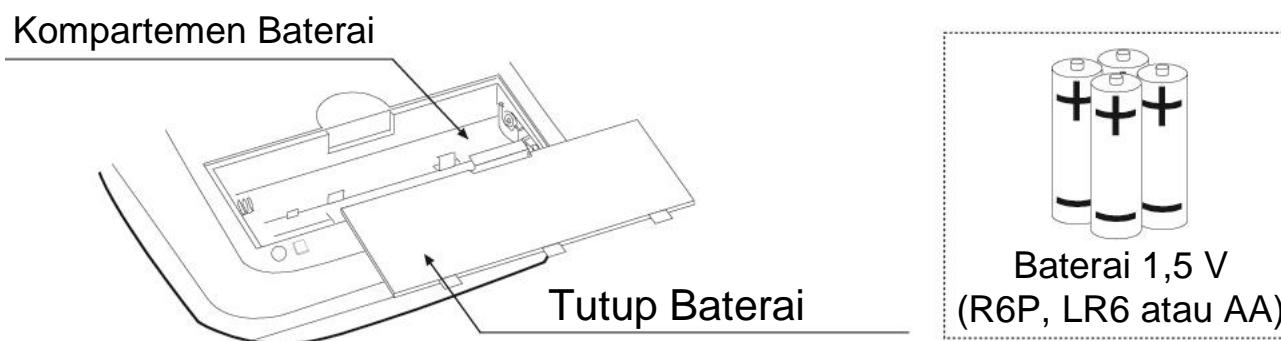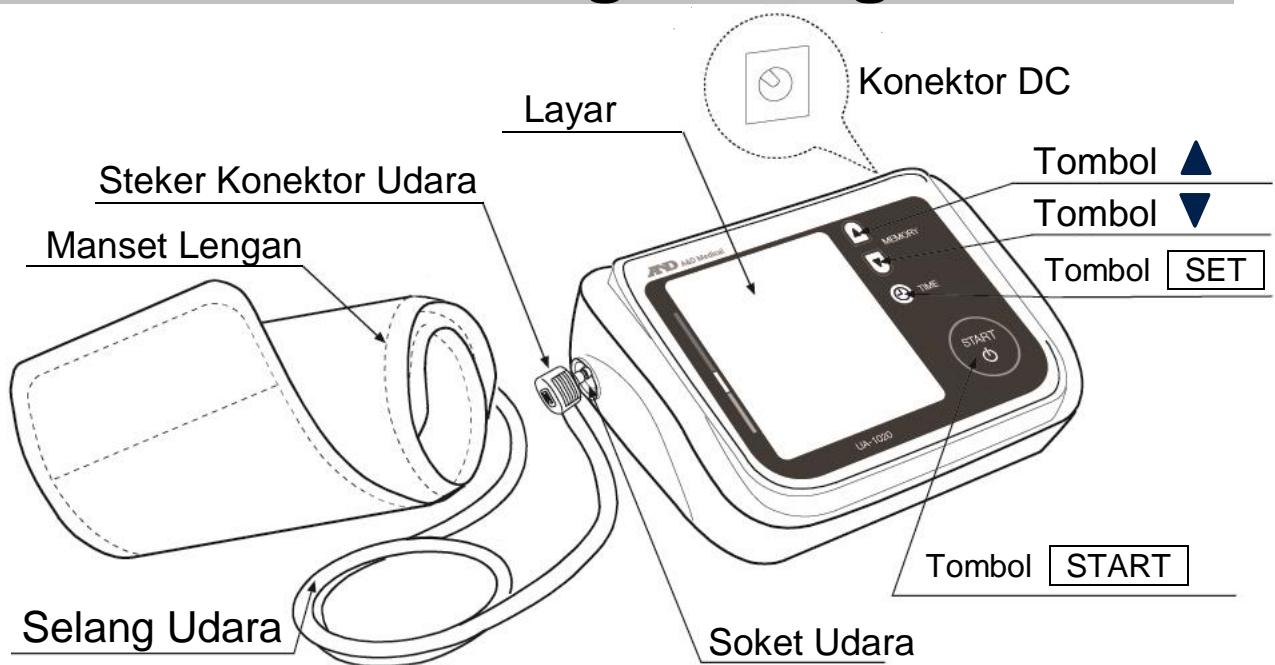

Layar

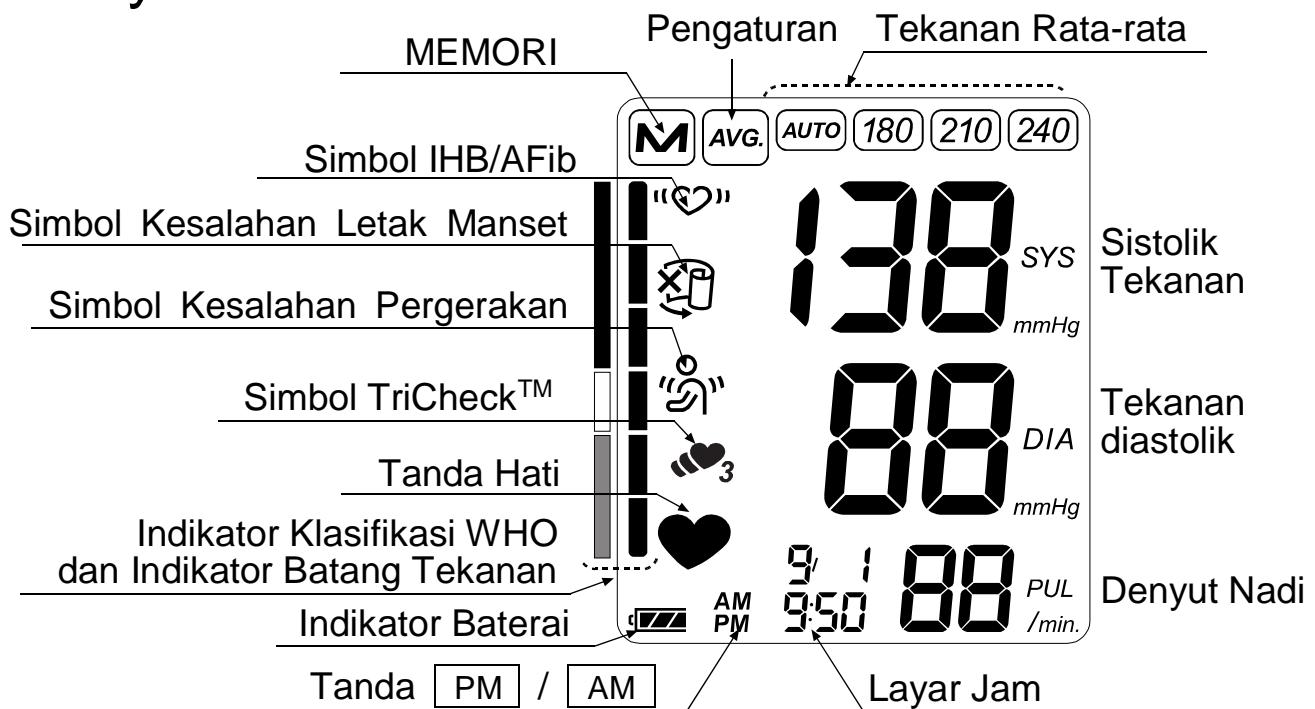

Simbol

Simbol yang tertera pada tutup alat.

Simbol	Fungsi/Arti
	Bersiap dan Nyalakan alat.
	Panduan pemasangan baterai
	Arus searah
SN	Nomor seri
	Produsen
2020	Tanggal pembuatan
	Tipe BF: Manset dirancang untuk memberikan perlindungan khusus terhadap kejutan listrik.
	Jangan menangani peralatan, bagian-bagian alat dan baterai yang digunakan seperti sampah rumah tangga yang biasa, semua bekas penggunaan alat harus dibuang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
	Mengacu pada panduan/buku panduan
	Polaritas konektor DC
IP	Simbol perlindungan internasional
	Jaga alat agar tetap kering

Simbol yang muncul pada layar

Simbol	Fungsi/Arti	Tindakan yang dianjurkan
	Muncul saat pengukuran sedang berlangsung. Layar akan berkedip ketika denyut terdeteksi.	Pengukuran sedang berlangsung. Usahakan jangan bergerak.
	Simbol IHB/AFib Muncul ketika denyut jantung tidak beraturan terdeteksi. Lampu alat kemungkinan akan menyala ketika vibrasi yang lemah seperti menggigil atau gemetaran terdeteksi.	_____
	Mode TriCheck™ Mengambil tiga pengukuran berturut-turut secara otomatis dan menampilkan nilai rata-rata dari tiga pengukuran.	_____
	Muncul ketika gerakan tubuh atau lengan terdeteksi.	Pembacaan kemungkinan akan menghasilkan nilai yang salah. Lakukan kembali pengukuran.Jangan bergerak ketika sedang melakukan pengukuran.

Simbol	Fungsi/Arti	Tindakan yang dianjurkan
	Muncul selama pengukuran ketika manset terpasang longgar.	Pembacaan kemungkinan akan menghasilkan nilai yang salah. Pasang manset dengan benar, dan lakukan pengukuran lagi.
	Pengukuran yang sebelumnya akan tersimpan di dalam MEMORI.	_____
	Data rata-rata	_____
	BATERAI PENUH Indikator daya baterai selama pengukuran.	_____
	BATERAI LEMAH Daya baterai lemah ketika lampu alat berkedip.	Ganti semua baterai dengan yang baru ketika lampu alat berkedip.
	Tekanan darah tidak stabil dikarenakan adanya pergerakan pada saat pengukuran.	Lakukan kembali pengukuran. Jangan bergerak ketika sedang melakukan pengukuran.
	Nilai sistolik dan diastolik adalah masing-masing 10 mmHg.	Pasang manset dengan benar, dan lakukan pengukuran lagi.
	Nilai tekanan tidak naik selama inflasi.	
	Manset tidak terpasang dengan benar.	Pasang manset dengan benar, dan lakukan pengukuran lagi.
	KESALAHAN LAYAR PUL Denyut tidak terdeteksi dengan benar.	
	Monitor tekanan darah internal mengalami kesalahan	Keluarkan baterai dan tekan tombol START , dan kemudian pasang kembali baterai. Jika kesalahan tetap terjadi, hubungi penjual.
SYS	Tekanan darah sistolik dalam mmHg	_____
DIA	Tekanan darah diastolik dalam mmHg	_____
PUL	Denyut per menit	_____
PM	Muncul saat data rata-rata ditampilkan. Data diambil pada jam 4:00 dan 9:59	_____
AM	Muncul saat data rata-rata ditampilkan. Data diambil pada 18:00 dan 1:59	_____
	Pengatur tekanan Menunjukkan nilai tekanan yang sebelumnya disetel oleh pengguna.	_____

Mode Pengoperasian

1. Pengukuran Normal

Tekan tombol **START**. Tekanan darah diukur dan data disimpan dalam memori. Alat ini dapat menyimpan 90 pengukuran terkini di dalam memori.

2. Mengembalikan Data

Tekan tombol **▲** atau **▼** untuk mengembalikan data dalam memori. Rata-rata semua pengukuran ditampilkan, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan.

Lalu, setiap kali tombol **▼** ditekan, maka data memori ditampilkan sebagai berikut.


Rata-rata semua pengukuran AM (pagi) yang dilakukan antara pukul 4:00 dan 9:59.

Rata-rata semua pengukuran PM (sore) yang dilakukan antara pukul 18:00 dan 1:59.

Data terbaru (No.n, pada contoh, No.35)


Data terakhir (No.1)

Untuk detail tentang mengembalikan data, Lihat "Menampilkan Kembali Data Memori".

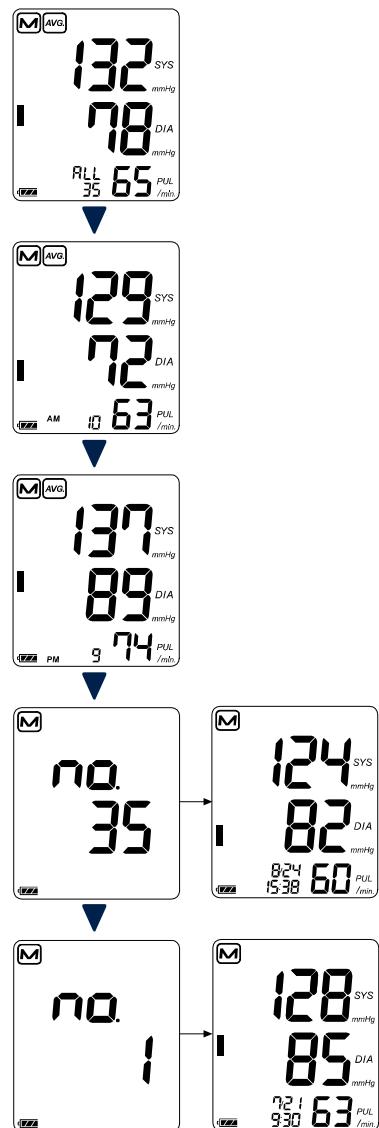

3. Menghapus Data yang Tersimpan di dalam Memori

Tekan tombol **▲** dan **▼**. Tanda **M** dan indikator baterai muncul. Tekan dan tahan tombol **▲** dan **▼** sampai tanda **M** yang berbahaya mulai berkedip untuk menghapus semua data yang tersimpan dalam memori.




4. Pengukuran dengan Tekanan Sistolik yang Diinginkan.

Lihat halaman 15 tentang pengukuran dengan tekanan sistolik yang diinginkan.

Menggunakan Monitor

Memasang/Menukar Baterai

1. Buka tutup baterai.
2. Lepaskan baterai lama dan masukkan baterai baru ke dalam kompartemen baterai seperti yang ditunjukkan gambar, pastikan pemasangan baterai sesuai dengan polaritas (+ dan -). Gunakan hanya baterai R6P, LR6 atau AA.
3. Tutup kompartemen baterai.

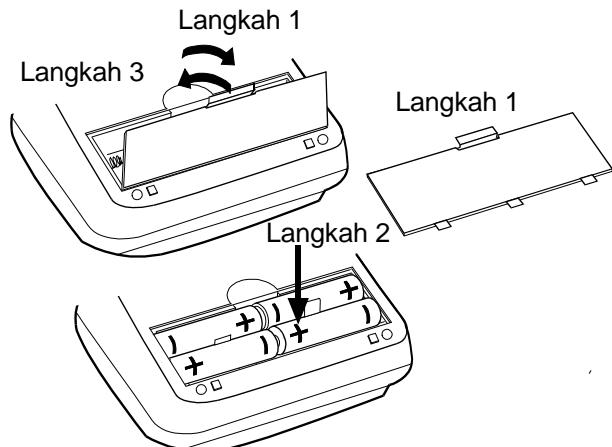


PERINGATAN

- Masukkan baterai seperti yang ditunjukkan pada kompartemen baterai. Jika baterai tidak terpasang dengan benar, alat tidak akan berfungsi.
- Ketika (tanda BATERAI LEMAH) berkedip di layar, ganti semua baterai dengan yang baru. Jangan mencampur antara baterai yang lama dengan yang baru. Hal tersebut dapat mempersingkat masa pakai baterai, atau menyebabkan malfungsi pada alat.
Ganti baterai dua detik atau lebih sesudah alat dimatikan.
Jika (tanda BATERAI LEMAH) muncul bahkan setelah baterai diganti, lakukan pengukuran tekanan darah. Perangkat kemudian dapat mengenali baterai baru.
- (tanda BATERAI LEMAH) tidak muncul ketika daya baterai telah habis.
- Masa pakai baterai tergantung suhu sekitar dan kemungkinan lebih cepat habis di suhu rendah. Biasanya, empat buah baterai LR6 yang baru akan bertahan kira-kira satu tahun ketika digunakan dua kali pengukuran untuk setiap harinya.
- Gunakan hanya baterai yang sudah ditentukan saja. Baterai membuat alat dapat berfungsi untuk pengujian kinerja monitor dan memiliki masa pakai terbatas.
- Keluarkan baterai jika alat tidak ingin dipakai untuk waktu yang lama. Baterai dapat bocor dan menyebabkan malfungsi.

Menggunakan Monitor

Menyambungkan Selang Udara


Masukkan steker konektor udara ke dalam soket udara dengan benar.

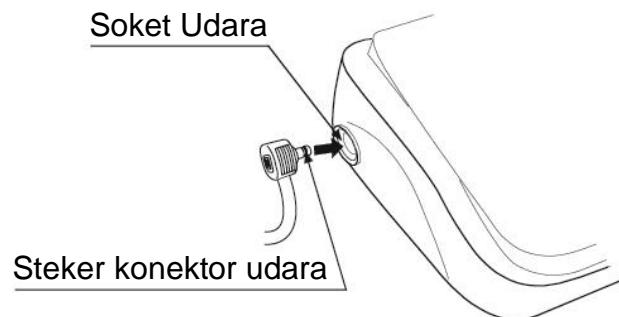

Menghubungkan Adaptor AC

Masukkan steker adaptor AC ke konektor DC.

Kemudian, sambungkan adaptor AC ke outlet listrik.

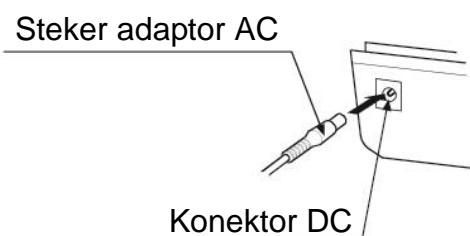

- Gunakan hanya adaptor AC yang sudah ditentukan.
(Lihat halaman 22.)
- Ketika sedang melepaskan adaptor AC dari outlet listrik, genggam dan tarik bodi adaptor AC dari stop kontak.
- Ketika sedang melepaskan steker adaptor AC dari monitor tekanan darah, genggam dan tarik bodi steker adaptor AC dari monitor.

Menggunakan Monitor

Menyetel Jam Built-in

Setel jam sebelum digunakan.

1. Tekan tombol **SET** sampai tahun mulai berkedip.
2. Pilih tahun menggunakan tombol **▲** atau **▼**. Tekan tombol **SET** untuk mengatur tahun saat ini dan pindah ke pilihan bulan/hari. Tanggal dapat diatur di mana saja antara tahun 2010 dan 2059.
3. Pilih bulan menggunakan tombol **▲** atau **▼**. Tekan tombol **SET** untuk menyetel bulan saat ini dan pindah ke pemilihan hari.
4. Pilih hari menggunakan tombol **▲** atau **▼**. Tekan tombol **SET** untuk menyetel hari saat ini dan pindah ke pemilihan jam/menit.
5. Pilih jam menggunakan tombol **▲** atau **▼**. Tekan tombol **SET** untuk menyetel jam saat ini dan pindah ke pemilihan menit.
6. Pilih menit menggunakan tombol **▲** atau **▼**. (Tekan tombol **SET** untuk masuk ke mode pengaturan tekanan. Untuk detailnya, lihat halaman 15.)
Tekan tombol **START** untuk mematikan daya.

Catatan: Setelah tiga menit alat tidak dioperasikan, alat akan mati secara otomatis.


Bila jam belum disetel,
tampilan jam menunjukkan **- - / - -**
tanda hubung seperti yang **- : - -**
ditunjukkan di sebelah kanan.

Saat menggunakan alat untuk pertama kalinya, jam belum disetel.

Ketika alat terputus dari pasokan daya selama lebih dari 30 detik, tanggal, waktu, dan nilai tekanan yang ditetapkan akan dihapus.

Ketika tanggal, waktu dan nilai tekanan yang disetel terhapus, maka setel kembali.

- Menahan tombol **▲** atau **▼** akan mengubah nilainya terus menerus.

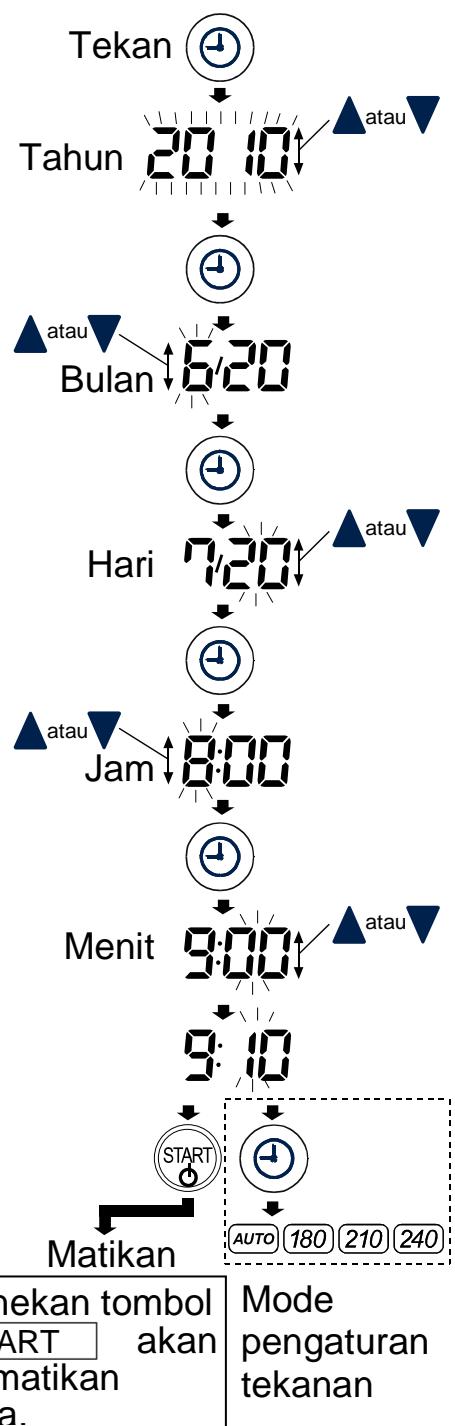

Menekan tombol **START** akan mematikan daya.

Mode pengaturan tekanan

Menggunakan Monitor

Memilih Ukuran Manset yang Tepat

Sangat penting untuk menggunakan ukuran manset yang tepat agar memperoleh pembacaan yang tepat. Jika ukuran manset tidak tepat, pembacaannya kemungkinan akan menghasilkan nilai tekanan darah yang salah.

- Ukuran lengan tertera pada setiap manset.
- Manset lengan adalah barang habis pakai. Jika manset telah usang, belilah yang manset yang baru.

Ukuran Lengan	Ukuran Manset yang Disarankan	Nomor Katalog
31 cm sampai 45 cm	Manset Dewasa Ukuran Besar	CUF-D-LA-ISO
22 cm sampai 42 cm	Manset ukuran lebar	CUF-I-ISO
23 cm sampai 37 cm	Manset Ukuran Semi Besar	CUF-D-MA-ISO
22 cm sampai 32 cm	Manset dewasa	CUF-F-A-ISO
16 cm sampai 24 cm	Manset kecil	CUF-D-SA-ISO
17 cm sampai 32 cm	Manset dewasa SmoothFit	CUF-G-A-ISO

Ukuran lengan: Lingkar bisep.

Menggunakan Manset Lengan

1. Balutkan manset pada lengan atas, sekitar 1 sampai 2 cm di atas siku, seperti yang ditunjukkan pada gambar.
Pasang manset langsung di atas kulit, karena pakaian dapat menyebabkan denyut nadi yang lemah dan membuat kesalahan pengukuran.
2. Konstriksi lengan atas, disebabkan karena menggulung lengan baju ke atas dapat menghalangi pembacaan yang akurat.



Simbol yang tertera pada manset

Simbol	Fungsi/Arti	Tindakan yang dianjurkan
●	Tanda Letak Pembuluh Nadi	Atur tanda ● pada pembuluh nadi lengan atas atau sejajar dengan jari manis di bagian dalam lengan.
[REF]	Nomor Katalog	_____
[LOT]	Nomor Lot	_____
[Mfg]	Produsen	_____
[MD]	Alat Kesehatan	_____

Menggunakan Monitor

Cara Mendapatkan Pengukuran yang Akurat

Untuk mendapatkan hasil pengukuran tekanan darah yang paling akurat:

- Duduklah dengan tenang di atas kursi. Lemaskan lengan Anda di atas meja. Jangan menyilangkan kaki Anda. Tempatkan kaki Anda dengan datar di atas lantai dan luruskan punggung Anda.
- Tenangkan diri Anda selama lima sampai sepuluh menit sebelum memulai pengukuran.
- Sejajarkan bagian tengah manset dengan letak jantung Anda.
- Jangan bergerak dan tetap tenang selama pengukuran.
- Jangan langsung melakukan pengukuran setelah melakukan olahraga atau latihan fisik. Istirahatlah terlebih dahulu selama dua puluh atau tiga puluh menit sebelum memulai pengukuran.
- Cobalah untuk mengukur tekanan darah Anda pada waktu yang sama setiap hari.

Pengukuran

Selama pengukuran, adalah hal yang normal jika manset dipasang dengan sangat ketat. (Jangan khawatir).

Setelah Pengukuran

Setelah melakukan pengukuran, tekan tombol **START** untuk mematikan alat. Lepaskan manset dan simpan data Anda.

Catatan: Alat dilengkapi dengan fungsi daya mati otomatis yang mematikan alat dalam satu menit setelah melakukan pengukuran.

Berikan rentang waktu setidaknya tiga menit untuk setiap pengukuran pada orang yang sama.

Pengukuran

Sebelum melakukan pengukuran, lihat "Catatan untuk Pengukuran yang Akurat" di halaman 16.

Pengukuran Normal


1. Pasang manset pada lengan (disarankan agar dipasang pada lengan kiri). Duduklah dengan tenang selama pengukuran.
2. Tekan tombol **START**.
Semua segmen layar ditampilkan. Nol (0) ditampilkan dengan kedipan singkat. Layar akan berubah, seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan, sebagai tanda bahwa pengukuran akan dimulai. Manset mulai menginflasi. Adalah hal yang normal jika manset dipasang dengan sangat ketat. Indikator batang tekanan ditampilkan, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kiri, selama penginflasian.
Catatan: Jika suatu saat Anda ingin menghentikan inflasi, tekan tombol **START** lagi.
3. Ketika penginflasian telah selesai, deflasi mulai secara otomatis dan  (tanda hati) berkedip, yang menandakan bahwa pengukuran sedang berlangsung. Ketika nadi telah terdeteksi, maka tanda akan berkedip dengan setiap denyutan nadi.
Catatan: Jika tidak dapat memperoleh tekanan yang tepat, alat akan memulai penginflasian lagi secara otomatis. Untuk menghindari inflasi ulang, lihat "Pengukuran dengan Tekanan SET" di halaman berikutnya.
4. Ketika pengukuran telah selesai, pembacaan tekanan sistolik dan diastolik dan denyut nadi akan ditampilkan. Manset mengeluarkan sisa udara dan mengempis sepenuhnya.
5. Tekan tombol **START** untuk mematikan daya. Jika alat tidak dioperasikan setelah satu menit, alat akan mati secara otomatis.

Catatan: Berikan rentang waktu setidaknya tiga menit untuk setiap pengukuran pada orang yang sama.


Sejajar dengan letak jantung

Tekan **START**


Semua segmen layar ditampilkan




Tidak menampilkan informasi apapun
Memulai inflasi



Memberikan tekanan udara



Pengukuran sedang berlangsung



Tekanan Sistolik

Tekanan diastolik

Klasifikasi WHO

Denyut nadi



Mengeluarkan sisa udara secara otomatis

Pengukuran

UA-1020 dirancang untuk mendeteksi denyut nadi dan memompa manset ke tingkat tekanan sistolik secara otomatis.


Jika penginflasian ulang terjadi secara berturut-turut, gunakan cara berikut ini.

Pengukuran dengan Tekanan SET


Selama pengukuran tekanan darah, inflasi ulang dapat terjadi.

Nilai tekanan tetap dapat diatur untuk menghindari inflasi ulang.

1. Pada langkah 6 dari prosedur penyetelan jam (lihat halaman 11), tekan tombol **SET** untuk masuk ke mode pengaturan tekanan. Pengaturan saat ini berkedip.

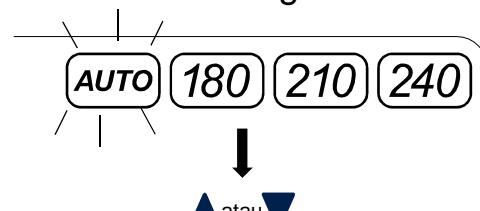

2. Tekan tombol **▲** atau **▼** untuk memilih nilai tekanan sekitar 30 mmHg atau lebih di atas tekanan sistolik yang diharapkan dari yang berikut ini.

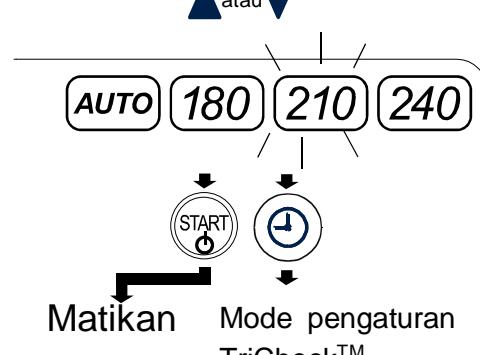

AUTO : Tekanan otomatis (nilai default)
180 : Nilai tekanan 180 mmHg (tetap)
210 : Nilai tekanan 210 mmHg (tetap)
240 : Nilai tekanan 240 mmHg (tetap)

3. Tekan tombol **SET** untuk masuk ke mode pengaturan TriCheck™. Tekan tombol **START** untuk mematikan daya. Setelah tiga menit alat tidak dioperasikan, alat akan mati secara otomatis. Pengukuran selanjutnya akan dilakukan dengan nilai tekanan yang baru.

Pengukuran dengan Tekanan Sistolik yang Diinginkan.

Gunakan metode ini ketika inflasi ulang terjadi berulang kali meskipun nilai tekanan diatur ke **240** di prosedur yang ada di atas atau ketika hasilnya tidak ditampilkan meskipun tekanan turun hingga 20 mmHg atau di bawahnya.

1. Pasang manset pada lengan (disarankan agar dipasang pada lengan kiri).
2. Tekan dan tahan tombol **START** sampai angka sekitar 30 sampai 40 mmHg lebih besar dari pada perkiraan tekanan sistolik yang diharapkan.
3. Ketika angka yang diinginkan telah didapatkan, lepaskan tombol **START** untuk memulai pengukuran. Kemudian lanjutkan untuk mengukur tekanan darah Anda seperti yang dijelaskan halaman sebelumnya.



Catatan untuk Pengukuran yang Akurat

- Duduk dengan posisi yang nyaman. Letakkan lengan Anda di atas meja dengan telapak tangan Anda menghadap ke atas dan manset berada pada posisi yang sejajar dengan jantung Anda.
- Tenangkan diri Anda selama lima sampai sepuluh menit sebelum memulai pengukuran. Jika Anda sedang merasa gembira atau depresi oleh tekanan emosional, pengukuran akan merefleksikan tekanan ini sebagai pembacaan darah yang lebih tinggi (atau lebih rendah) daripada pembacaan tekanan darah normal; dan pembacaan denyut nadi biasanya akan lebih cepat dari pada keadaan normal.
- Tekanan darah setiap orang bervariasi secara konstan, tergantung apa yang sedang Anda lakukan dan apa yang telah Anda makan. Apa yang Anda minum dapat memberikan efek yang sangat kuat dan cepat pada tekanan darah Anda.
- Alat ini mendasarkan pengukurannya pada denyut jantung. Jika Anda memiliki denyut jantung tidak beraturan atau sangat lemah, alat ini kemungkinan akan kesulitan untuk menentukan tekanan darah Anda.
- Jika alat mendeteksi kondisi yang abnormal, alat tersebut akan berhenti melakukan pengukuran dan menampilkan simbol kesalahan. Lihat halaman 6 untuk melihat penjelasan lengkap tentang simbol.
- Alat ini ditujukan untuk digunakan oleh orang dewasa. Konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menggunakan alat ini pada anak-anak. Anak-anak tidak boleh menggunakan alat ini tanpa pengawasan.
- Kinerja monitor tekanan darah otomatis dapat dipengaruhi oleh suhu, kelembapan atau ketinggian yang berlebihan.

Pengukuran TriCheck™


Mode TriCheck™ mengambil tiga pengukuran berturut-turut secara otomatis dan menampilkan nilai rata-rata dari tiga pengukuran.

Memilih Mode TriCheck™

1. Dalam mode pengaturan tekanan, tekan tombol **SET** untuk masuk ke mode pengaturan TriCheck™. Pengaturan saat ini berkedip.
2. Tekan tombol **▲** atau **▼** untuk membuat mode TriCheck™ dalam posisi ON atau OFF
ON: Mode TriCheck™
OFF: Mode pengukuran normal (nilai default)
3. Tekan tombol **START** atau **SET** untuk mematikan daya. Setelah tiga menit alat tidak dioperasikan, alat akan mati secara otomatis.

Di mode pengaturan tekanan,

Tekan




Pengaturan saat ini berkedip



atau




Mengubah pengaturan



Pengukuran Menggunakan Mode TriCheck™

1. Tekan tombol **START**.
Semua segmen layar ditampilkan. Nol (0) ditampilkan dengan kedipan singkat dan pengukuran pertama dimulai.
2. Ketika pengukuran telah selesai, pembacaan tekanan sistolik dan diastolik dan denyut nadi akan ditampilkan, kemudian hitungan mundur satu menit dimulai untuk pengukuran kedua.
3. Setelah satu menit, pengukuran kedua dimulai.
4. Ketika pengukuran selesai, pembacaan rata-rata pengukuran pertama dan kedua ditampilkan, kemudian hitungan mundur satu menit dimulai untuk pengukuran ketiga.
5. Setelah satu menit, pengukuran ketiga dimulai.
6. Ketika pengukuran selesai, pembacaan rata-rata dari tiga pengukuran ditampilkan dan disimpan dalam memori.

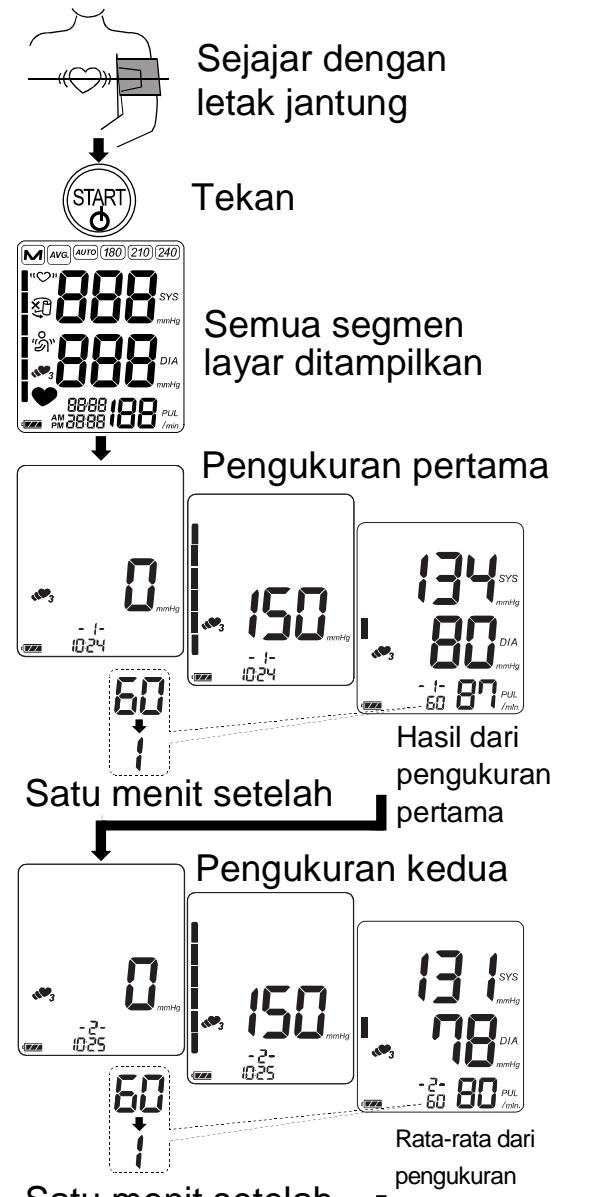

Catatan:

- Selama pengukuran, simbol TriCheck™ ditampilkan.
- Untuk membatalkan pengukuran, tekan tombol **START**. Dalam kasus ini, tidak ada data yang disimpan dalam memori.
- Ketika simbol kesalahan letak manset muncul selama pengukuran pertama, batalkan pengukuran, pasang kembali manset dengan benar dan mulai pengukuran baru.
- Setelah pengukuran, data rata-rata dari tiga pengukuran disimpan dalam memori. Tidak ada data yang akan disimpan, saat membatalkan pengukuran, sebelum menyelesaikan pengukuran ketiga.

Menampilkan Kembali Data Memori

Catatan: Perangkat ini menyimpan setidaknya 90 pengukuran di dalam memori.

1. Tekan tombol **▲** atau **▼**.
Rata-rata semua pengukuran dan jumlah data akan ditampilkan.
(Jika tidak ada data, maka "0" akan ditampilkan. Tekan tombol **▲**, **▼** atau **START** untuk mematikan alat.)
2. Setiap kali tombol **▼** (atau tombol **▲** menampilkan data dengan urutan terbalik) ditekan, data memori ditampilkan sebagai berikut.


Rata-rata semua pengukuran AM (pagi) yang dilakukan antara pukul 4:00 dan 9:59. (Yang ditampilkan contoh, 10 pengukuran.
Jika tidak ada data, maka "--" akan ditampilkan.)

↓
Rata-rata semua pengukuran PM (sore) yang dilakukan antara pukul 18:00 dan 1:59.
(Yang ditampilkan contoh, 9 pengukuran.
Jika tidak ada data, maka "--" akan ditampilkan.)

↓
Data terbaru (No.n, pada contoh, No.35)
Tiga detik setelah nomor data ditampilkan, data pengukuran ditampilkan.

⋮

↓
Data terakhir (No.1)
Tiga detik setelah nomor data ditampilkan, data pengukuran ditampilkan.
3. Setelah data terakhir ditampilkan, tekan tombol **▼** untuk mengembalikan tampilan rata-rata dari semua pengukuran.
4. Tekan tombol **START** untuk mematikan daya. Jika alat tidak dioperasikan setelah satu menit, alat akan mati secara otomatis.

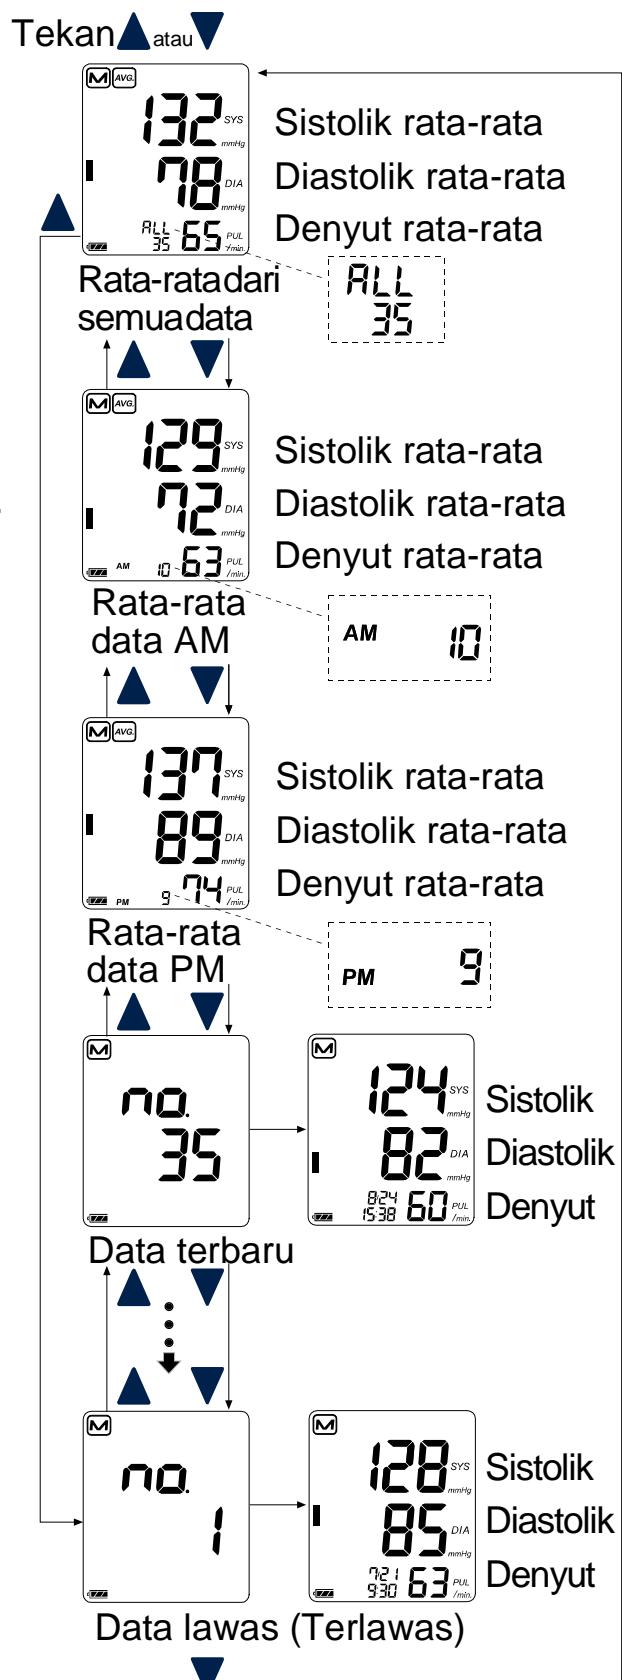

Apa itu Indikator IHB/AFib?

Ketika monitor mendeteksi irama jantung yang tidak beraturan selama pengukuran, indikator IHB/AFib akan muncul pada layar dengan nilai pengukuran.


Catatan: Kami menyarankan agar Anda menghubungi dokter Anda jika Anda sering melihat indikator IHB/AFib (⌚) ini.

Apa itu AFib?

Jantung berkontraksi karena sinyal listrik terjadi pada jantung dan mengirim darah ke seluruh tubuh. Fibrilasi atrium (AFib) terjadi ketika sinyal listrik pada serambi jantung bingung dan menyebabkan gangguan interval denyut. AFib dapat menyebabkan darah tersendat di dalam jantung, yang dengan mudah dapat mengakibatkan pembekuan darah, sebagai penyebab stroke dan serangan jantung.


Indikator Batang Tekanan

Indikator memantau kemajuan tekanan selama pengukuran.

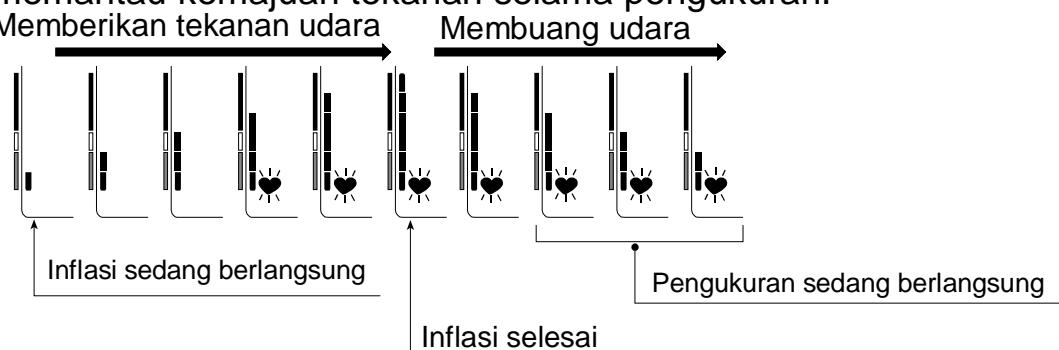

Indikator Klasifikasi WHO

Setiap segmen indikator batang sesuai dengan klasifikasi tekanan darah WHO yang dijelaskan di halaman berikutnya.

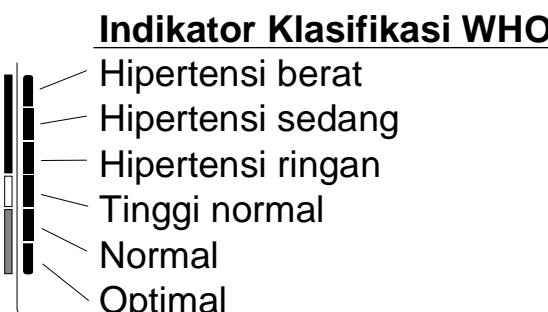

- : Indikator menampilkan segmen berdasarkan data terkini, sesuai dengan klasifikasi WHO.

Contoh:



Hipertensi sedang



Hipertensi ringan



Tinggi normal

Tentang Tekanan Darah

Apa itu Tekanan Darah?

Tekanan darah adalah tekanan yang diberikan darah ke dinding pembuluh nadi. Tekanan sistolik terjadi ketika jantung berkontraksi. Tekanan diastolik terjadi ketika jantung mengembang. Tekanan darah diukur dalam milimeter merkuri (mmHg). Tekanan darah alami seseorang direpresentasikan dengan tekanan dasar, yang diukur pertama kali di pagi hari ketika seseorang masih sedang berbaring dan belum makan.

Apa itu Hipertensi dan Bagaimana cara Mengatasinya?

Hipertensi adalah tekanan darah arteri abnormal tinggi yang jika tidak ditangani akan menyebabkan banyak masalah kesehatan termasuk stroke dan serangan jantung. Hipertensi dapat diatasi dengan mengubah gaya hidup, menghindari stres, dan dengan pengobatan yang diawasi dokter.

Untuk mencegah hipertensi atau untuk mempertahankan tekanan darah yang normal:


- Jangan merokok
- Berolahragalah dengan rutin
- Kurangi konsumsi garam dan lemak
- Lakukan pemeriksaan fisik secara rutin
- Pertahankan berat badan yang ideal

Kenapa perlu Mengukur Tekanan Darah di Rumah?

Tekanan darah yang diukur di klinik atau kantor dokter dapat menyebabkan kecemasan dan dapat menghasilkan pembacaan yang tinggi, 25 hingga 30 mmHg lebih tinggi daripada yang diukur di rumah. Pengukuran di rumah mengurangi efek pengaruh luar terhadap pembacaan tekanan darah, melengkapi pembacaan yang dilakukan dokter dan menghasilkan riwayat tekanan darah yang lebih akurat dan sempurna.


Klasifikasi Tekanan Darah WHO

Standar untuk menilai tekanan darah tinggi, tanpa memandang usia, telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seperti yang ditunjukkan pada grafik.

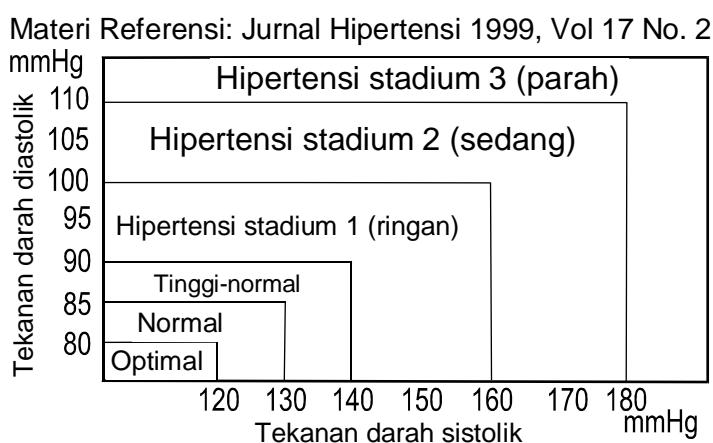

Variasi Tekanan Darah

Tekanan darah seseorang sangat bervariasi setiap hari dan musiman. Bisa bervariasi antara 30 hingga 50 mmHg dikarenakan kondisi yang beragam di setiap hari. Pada orang yang menderita hipertensi, variasi tersebut lebih jelas terlihat. Biasanya, tekanan darah naik saat bekerja atau bermain dan turun ke level terendah saat tidur. Jadi, jangan terlalu khawatir dengan hasil dari sekali pengukuran. Lakukan pengukuran pada waktu yang sama setiap hari dengan menggunakan prosedur yang dijelaskan dalam buku panduan ini untuk mengetahui tekanan darah normal Anda. Pembacaan teratur memberikan riwayat tekanan darah yang lebih komprehensif. Pastikan selalu untuk mencatat tanggal dan waktu pemeriksaan tekanan darah Anda. Konsultasikan dengan dokter Anda untuk menjelaskan data tekanan darah Anda.

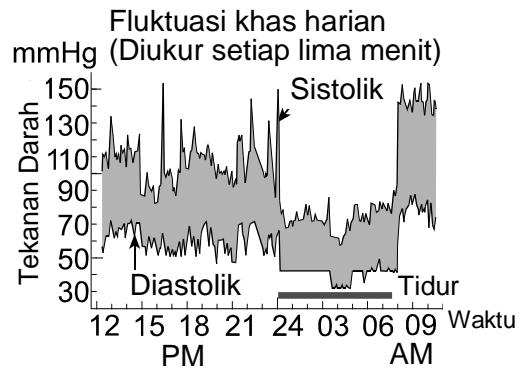

Penyelesaian masalah

Masalah	Kemungkinan Alasan	Tindakan yang dianjurkan
Layar tidak menampilkan informasi apapun, meskipun ketika daya dinyalakan.	Daya baterai habis.	Ganti semua baterai dengan yang baru.
	Terminal baterai tidak terpasang dengan benar.	Pasang kembali baterai dengan terminal positif dan negatif yang sesuai dengan petunjuk yang ada pada kompartemen baterai.
Manset tidak mengembang.	Tegangan baterai terlalu rendah.  (tanda BATERAI LEMAH) berkedip. Jika daya baterai telah habis total, tanda tidak akan muncul.	Ganti semua baterai dengan yang baru.
Alat tidak akan dapat melakukan pengukuran. Pembacaan terlalu tinggi atau terlalu rendah.	Manset tidak terpasang dengan benar.	Pasang manset dengan benar.
	Anda menggerakkan lengan atau tubuh Anda selama pengukuran.	Pastikan Anda tidak bergerak dan tetap tenang selama pengukuran.
	Posisi manset tidak benar.	Duduklah dengan tenang dan jangan bergerak. Letakkan lengan Anda di atas meja dengan telapak tangan Anda menghadap ke atas dan manset berada pada posisi yang sejajar dengan jantung Anda.

Masalah	Kemungkinan Alasan	Tindakan yang dianjurkan
	_____	Jika Anda memiliki detak jantung yang sangat lemah atau tidak beraturan, alat ini kemungkinan akan kesulitan untuk menentukan tekanan darah Anda.
Lainnya	Nilai pengukuran berbeda dari hasil pengukuran di klinik atau di tempat praktik dokter.	Lihat "Kenapa perlu Mengukur Tekanan Darah di Rumah?".
	_____	Keluarkan baterai. Masukkan kembali baterai dan lakukan lagi pengukuran.

Catatan: Jika tindakan seperti yang dijelaskan di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi penjual. Jangan berusaha untuk membuka atau memperbaiki produk ini, karena setiap tindakan yang serupa akan membuat garansi Anda tidak valid lagi.

Pemeliharaan

Jangan memodifikasi alat. Alat menggunakan komponen listrik dan unit udara yang rumit yang dapat rusak. Jika Anda tidak dapat memperbaiki masalah menggunakan instruksi penyelesaian masalah, hubungi penjual resmi di tempat Anda atau ke bagian layanan pelanggan kami. Layanan pelanggan A&D akan memberikan Anda informasi teknis, suku cadang dan unit kepada penjual resmi.

Alat ini dirancang dan diproduksi untuk dapat digunakan dalam jangka panjang. Namun secara umum disarankan agar alat diperiksa setiap 2 tahun, untuk memastikan fungsi dan keakuratan yang tepat. Hubungi penjual resmi di wilayah Anda atau kantor A&D untuk mendapatkan pemeliharaan alat.

Data Teknis

Tipe	UA-1020
Cara pengukuran	Pengukuran oscillometric
Rentang pengukuran	Tekanan: 0 - 299 mmHg Tekanan sistolik: 60 - 279 mmHg Tekanan diastolik: 40 - 200 mmHg Denyut: 40 - 180 denyut/menit
Keakuratan pengukuran	Tekanan: ±3 mmHg Denyut: ±5 %
Rentang nilai arus	DC 6 V 3 W
Pasokan daya	4 x baterai 1,5 V (R6P, LR6 atau AA) atau Adaptor AC (TB-233C INPUT: AC 100 – 240 V 50 / 60 Hz 0,15A) (Tidak termasuk)
Jumlah pengukuran	Sekitar 1000 pengukuran, ketika baterai alkalin AA digunakan, dengan nilai tekanan 180 mmHg dengan suhu kamar 23 °C.
Klasifikasi	Peralatan bertenaga internal ME (Disuplai oleh baterai) Kelas II (Dipasok oleh adaptor) Mode Pengoperasian Berkelanjutan
Uji klinis	Menurut ISO81060-2 : 2013 Dalam studi validasi klinis, K5 digunakan pada 85 subjek untuk memperoleh determinasi tekanan darah diastolik.
EMD	IEC 60601-1-2: 2014
Memori	90 pengukuran terkini
Kondisi pengoperasian	+10 sampai +40 °C/15 sampai 85 %RH / 800 sampai 1060 hPa
Kondisi Pengangkutan/Penyimpanan	-20 sampai +60 °C/10 sampai 95 %RH / 700 sampai 1060 hPa
Dimensi	Sekitar 140 [L] x 60 [T] x 105 [D] mm
Berat	Sekitar 285 g, tidak termasuk baterai
Perlindungan internasional	Alat: IP20
Komponen yang digunakan	Manset Tipe BF 

Masa pakai Alat:5 tahun (ketika digunakan enam kali sehari)
 Manset: 2 tahun
 (ketika digunakan enam kali sehari)
 Adaptor AC: 5 tahun
 (jika digunakan enam kali sehari)

Aksesori adaptor AC Adaptor berfungsi untuk menghubungkan monitor tekanan darah ke sumber daya listrik di rumah.
 TB-233C Hubungi penjual A&D lokal di wilayah Anda untuk membeli alat.
 Adaptor AC harus diperiksa atau diganti secara berkala.

Simbol yang tertera pada adaptor AC.

Simbol	Fungsi/Arti
	Hanya untuk penggunaan dalam ruangan saja
	Alat Kelas II
	Sekring termal
	Sekring
	Label alat direktif EC
	Label alat sertifikasi EAC
	Polaritas steker adaptor AC

Aksesoris dijual terpisah
 Manset

Nomor Katalog	Ukuran Manset	Ukuran Lengan
CUF-D-LA-ISO	Manset Dewasa Ukuran Besar	31 cm sampai 45 cm
CUF-I-ISO	Manset ukuran lebar	22 cm sampai 42 cm
CUF-D-MA-ISO	Manset Ukuran Semi Besar	23 cm sampai 37 cm
CUF-F-A-ISO	Manset dewasa	22 cm sampai 32 cm
CUF-D-SA -ISO	Manset kecil	16 cm sampai 24 cm
CUF-G-A-ISO	Manset dewasa SmoothFit	17 cm sampai 32 cm

Adaptor AC

Nomor Katalog	Steker (Tipe outlet)
TB-233C	Tipe C

Catatan: Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Klasifikasi IP adalah tingkat perlindungan yang diberikan oleh selungkup sesuai dengan IEC 60529. Alat ini terlindungi dari benda asing padat yang berdiameter 12 mm dan yang lebih besar seperti jari. Alat ini tidak tahan air.

Kandungan

Pelanggan yang Dihormati	2
Catatan Awal	2
Langkah berjaga-jaga.....	2
Kontraindikasi	3
Identifikasi Bahagian.....	5
Simbol	6
Mod Operasi	8
Penggunaan Monitor.....	9
Memasang/Menukar Bateri	9
Menyambungkan Hos Udara.....	10
Menyambungkan Penyesuai AC.....	10
Mesaraskan Jam Terbina dalam	11
Memilih Saiz Kaf yang Betul.....	12
Menggunakan Kaf Lengan	12
Cara Mengambil Ukuran dengan Tepat.....	13
Pengukuran	13
Selepas Pengukuran	13
Pengukuran	14
Pengukuran Normal.....	14
Pengukuran dengan Tekanan yang DITETAPKAN	15
Pengukuran dengan Tekanan Sistolik yang Dikehendaki ...	16
Nota untuk Pengukuran Tepat	16
Pengukuran TriCheck™.....	17
Mengimbas Kembali Data Memori.....	19
Apakah itu Penunjuk IHB/AFib?.....	20
Apakah AFib?	20
Penunjuk Bar Tekanan	20
Penunjuk Klasifikasi WHO	20
Tentang Tekanan Darah.....	21
Apa itu Tekanan Darah?.....	21
Apakah Tekanan Darah Tinggi dan Bagaimana untuk Mengawalnya?	21
Mengapa Ukur Tekanan Darah di Rumah?	21
Klasifikasi Tekanan Darah WHO	21
Variansi Tekanan Darah.....	21
Penyelesaian masalah	22
Penyelenggaraan	23
Data Teknikal	23

Pelanggan yang Dihormati

Tahniah kerana membeli monitor tekanan darah A&D. Peranti yang direka dengan penggunaan mudah dan ketepatan ini akan memudahkan regimen tekanan darah harian anda.

Kami mencadangkan supaya anda membaca manual ini dengan teliti sebelum menggunakan peranti ini untuk kali pertama.

Catatan Awal

- Peranti ini direka untuk digunakan pada orang dewasa, bukan bayi baru lahir atau budak.
- Persekutaran untuk penggunaan alat. Peranti ini digunakan untuk beroperasi dengan diri sendiri dalam persekitaran penjagaan kesihatan rumah.
- Peranti ini direka untuk mengukur tekanan darah dan kadar denyutan nadi individu untuk diagnosis.

Langkah berjaga-jaga

- Komponen ketepatan digunakan dalam pembinaan peranti ini. Ekstrem dalam suhu, kelembapan, cahaya matahari langsung, kejutan atau habuk harus dielakkan.
- Bersihkan peranti dan kaf dengan kain kering, lembut atau kain yang dilembapkan dengan air dan detergen neutral. Jangan gunakan alkohol, benzena, pencair atau lain-lain bahan kimia yang kasar untuk membersihkan peranti atau kaf.
- Elakkan lipatan ketat pada kaf atau menyimpan hos dipintal ketat untuk jangka masa panjang, kerana perlakuan sedemikian boleh memendekkan hayat komponen.
- Berhati-hati untuk mengelakkan bayi atau budak tercekik dengan hos dan kabel secara tidak sengaja.
- Jangan putarkan hos udara semasa pengukuran. Ini boleh menyebabkan kecederaan akibat tekanan kaf berterusan.
- Peranti dan kaf bukan kalis air. Cegah hujan, peluh dan air daripada merosakkan peranti dan kaf.
- Pengukuran mungkin terganggu jika peranti itu digunakan berhampiran televisyen, ketuhar gelombang mikro, telefon selular, sinar X atau peranti lain dengan medan elektrik yang kuat.
- Peranti komunikasi tanpa wayar, seperti peranti perangkaian rumah, telefon bimbit, telefon tanpa kord dan stesen pangkalan mereka, walkie-talkie boleh mempengaruhi monitor tekanan darah ini.
Oleh itu, jarak minimum sebanyak 30 cm hendaklah dijaga daripada peranti sedemikian.

- Peralatan, bahagian dan bateri yang digunakan tidak dianggap sebagai sisa buangan biasa dan mesti dilupuskan mengikut peraturan tempatan yang berkenaan.
- Apabila penyesuai AC digunakan, pastikan penyesuai AC boleh dikeluarkan dengan mudah dari salur keluar elektrik apabila perlu.
- Apabila anda menggunakan semula peranti, pastikan peranti itu bersih.
- Jangan ubah suai peranti. Ia boleh menyebabkan kemalangan atau kerosakan pada peranti.
- Untuk mengukur tekanan darah, lengan perlu ditekan oleh kaf dengan kekuatan yang secukupnya bagi menghentikan aliran darah untuk sementara melalui arteri. Ini boleh menyebabkan kesakitan, kebas atau tanda merah pada lengan untuk sementara. Keadaan ini akan muncul terutamanya apabila pengukuran diulang berturut-turut. Sebarang kesakitan, kebas, atau tanda merah akan hilang setelah beberapa ketika.
- Mengukur tekanan darah terlalu kerap boleh menyebabkan kemudaratan akibat gangguan aliran darah. Pastikan yang operasi peranti tidak menyebabkan kerosakan peredaran darah yang berpanjangan apabila menggunakan peranti berulang kali.
- Ujian klinikal belum dijalankan pada bayi yang baru lahir dan wanita hamil. Jangan gunakan pada bayi baru lahir atau wanita hamil.
- Jika anda telah menjalani mastektomi, sila berunding dengan doktor sebelum menggunakan peranti ini.
- Jangan biarkan kanak-kanak menggunakan peranti ini dengan sendiri dan jangan gunakan peranti ini di tempat yang boleh dicapai bayi. Ia boleh menyebabkan kemalangan atau kerosakan .
- Terdapat bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ditelan dengan tidak sengaja oleh bayi.
- Jangan sentuh bateri, bicus DC, dan pesakit pada masa yang sama. Ini boleh mengakibatkan kejutan elektrik.
- Cabut palam penyesuai AC apabila tidak digunakan semasa pengukuran.
- Penggunaan aksesori yang tidak dinyatakan dalam manual ini boleh menjelaskan keselamatan.
- Sekiranya berlaku litar pintas bateri, ia mungkin menjadi panas dan berpotensi menyebabkan luka terbakar.
- Benarkan peranti ini disesuaikan dengan persekitaran sekeliling sebelum digunakan (kira-kira satu jam).
- Jangan mengembung tanpa membalut kaf di sekitar lengan atas.


Kontraindikasi

Berikut ialah langkah berjaga-jaga untuk penggunaan peranti yang betul.



- Jangan gunakan kaf pada lengan dengan peralatan perubatan elektrik lain yang dipasang. Peralatan ini mungkin tidak dapat berfungsi dengan baik.
- Individu yang mempunyai kekurangan peredaran darah yang teruk di lengan mesti berunding dengan doktor sebelum menggunakan peranti tersebut, untuk mengelakkan masalah perubatan.

- Jangan diagnosis sendiri hasil pengukuran dan mulakan rawatan dengan diri sendiri. Sentiasa berunding dengan doktor anda untuk menilai keputusan dan rawatan.
- Jangan gunakan kaf pada lengan dengan luka yang tidak disembuhkan.
- Jangan gunakan kaf pada lengan yang menerima titisan intravena atau pemindahan darah. Ia boleh menyebabkan kecederaan atau kemalangan.
- Jangan gunakan peranti apabila terdapat gas mudah terbakar seperti gas anestetik. Ia boleh menyebabkan letupan.
- Jangan gunakan peranti ini dalam persekitaran oksigen yang sangat pekat, seperti bilik oksigen dengan tekanan tinggi atau khemah oksigen. Ia boleh menyebabkan kebakaran atau letupan.


Identifikasi Bahagian

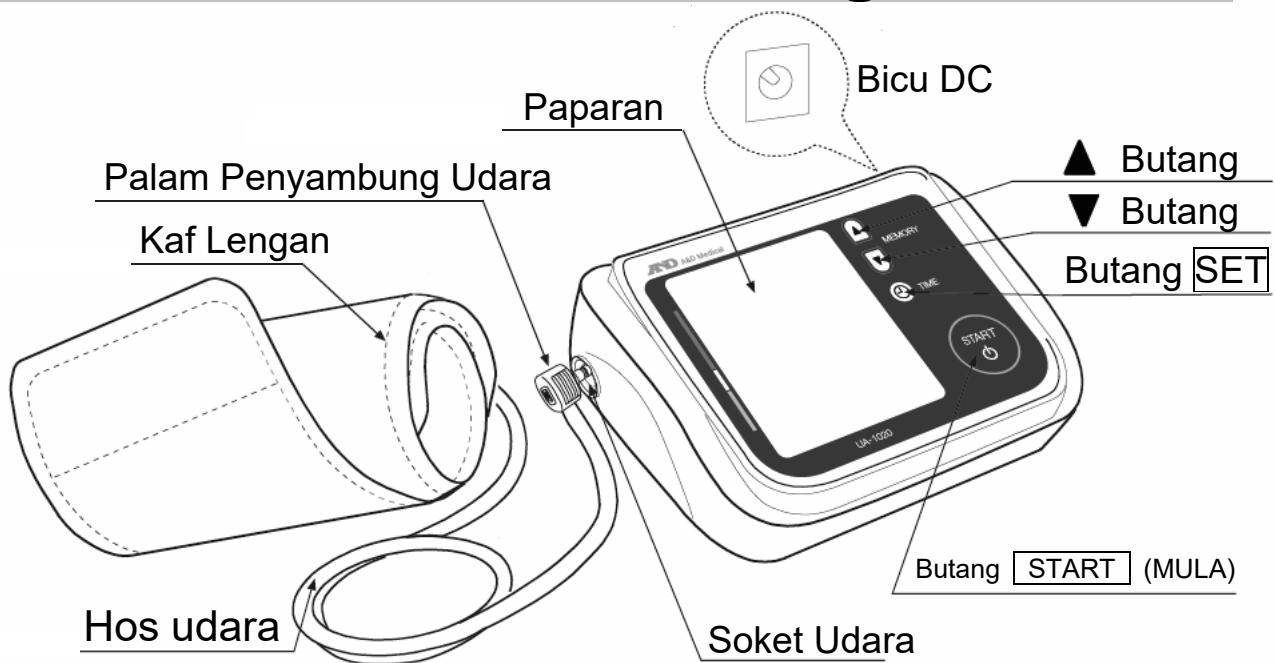

Bahagian Bateri

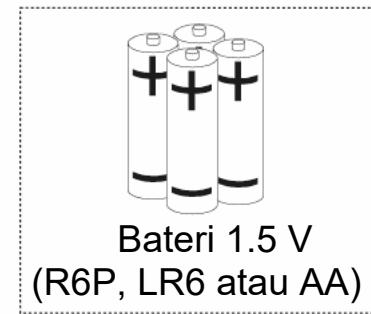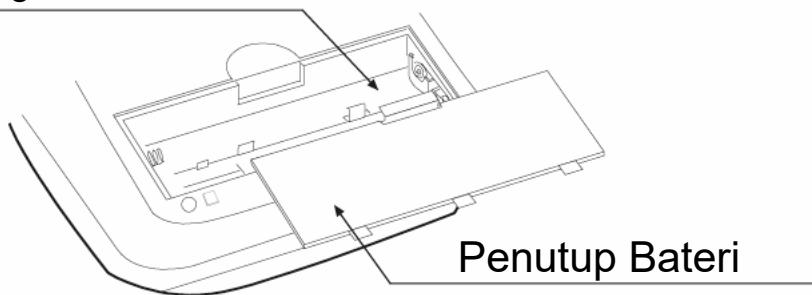

Paparan

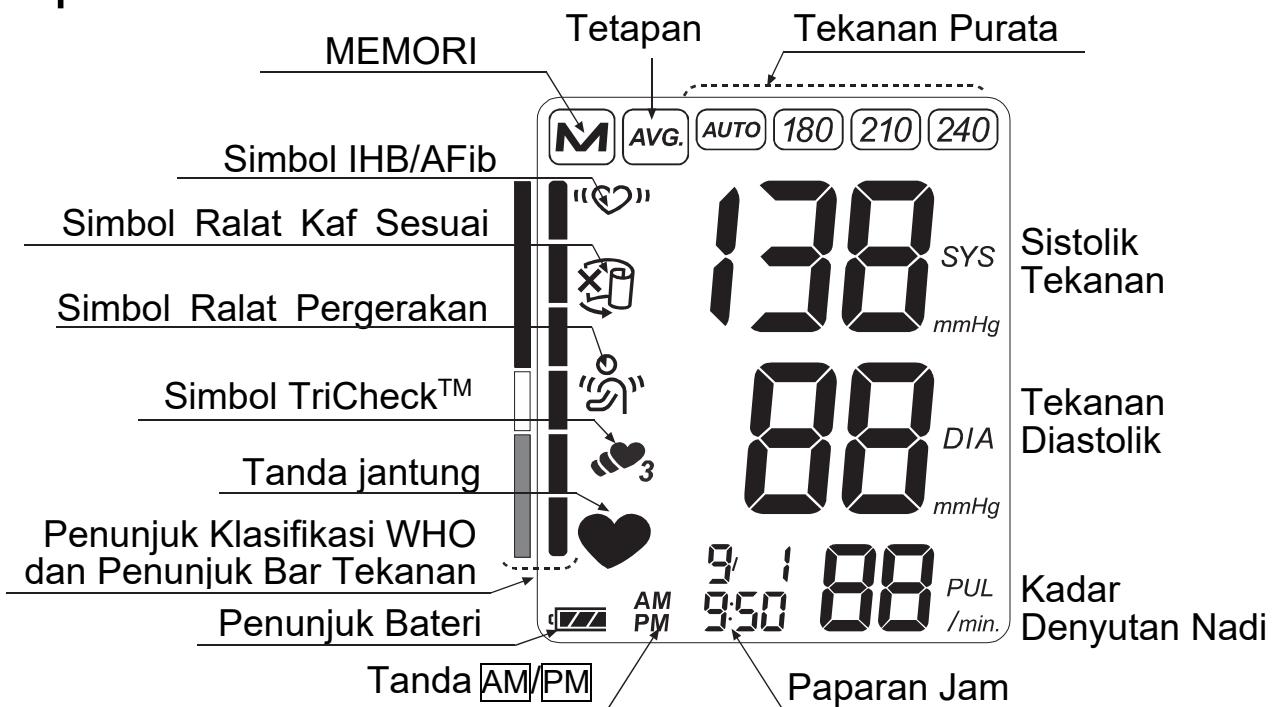

Simbol

Simbol yang dicetak pada bekas peranti

Simbol	Fungsi / Makna
	Bersedia dan Hidupkan peranti.
	Panduan pemasangan bateri
	Arus terus
SN	Nombor siri
	Pengeluar
2020	Tarikh pengeluar
	Jenis BF: Kaf direka untuk memberikan perlindungan khas terhadap kejutan elektrik.
	Peralatan, bahagian dan bateri yang digunakan tidak dianggap sebagai sisa rumah biasa, dan mesti dilupuskan mengikut peraturan tempatan yang berkenaan.
	Rujuk manual arahan / buku kecil
	Kekutuhan blicu DC
IP	Simbol perlindungan antarabangsa
	Sentiasa kering

Simbol-simbol yang muncul pada paparan

Simbol	Fungsi / Makna	Tindakan Disyorkan
	Muncul semasa pengukuran sedang berjalan. Ia berkelip apabila denyutan nadi dikesan.	Pengukuran sedang berjalan. Kurangkan pergerakan badan sebaik mungkin.
	Simbol IHB/AFib Muncul apabila denyutan jantung tidak teratur dikesan. Ia boleh menyala apabila getaran yang sangat sedikit seperti menggilir atau gementar dikesan.	_____
	ModTriCheck™ Mengambil tiga ukuran berturut-turut secara automatik dan memaparkan nilai purata bagi tiga ukuran tersebut.	_____
	Muncul apabila pergerakan badan atau lengan dikesan.	Bacaan mungkin menghasilkan nilai yang salah. Cuba ukur sekali lagi. Jangan bergerak semasa pengukuran.

Simbol	Fungsi / Makna	Tindakan Disyorkan
	Muncul semasa pengukuran apabila kaf dipasang dengan longgar.	Bacaan mungkin menghasilkan nilai yang salah. Balutkan kaf dengan betul, dan cuba ukur sekali lagi.
	Ukuran sebelumnya disimpan dalam MEMORI.	_____
	Data purata	_____
	BATERI PENUH Penunjuk kuasa bateri semasa pengukuran.	_____
	BATERI RENDAH Kuasa bateri rendah apabila ia berkelip.	Ganti semua bateri dengan yang baharu apabila tanda tersebut berkelip.
	Tekanan darah tidak stabil kerana pergerakan semasa pengukuran.	Cuba ukur sekali lagi. Jangan bergerak semasa pengukuran.
	Nilai sistolik dan diastolik adalah dalam 10 mmHg satu sama lain.	Balutkan kaf dengan betul, dan cuba ukur sekali lagi.
	Nilai tekanan tidak meningkat semasa pengembungan.	
	Kaf tidak digunakan dengan betul.	Balutkan kaf dengan betul, dan cuba ukur sekali lagi.
	PUL RALAT PAPARAN Denyutan nadi tidak dikesan dengan betul.	
	Ralat dalaman monitor tekanan darah	Keluarkan bateri dan tekan butang START (MULA) kemudian pasangkan semula bateri. Jika ralat masih muncul, hubungi wakil pengedar.
SYS	Tekanan darah sistolik dalam mmHg	_____
DIA	Tekanan darah diastolik dalam mmHg	_____
PUL	Denyutan nadi per minit	_____
AM	Muncul apabila data purata dipaparkan. Data diambil antara pukul 4:00 dan 9:59	_____
PM	Muncul apabila data purata dipaparkan. Data diambil antara pukul 18:00 dan 1:59	_____
	Tetapan tekanan Menunjukkan nilai tekanan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pengguna.	_____

Mod Operasi

1. Pengukuran Normal

Tekan butang **START** (MULA). Tekanan darah diukur dan data disimpan dalam memori. Peranti ini menyimpan 90 ukuran terkini dalam memori.

2. Mengimbas Kembali Data

Tekan butang **▲** atau **▼** untuk mengimbas semula data dalam memori. Purata semua ukuran dipaparkan, seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah kanan.

Kemudian, setiap kali butang **▼** ditekan, data memori dipaparkan seperti berikut.


Purata semua ukuran AM (pagi) yang diambil antara 4:00 dan 9:59.

↓
Purata semua ukuran PM (petang) yang diambil antara 18:00 dan 1:59.

↓
Data terkini (No.n, dalam contoh, No.35)


↓
Data terakhir (No.1)

Untuk butiran tentang memanggil semula data, rujuk "Mengimbas Kembali Data Memori".

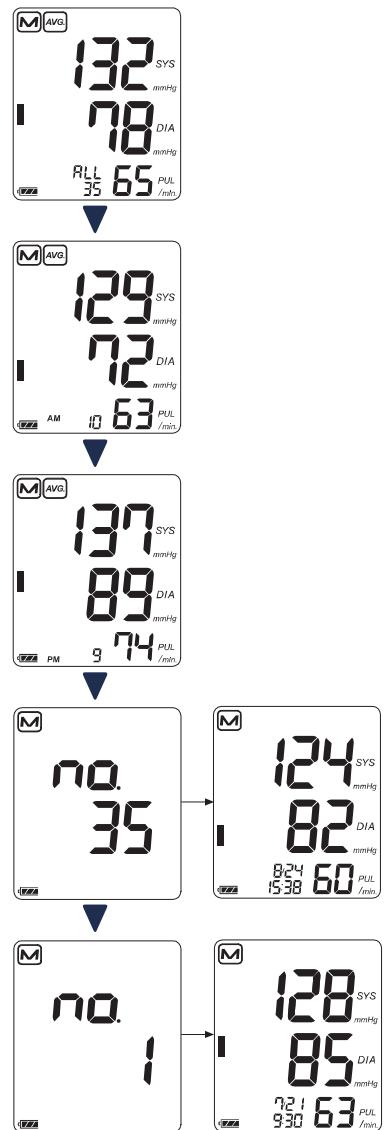

3. Memadam semua Data yang Disimpan dalam Memori

Tekan kedua-dua butang **▲** dan **▼**. Tanda **M** dan penunjuk bateri muncul. Tekan dan tahan kedua-dua butang **▲** dan **▼** sehingga tanda **M** yang menyala mula berkelip untuk memadam semua data yang disimpan dalam memori.




4. Pengukuran dengan Tekanan Sistolik yang Dikehendaki

Rujuk halaman 16 untuk Pengukuran dengan tekanan sistolik yang dikehendaki.

Penggunaan Monitor

Memasang/Menukar Bateri

1. Tanggalkan penutup bateri.
2. Keluarkan bateri yang telah digunakan dan masukkan bateri baharu ke dalam bahagian bateri seperti yang ditunjukkan, pastikan kutub (+ dan -) betul. Gunakan bateri R6P, LR6 atau AA sahaja.
3. Pasang semula penutup bateri.

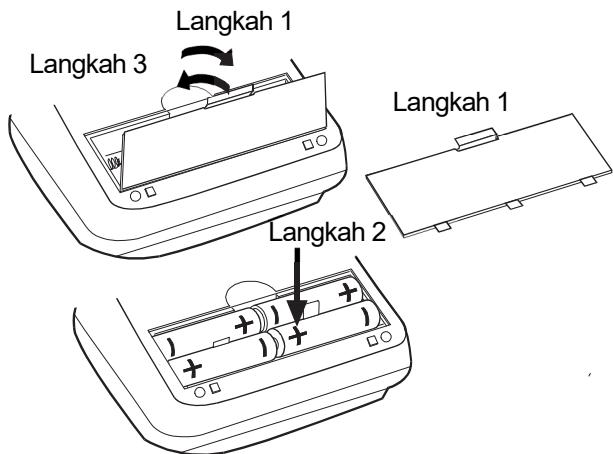


PERHATIAN

- Masukkan bateri dalam bahagian bateri seperti yang ditunjukkan. Sekiranya tidak dipasang dengan betul, peranti tidak akan berfungsi.
- Apabila (tanda BATERI RENDAH) berkelip pada paparan, ganti semua bateri dengan yang baharu. Jangan campurkan bateri lama dan baharu. Ia mungkin memendekkan hayat bateri, atau menyebabkan peranti rosak.
Gantikan bateri dua saat atau lebih selepas peranti dimatikan.
Jika (tanda BATERI RENDAH) muncul walaupun selepas bateri diganti, buat pengukuran tekanan darah. Peranti kemudiannya boleh mengecam bateri baharu.
- (Tanda BATERI RENDAH) tidak muncul apabila bateri lemah.
- Jangka hayat bateri berbeza mengikut suhu bilik dan hayatnya mungkin lebih pendek pada suhu rendah. Secara am, empat bateri LR6 baharu akan bertahan selama satu tahun bulan apabila digunakan dua kali untuk pengukuran setiap hari.
- Gunakan bateri yang dinyatakan sahaja. Bateri yang disediakan dengan peranti ini adalah untuk menguji prestasi peranti dan mungkin mempunyai hayat terhad.
- Keluarkan bateri jika peranti tidak digunakan untuk masa yang lama. Bateri mungkin bocor dan menyebabkan kerosakan.

Penggunaan Monitor

Menyambungkan Hos Udara


Masukkan palam penyambung udara ke dalam soket udara dengan kukuh.

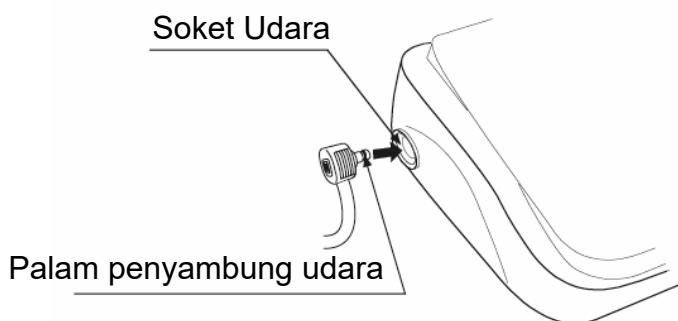

Menyambungkan Penyesuai AC

Masukkan palam penyesuai AC ke dalam bicus DC.

Seterusnya, sambungkan penyesuai AC ke salur keluar elektrik.

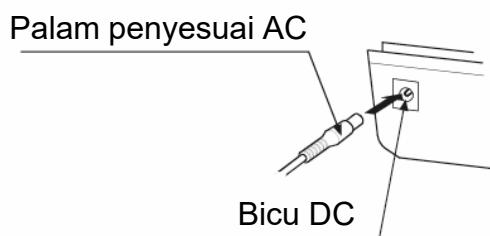

- Gunakan penyesuai AC yang dinyatakan sahaja.
(Rujuk halaman 22).
- Apabila mencabut penyesuai AC daripada salur keluar elektrik, genggam dan tarik badan penyesuai AC keluar daripada salur keluar.
- Apabila memutuskan palam penyesuai AC daripada monitor tekanan darah, genggam dan tarik palam penyesuai AC keluar daripada monitor.

Penggunaan Monitor

Melaraskan Jam Terbina dalam

Laraskan jam sebelum digunakan.

1. Tekan butang **SET** sehingga tahun mula berkelip.
2. Pilih tahun menggunakan butang **▲** atau **▼**. Tekan butang **SET** untuk menetapkan tahun semasa dan beralih ke pilihan bulan/hari. Tarikh boleh ditetapkan di mana-mana antara tahun 2010 dan 2059.
3. Pilih bulan menggunakan butang **▲** atau **▼**. Tekan butang **SET** untuk menetapkan bulan semasa dan beralih ke pilihan hari.
4. Pilih hari menggunakan butang **▲** atau **▼**. Tekan butang **SET** untuk menetapkan hari semasa dan beralih ke jam/minit.
5. Pilih jam menggunakan butang **▲** atau **▼**. Tekan butang **SET** untuk menetapkan jam semasa dan beralih ke minit.
6. Pilih minit menggunakan butang **▲** atau **▼**. (Tekan butang **SET** untuk pergi ke mod tetapan tekanan. Untuk butiran, rujuk halaman 15). Tekan butang **START** (MULA) untuk mematikan peranti.


Nota: Setelah tiga minit peranti tidak beroperasi, peranti akan ditutup secara automatik.

Apabila jam belum ditetapkan, paparan jam menunjukkan **- - / - -** sempang seperti ditunjukkan **- : - -** di sebelah kanan.

Apabila menggunakan peranti buat kali pertama, jam tidak dilaraskan.

Apabila peranti diputuskan sambungan daripada bekalan kuasa selama lebih daripada 30 saat, tarikh, masa dan nilai tekanan yang ditetapkan akan dipadamkan. Apabila tarikh, masa dan nilai tekanan yang ditetapkan dipadamkan, sila laraskan semula.

- Menekan dan menahan butang **▲** atau **▼** akan menukar nilai secara berterusan.

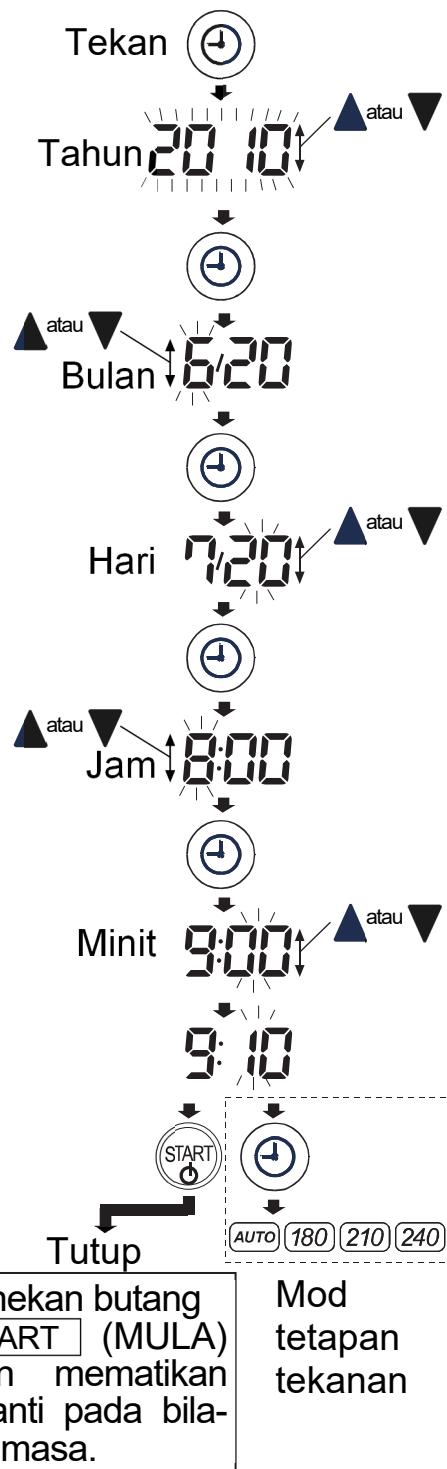

Menekan butang **START** (MULA) akan mematikan peranti pada bila-bila masa.

Mod tetapan tekanan

Penggunaan Monitor

Memilih Saiz Kaf yang Betul

Penggunaan saiz kaf yang betul adalah penting untuk bacaan yang tepat. Sekiranya kaf bukan ukuran yang betul, bacaan mungkin menghasilkan nilai tekanan darah yang salah.

- Saiz lengan dicetak pada setiap kaf.
- Kaf lengan adalah pakai habis. Jika ia telah lusuh, beli yang baharu.

Saiz Lengan	Saiz Kaf yang Disyorkan	Nombor Katalog
31 cm hingga 45 cm	Kaf Dewasa besar	CUF-D-LA-ISO
22 cm hingga 42 cm	Kaf julat lebar	CUF-I-ISO
23 cm hingga 37 cm	Kaf semi besar	CUF-D-MA-ISO
22 cm hingga 32 cm	Kaf dewasa	CUF-F-A-ISO
16 cm hingga 24 cm	Kaf kecil	CUF-D-SA-ISO
17 cm hingga 32 cm	Kaf dewasa SmoothFit	CUF-G-A-ISO

Saiz lengan: Lilitan pada biseps.

Menggunakan Kaf Lengan

1. Balut kaf di sekitar lengan atas, kira-kira 1-2 cm di atas bahagian dalam siku, seperti yang ditunjukkan.
Letakkan kaf secara langsung di atas kulit, kerana pakaian boleh menyebabkan denyutan nadi yang tidak jelas dan menyebabkan ralat pengukuran.
2. Penjerutan lengan atas yang disebabkan oleh lengan baju yang digulung ke atas dengan ketat, boleh mencegah bacaan yang tepat.



Simbol-simbol yang dicetak pada kaf

Simbol	Fungsi/Maksud	Tindakan Disyorkan
●	Tanda Kedudukan Arteri	Tetapkan tanda ● pada arteri lengan atas atau sejajar dengan jari manis pada bahagian dalam lengan.
[REF]	Nombor Katalog	_____
[LOT]	Nombor Lot	_____
[Mfg]	Pengeluar	_____
[MD]	Peranti Perubatan	_____

Penggunaan Monitor

Cara Mengambil Ukuran dengan Tepat

Bagi ukuran tekanan darah paling tepat:

- Duduk dengan selesa di atas kerusi. Rehatkan lengan anda di atas meja. Jangan silang kaki anda. Letak kaki anda di atas lantai dan luruskan belakang anda.
- Rehat selama kira-kira lima hingga sepuluh minit sebelum pengukuran.
- Letakkan pusat kaf pada kedudukan yang sama dengan jantung anda.
- Jangan bergerak dan duduk diam semasa pengukuran.
- Jangan mengukur dengan segera selepas senaman fizikal atau selepas mandi. Rehat selama dua puluh atau tiga puluh minit sebelum mengambil pengukuran.
- Cuba ukur tekanan darah anda pada masa yang sama setiap hari.

Pengukuran

Semasa pengukuran, normal untuk anda berasa kaf sangat ketat.
(Jangan cemas).

Selepas Pengukuran

Selepas pengukuran, tekan butang **START** (MULA) untuk mematikan peranti.

Tanggalkan kaf dan rekod data anda.

Nota: Peranti ini mempunyai fungsi penutupan kuasa automatik yang mematikan peranti secara automatik kira-kira seminit selepas pengukuran.


Berikan sekurang-kurangnya tiga minit antara pengukuran pada individu yang sama.

Pengukuran

Sebelum pengukuran, rujuk "Nota untuk Pengukuran Tepat" pada halaman 16.

Pengukuran Normal

1. Letakkan kaf pada lengan (sebaiknya lengan kiri). Duduk dengan tenang semasa pengukuran.
2. Tekan butang **START** (MULA). Semua segmen paparan dipaparkan. Sifar (0) yang dipaparkan berkelip sebentar. Paparan berubah, seperti yang ditunjukkan dalam gambar di sebelah kanan apabila pengukuran bermula. Kaf tersebut mula mengembang. Ia adalah normal untuk kaf berasa sangat ketat. Penunjuk bar tekanan dipaparkan di tepi kiri paparan, semasa pengembangan.
Nota: Jika anda ingin menghentikan pengembangan pada bila-bila masa, tekan butang **START** (MULA) sekali lagi.
3. Apabila pengembangan selesai, deflasi bermula secara automatik dan  (tanda jantung) berkelip yang menunjukkan bahawa pengukuran sedang berjalan. Setelah denyutan nadi dikesan, tanda itu berkelip dengan setiap denyutan nadi.
Nota: Jika tekanan yang sesuai tidak diperoleh, peranti akan mula mengembang lagi secara automatik. Untuk mengelakkan pengembangan semula, rujuk "Pengukuran dengan Tekanan yang DITETAPKAN" pada halaman seterusnya.
4. Apabila pengukuran selesai, bacaan tekanan sistolik dan diastolik dan kadar denyutan nadi dipaparkan. Kaf melepaskan baki udara dan mengempis sepenuhnya.

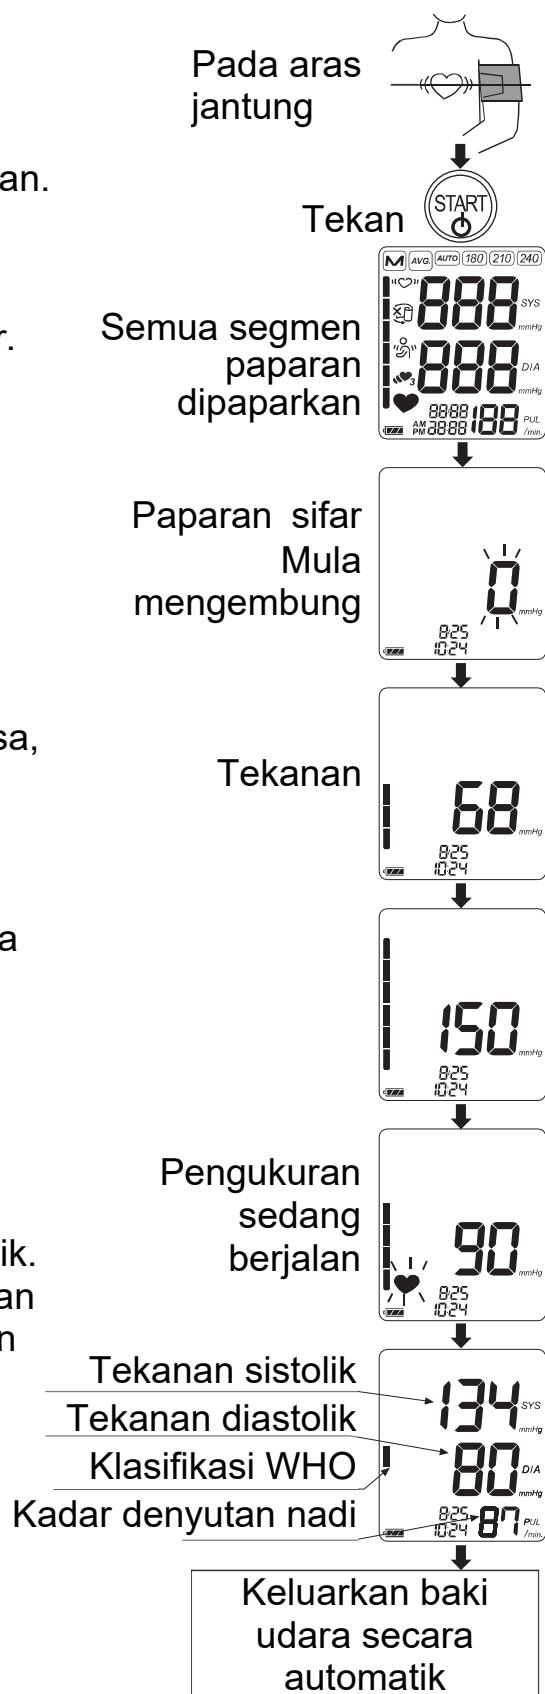

- Tekan butang **START** (MULA) untuk mematikan peranti.
Setelah seminit peranti tidak beroperasi, peranti akan ditutup secara automatik.

Nota: Berikan sekurang-kurangnya tiga minit antara pengukuran pada individu yang sama.

Pengukuran


UA-1020 direka bentuk untuk mengesan denyutan nadi dan mengembangkan kaf ke paras tekanan sistolik secara automatik. Sekiranya pengembungan semula berlaku berulang kali, gunakan kaedah berikut.

Pengukuran dengan Tekanan yang DITETAPKAN

Semasa pengukuran tekanan darah, pengembungan semula mungkin berlaku.

Nilai tekanan tetap boleh ditetapkan untuk mengelakkan pengembungan semula.

- Pada langkah 6 prosedur pelarasan jam (rujuk halaman 11), tekan butang **SET** untuk pergi kepada mod tetapan tekanan. Tetapan semasa berkelip.

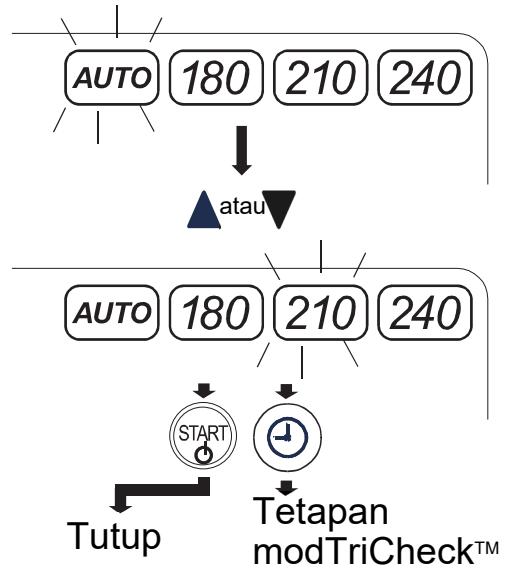

- Tekan butang **▲** atau **▼** untuk memilih nilai tekanan kira-kira 30 mmHg atau lebih di atas jangkaan tekanan sistolik anda daripada yang berikut.

AUTO	: Penekanan automatik (nilai lalai)
180	Nilai tekanan sebanyak 180 mmHg (tetap)
210	Nilai tekanan sebanyak 210 mmHg (tetap)
240	Nilai tekanan sebanyak 240 mmHg (tetap)

- Tekan butang **SET** untuk pergi ke mod tetapan TriCheck™. Tekan butang **START** (MULA) untuk mematikan peranti. Setelah tiga minit peranti tidak beroperasi, peranti akan ditutup secara automatik. Pengukuran seterusnya akan dilakukan dengan nilai tekanan baru.

Pengukuran dengan Tekanan Sistolik yang Dikehendaki

Gunakan kaedah ini apabila pengembungan semula berlaku berulang kali walaupun nilai tekanan ditetapkan kepada **240** dalam prosedur di atas atau apabila keputusan tidak dipaparkan walaupun tekanan berkurangan kepada 20 mmHg atau kurang.

1. Letakkan kaf pada lengan (sebaiknya lengan kiri).
2. Tekan dan tahan butang **START** (MULA) sehingga nombor kira-kira 30 hingga 40 mmHg lebih tinggi daripada tekanan sistolik yang anda jangkakan muncul.
3. Apabila nombor yang dikehendaki tercapai, lepaskan butang **START** (MULA) untuk memulakan pengukuran. Teruskan mengukur tekanan darah anda seperti yang diterangkan pada halaman sebelumnya.

Nota untuk Pengukuran Tepat

- Duduk dalam kedudukan yang selesa. Letakkan tangan anda di atas meja dengan telapak tangan menghadap ke atas dan kaf pada kedudukan yang sama dengan jantung anda.
- Rehat selama kira-kira lima hingga sepuluh minit sebelum mengambil ukuran. Sekiranya anda berasa teruja atau tertekan akibat tekanan emosi, pengukuran akan mencerminkan tekanan ini sebagai lebih tinggi (atau lebih rendah) daripada bacaan tekanan darah normal dan bacaan denyutan nadi biasanya menjadi lebih cepat berbanding biasa.
- Tekanan darah seseorang berbeza-beza secara berterusan, bergantung kepada aktiviti yang anda lakukan dan makanan yang anda makan. Minuman yang anda minum boleh mempunyai kesan yang sangat kuat dan pantas pada tekanan darah anda.
- Peranti ini mengukur ukurannya berdasarkan denyutan jantung. Jika anda mempunyai denyutan jantung yang lemah atau tidak teratur, peranti mungkin mengalami kesukaran untuk menentukan tekanan darah anda.
- Sekiranya peranti mengesan keadaan yang tidak normal, ia akan menghentikan pengukuran dan memaparkan simbol ralat. Rujuk halaman 6 untuk perihalan tentang simbol.
- Peranti ini bertujuan untuk digunakan oleh orang dewasa. Berunding dengan pakar perubatan anda sebelum menggunakan peranti ini pada kanak-kanak. Seorang kanak-kanak tidak boleh menggunakan peranti ini tanpa pengawasan.
- Prestasi monitor tekanan darah automatik ini mungkin dipengaruhi oleh suhu atau kelembapan atau ketinggian yang berlebihan.



Pengukuran TriCheck™


Mod The TriCheck™ mengambil tiga ukuran berturut-turut secara automatik dan memaparkan nilai purata bagi tiga ukuran tersebut.

Memilih Mod TriCheck™

1. Dalam mod tetapan tekanan, tekan butang **SET** untuk memasuki mod tetapan TriCheck™. Tetapan semasa berkelip.
2. Tekan butang **▲** atau **▼** untuk MENGHIDUPKAN atau MEMATIKAN mod TriCheck™.
HIDUP: Mod TriCheck™
MATI: Mod pengukuran biasa (nilai lalai)
3. Tekan butang **START** (MULA) atau **SET** untuk mematikan peranti. Setelah tiga minit peranti tidak beroperasi, peranti akan ditutup secara automatik.

Dalam mod tetapan tekanan,

Tekan 



Tetapan semasa berkelip


▲ atau **▼**

Tukar tetapan

 atau 

Pengukuran Menggunakan Mod TriCheck™

1. Tekan butang **START** (MULA). Semua segmen paparan dipaparkan. Sifar (0) yang dipaparkan berkelip sebentar dan pengukuran pertama bermula.
2. Apabila pengukuran selesai, bacaan tekanan sistolik dan diastolik dan kadar denyutan nadi dipaparkan, kemudian kira detik satu minit bermula untuk pengukuran ketiga.
3. Selepas satu minit, pengukuran kedua bermula.
4. Apabila pengukuran selesai, purata bacaan ukuran pertama dan kedua dipaparkan, kemudian kira detik satu minit bermula untuk pengukuran ketiga.
5. Selepas satu minit, pengukuran ketiga bermula.
6. Apabila pengukuran selesai, purata bacaan ketiga-tiga ukuran dipaparkan dan disimpan dalam memori.

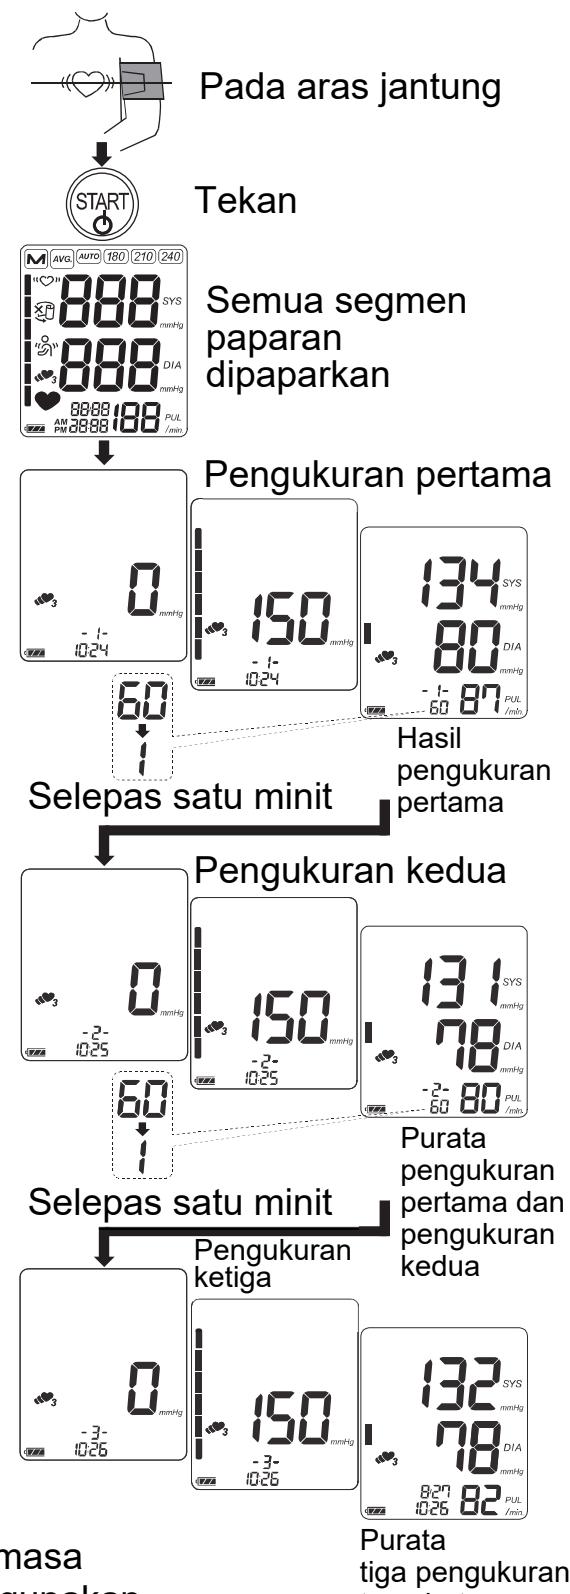

Nota:

- Semasa pengukuran, simbol TriCheck™ dipaparkan.
 - Untuk membatalkan ukuran, tekan butang **START** (MULA). Dalam kes ini, tiada data disimpan dalam memori.
 - Apabila simbol ralat julat kaf muncul semasa pengukuran pertama, batalkan ukuran, gunakan semula kaf dengan betul dan mulakan pengukuran baharu.
 - Selepas pengukuran, data purata ketiga-tiga ukuran disimpan dalam memori.
- Tiada data akan disimpan, apabila membatalkan pengukuran, sebelum selesai pengukuran ketiga.

Mengimbas Kembali Data Memori

Nota: Peranti ini menyimpan 90 ukuran terkini dalam memori.

- Tekan butang **▲** atau **▼**. Purata semua ukuran dan bilangan data dipaparkan.
(Jika tiada data, "0" akan dipaparkan.)
Tekan butang **▲**, **▼** atau **START** (MULA) untuk mematikan peranti.
- Setiap kali butang **▼** (atau butang **▲** untuk memaparkan data dalam susunan terbalik) ditekan, data memori adalah dipaparkan seperti berikut.


Purata semua ukuran AM (pagi) yang diambil antara 4:00 dan 9:59.
(Dalam contoh ini, 10 pengukuran.
Jika tiada data, "--" akan dipaparkan.)

↓
Purata semua ukuran PM (petang)
yang diambil antara 18:00 dan 1:59.
(Dalam contoh ini, 9 pengukuran.
Jika tiada data, "--" akan
dipaparkan.)

↓
Data terkini
(No.n, dalam contoh, No.35)
Tiga saat selepas paparan nombor data, data pengukuran dipaparkan.

⋮

↓
Data terakhir (No.1)
Tiga saat selepas paparan nombor data, data pengukuran dipaparkan.
- Selepas data terakhir dipaparkan, tekan butang **▼** untuk mengembalikan paparan purata semua pengukuran.
- Tekan butang **START** (MULA) untuk mematikan peranti. Setelah seminit peranti tidak beroperasi, peranti akan ditutup secara automatik.

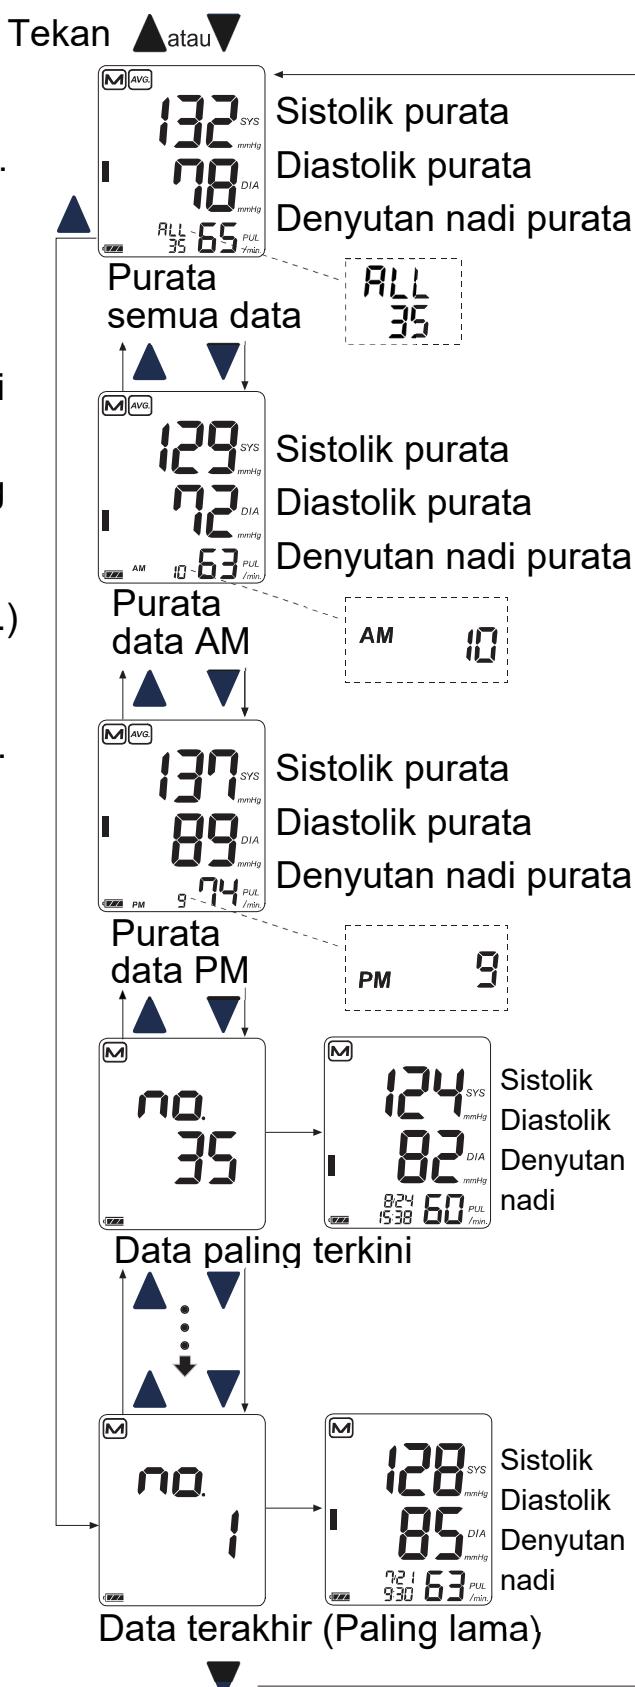

Apakah itu Penunjuk IHB/AFib?

Apabila monitor mengesan ritma tidak teratur semasa pengukuran, penunjuk IHB/AFib akan muncul pada paparan dengan nilai ukuran.

Nota: Kami mengesyorkan anda menghubungi pakar perubatan anda jika anda melihat penunjuk IHB/AFib «» ini dengan kerap.

Apakah AFib?

Jantung menguncup akibat isyarat elektrik yang terjadi dalam jantung dan mengalirkan darah ke seluruh badan. Pemfibrilan atrium (AFib) berlaku apabila isyarat elektrik dalam atrium menjadi keliru dan membawa kepada gangguan dalam selang denyutan nadi. AFib boleh menyebabkan darah terhenti di jantung, yang mudah menghasilkan darah beku yang menyebabkan strok dan serangan jantung.

Penunjuk Bar Tekanan

Penunjuk memantau kemajuan tekanan semasa pengukuran.



Penunjuk Klasifikasi WHO

Setiap segmen penunjuk bar bersamaan dengan klasifikasi tekanan darah WHO yang diterangkan dalam halaman seterusnya.

Penunjuk Klasifikasi WHO

- Tekanan darah tinggi yang teruk
- Tekanan darah yang sederhana
- Tekanan darah ringan
- Normal tinggi
- Normal
- Optimal

- : Penunjuk memaparkan segmen, berdasarkan data semasa, yang sepadan dengan klasifikasi WHO.

Contoh:



Tekanan darah yang sederhana



Tekanan darah ringan



Normal tinggi

Tentang Tekanan Darah

Apa itu Tekanan Darah?

Tekanan darah ialah daya yang dikenakan oleh darah terhadap dinding arteri. Tekanan sistolik berlaku apabila jantung mengecut. Tekanan diastolik berlaku apabila jantung mengembang. Tekanan darah diukur dalam milimeter merkuri (mmHg). Tekanan darah semula jadi yang diwakili oleh tekanan asas, yang diukur pada mulanya pada waktu pagi ketika seseorang sedang berehat dan sebelum makan.

Apakah Tekanan Darah Tinggi dan Bagaimana untuk Mengawalnya?

Tekanan darah tinggi merupakan tekanan darah arteri tinggi dan jika dibiarkan sahaja boleh menyebabkan banyak masalah kesihatan, termasuk strok dan serangan jantung. Darah tinggi boleh dikawal dengan mengubah gaya hidup, mengelakkan tekanan dan dengan ubat di bawah pengawal seliaan doktor.

Untuk mencegah darah tinggi atau untuk mengawal darah tinggi:

- Jangan merokok
- Bersenam dengan kerap
- Kurangkan pengambilan garam dan lemak
- Lakukan pemeriksaan fizikal dengan kerap
- Kekalkan berat badan yang bersesuaian


Mengapa Ukur Tekanan Darah di Rumah?

Tekanan darah yang diukur di klinik atau pejabat doktor boleh menyebabkan rasa bimbang dan boleh menyebabkan bacaan meningkat, 25 hingga 30 mmHg lebih tinggi berbanding tekanan darah yang diukur di rumah. Pengukuran di rumah mengurangkan kesan pengaruh luar terhadap bacaan tekanan darah dan menambah bacaan doktor serta menyediakan sejarah tekanan darah yang lebih tepat dan lengkap.

Klasifikasi Tekanan Darah WHO

Standard untuk menilai tekanan darah tinggi, tanpa mengira usia, telah ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), seperti yang ditunjukkan pada carta.

Bahan Rujukan: Journal of Hypertension 1999, Vol 17 No.2

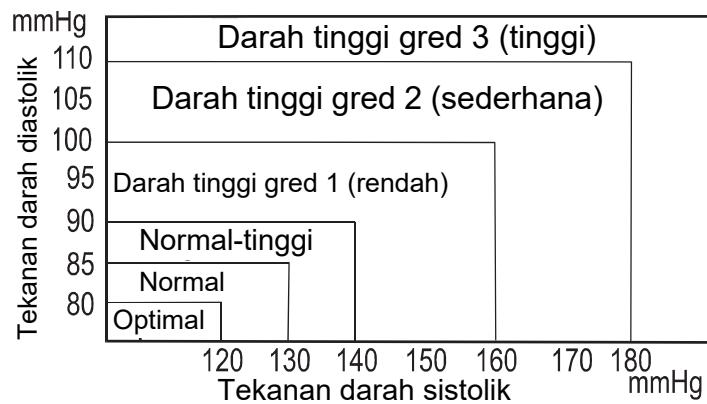


Variasi Tekanan Darah

Tekanan darah individu berbeza dengan banyak setiap hari dan mengikut musim. Ia boleh berbeza daripada 30 hingga

50 mmHg disebabkan pelbagai keadaan waktu siang. Bagi individu dengan tekanan darah tinggi, variasi ini lebih ketara. Lazimnya, tekanan darah meningkat semasa bekerja atau bermain dan menurun kepada tahap paling rendah semasa tidur. Oleh itu, jangan terlalu bimbang akan hasil satu ukuran.

Ambil ukuran pada waktu yang sama setiap hari menggunakan prosedur yang diterangkan dalam manual ini untuk mengetahui tekanan darah anda yang normal. Bacaan lazim memberikan sejarah tekanan darah yang lebih menyeluruh. Pastikan anda mencatat tarikh dan waktu semasa merekod tekanan darah anda. Rujuk doktor anda untuk pentafsiran data tekanan darah anda.

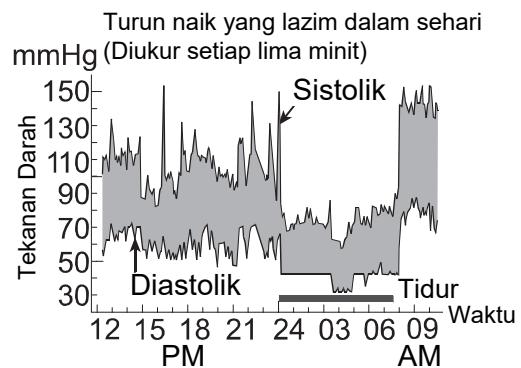

Penyelesaian masalah

Masalah	Sebab yang mungkin	Tindakan Disyorkan
Tiada apa-apa yang muncul pada paparan walaupun peranti dihidupkan.	Bateri lemah.	Ganti semua bateri dengan yang baharu.
	Terminal bateri tidak berada dalam kedudukan yang betul.	Pasang semula bateri dengan terminal negatif dan positif yang sepadan dengan yang ditunjukkan pada bahagian bateri.
Kaf tidak mengembang.	Voltan bateri terlalu rendah. ☒ (Tanda BATERI RENDAH) berkelip. Jika bateri lemah sepenuhnya, tanda tersebut tidak muncul.	Ganti semua bateri dengan yang baharu.
Peranti tidak mengukur. Bacaan terlalu tinggi atau terlalu rendah.	Kaf tidak digunakan dengan elok.	Gunakan kaf dengan betul.
	Anda menggerakkan lengan atau badan semasa pengukuran.	Pastikan anda tetap tenang dan diam semasa pengukuran.
	Kedudukan kaf tidak betul.	Duduk dengan selesa dan tenang. Letakkan tangan anda di atas meja dengan telapak tangan menghadap ke atas dan kaf pada kedudukan yang sama dengan jantung anda.

Masalah	Sebab yang mungkin	Tindakan Disyorkan
	_____	Jika anda mempunyai degupan jantung yang lemah atau tidak teratur, peranti mungkin mengalami kesukaran untuk menentukan tekanan darah anda.
Lain-lain	Nilai berbeza daripada yang diukur di klinik atau pejabat doktor.	Rujuk "Mengapa Ukur Tekanan Darah di Rumah?".
	_____	Keluarkan bateri. Letakkannya semula dengan betul dan ambil satu lagi ukuran.

Nota: Jika tindakan yang dinyatakan di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi wakil pengedar. Jangan cuba membuka atau membaiki produk ini, kerana sebarang percubaan untuk melakukannya akan membuat jaminan anda tidak sah.

Penyelenggaraan

Jangan buka peranti. Ia menggunakan komponen elektrik halus dan unit udara rumit yang boleh rosak. Jika anda tidak dapat membetulkan masalah menggunakan arahan penyelesaian masalah, hubungi wakil pengedar yang sah di kawasan anda atau jabatan perkhidmatan pelanggan kami. Perkhidmatan pelanggan A & D akan menyediakan maklumat teknikal, alat ganti dan unit kepada wakil pengedar.

Peranti ini direka dan dihasilkan untuk hayat perkhidmatan yang panjang. Walau bagaimanapun, secara am disyorkan supaya peranti diperiksa setiap 2 tahun, untuk memastikan fungsi dan ketepatan yang betul. Sila hubungi wakil pengedar yang sah di kawasan anda atau A & D untuk penyelenggaraan.

Data Teknikal

Jenis	UA-1020
Kaedah pengukuran	Pengukuran oscillometric
Julat pengukuran	Tekanan: 0 - 299 mmHg Tekanan sistolik: 60 - 279 mmHg Tekanan diastolik: 40 - 200 mmHg Denyutan nadi: 40 - 180 denyutan/minit
Ketepatan pengukuran	Tekanan: ±3 mmHg Denyutan nadi: ±5 %

Julat perkadaran Bekalan Kuasa	DC 6 V 3 W Bateri 4 x 1.5 V (R6P, LR6 atau AA) atau Penyesuai AC (TB-233C INPUT: AC 100 – 240 V 50/60 Hz 0.15 A) (Tidak disertakan)
Bilangan pengukuran	Kira-kira 1,000 ukuran apabila bateri alkali AA digunakan dengan nilai tekanan sebanyak 180 mmHg pada suhu bilik 23 °C
Klasifikasi	Peralatan ME berkuasa dalaman (Disediakan oleh bateri) / Kelas II (Disediakan oleh penyesuai) Mod operasi berterusan
Ujian klinikal	Mengikut ISO81060-2 : 2013
EMD	Dalam kajian pengesahan klinikal, K5 digunakan pada 85 orang subjek untuk penentuan bagi tekanan darah diastole. IEC 60601-1-2: 2014
Memori	90 pengukuran terakhir
Keadaan Operasi	+10 hingga +40 °C / 15 hingga 85 %RH / 800 hingga 1,060 hPa
Keadaan Pengangkutan/Penyimpanan	-20 hingga +60 °C / 10 hingga 95 %RH / 700 hingga 1,060 hPa
Dimensi	Kira-kira 140 [W] x 60 [H] x 105 [D] mm
Berat	Kira-kira 285 g, tidak termasuk bateri
Perlindungan Ingress	Peranti: IP20
Bahagian digunakan	Kaf Jenis BF 
Hayat berguna	Peranti: 5 tahun (apabila digunakan enam kali sehari) Kaf: 2 tahun (apabila digunakan enam kali sehari) Penyesuai AC: 5 tahun (apabila digunakan enam kali sehari)
Aksesori penyesuai AC TB-233C	Penyesuai adalah untuk menyambungkan monitor tekanan darah kepada sumber kuasa di rumah. Sila hubungi wakil A&D tempatan anda untuk pembelian. Penyesuai AC diperlukan untuk diperiksa atau diganti secara berkala.

Simbol-simbol yang dicetak pada penyesuai AC

Simbol	Fungsi / Makna
	Untuk kegunaan dalaman sahaja
	Peranti kelas II
	Fius haba
	Fius
	Label peranti arahan EC
	Label peranti pensijilan EAC
	Kekutuhan palam penyesuai AC

Aksesori dijual secara berasingan

Kaf

Nombor Katalog	Saiz Kaf	Saiz Lengan
CUF-D-LA-ISO	Kaf Dewasa besar	31 cm hingga 45 cm
CUF-I-ISO	Kaf julat lebar	22 cm hingga 42 cm
CUF-D-MA-ISO	Kaf semi besar	23 cm hingga 37 cm
CUF-F-A-ISO	Kaf dewasa	22 cm hingga 32 cm
CUF-D-SA -ISO	Kaf kecil	16 cm hingga 24 cm
CUF-G-A-ISO	Kaf dewasa SmoothFit	17 cm hingga 32 cm

penyesuai AC

Nombor Katalog	Palam (Jenis salur keluar)
TB-233C	Jenis C

Nota: Spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.

Klasifikasi IP ialah darjah perlindungan yang disediakan oleh lampiran mengikut IEC 60529. Peranti ini dilindungi daripada objek asing pepejal berdiameter 12 mm dan lebih besar seperti jari. Peranti ini tidak dilindungi daripada air.

MEMO

สารบัญ

เรียนผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน	2
ข้อสังเกตเบื้องต้น	2
ข้อควรระวัง	2
ข้อห้าม	3
การระบุชนิดส่วน	4
สัญลักษณ์	5
โหมดการทำงาน	7
การใช้มอนิเตอร์	8
การติดตั้ง/การเปลี่ยนถ่าย	8
การเชื่อมต่อห้อง	9
การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC	9
การปรับค่านาฬิกาในตัว	10
การเลือกผ้าพันแขนที่มีขนาดถูกต้อง	11
การใช้ผ้าพันแขน	11
วิธีการวัดผลอย่างแม่นยำ	12
การวัดผล	12
หลังการวัดผล	12
การวัดผล	13
การวัดผลแบบปกติ	13
การวัดผลด้วยค่าความดัน SET	14
การวัดผลด้วยค่าความดันช่วงหัวใจมีบีบีต้องการ	14
หมายเหตุว่าด้วยการวัดผลที่ถูกต้อง	15
การวัดผล TriCheck™	15
การเรียกคืนข้อมูลความจำ	17
ตัวบ่งชี้ IHB/AFib คืออะไร	18
ตัวบ่งชี้ AFib คืออะไร	18
ແຄນบ่งชี้ความดัน	18
ตัวบ่งชี้การจำแนกของ WHO	18
เกี่ยวกับความดันโลหิต	19
ความดันโลหิตคืออะไร	19
ความดันสูงคืออะไร และควบคุมได้อย่างไร	19
ทำไมจึงควรดูแลความดันโลหิตที่บ้าน	19
การจำแนกความดันโลหิตของ WHO	19
ความแปรผันของความดันโลหิต	19
การแก้ไขปัญหา	20
การบำรุงรักษา	21
ข้อมูลทางเทคนิค	21

เรียนผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีที่คุณได้ซื้อ เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล A&D รุ่นล่าสุด
เครื่องที่

ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายและมีความแม่นยำขึ้นนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการเรื่องการให้ยาหรือความตันโลหิตประจำวัน

เราขอแนะนำให้คุณอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานตัวเครื่องเป็นครั้ง
แรก

ข้อสังเกตเบื้องต้น

- เครื่องนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใหญ่ใช้งาน ไม่ใช่สำหรับเด็กแรกเกิดหรือทารก
- สภาพแวดล้อมสำหรับการใช้งาน เครื่องนี้ออกแบบมาให้ใช้งานด้วยตนเองในส
ภาพแวดล้อมการดูแลสุขภาพในบ้าน
- เครื่องนี้จะวัดความดันโลหิตและอัตราชีพจรของคนเพื่อการวินิจฉัย

ข้อควรระวัง

- เครื่องนี้สร้างขึ้นโดยใช้ส่วนประกอบที่มีความแม่นยำ ควรหลีกเลี่ยงจากอุณหภูมิที่
สูงหรือต่ำเกินไป ความชื้น แสงแดด ไฟฟ้าช็อต หรือฝุ่นละออง
- ทำความสะอาดเครื่องและผ้าพันแขนด้วยผ้าแห้งนุ่มหรือผ้าขนหน้าและสารชำระล้างที่
เป็นกลาง ห้ามใช้แอลกอฮอล์ เบนซิน ทินเนอร์ หรือสารเคมีที่รุนแรงอื่น ๆ
เพื่อทำความสะอาดเครื่องหรือผ้าพันแขน
- อย่าพันแขนแน่นเกินไปหรือจัดเก็บสายยางโดยพันกันแน่นเป็นระยะเวลานาน
 เพราะอาจทำให้ชินส่วนมือหยุดการใช้งานสั้นลง
- ระวังอย่าให้สายยางและสายเคเบิลรัดคอเด็กหรือทารก โดยมั้งเอิญ
- อย่านิดท่อนบนขณะตรวจวัด เพราะผ้าอาจรัดแขนโดยต่อเนื่องจนเกิดอาการบาดเจ็บ
- ตัวเครื่องและผ้าพันแขนกันน้ำไม่ได้ โปรดป้องกันไม่ให้เครื่องและผ้าพันแขนเปื้อ
นฝน เหื่อย และนำ
- ค่าการวัดผลอาจบิดเบือนได้หากใช้เครื่องใกล้กับโทรทัศน์ เตาไมโครเวฟ
โทรศัพท์มือถือ เครื่องเอกสารเรย์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีสนามไฟฟ้าแรงสูง
- อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย เช่น อุปกรณ์เครือข่ายภายในบ้าน โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์
ไร้สายและสถานีฐาน และเครื่องส่งรับวิทยุ อาจส่งผลต่อมonitor เดอร์วัดความดันโลหิต
นี้ได้ ดังนั้นควรเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้มีระยะห่างอย่างน้อย 30 ซม.
- อุปกรณ์ ชิ้นส่วน และงานที่ใช้แล้วไม่ถือเป็นขยะในครัวเรือนทั่วไป
ต้องกำจัดทิ้งตามระเบียบข้อมูลของห้องคืน
- เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC ให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าสามารถถอดอะแดปเตอร์ AC
ออกจากปลั๊กไฟได้ในกรณีที่จำเป็น
- เมื่อนำเครื่องกลับมาใช้ใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องสะอาด
- อย่าดัดแปลงเครื่อง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายกับตัวเครื่อง
- เพื่อวัดความดันโลหิต ผ้าพันแขนต้องมีขนาดมากพอที่จะหยุดการไหลเวียนโลหิต
ต่อทางหลอดเลือดแดงได้ชัดเจน การนึบอาจทำให้เกิดอาการปวด ชา หรือมีร
อุยแดงบนแขนช่วงขวา สภาพนี้จะปรากฏขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเครื่องวัดผล
ชำติดต่อกัน อาการปวด ชา หรือรอยแดงจะหายไปเมื่อเวลาผ่านไป


- การวัดความดันโลหิตบ่อยเกินไปอาจทำให้เกิดอันตรายจากการแทรกแซงการไฟล์เวียนโลหิต ตรวจสอบว่าการทำางานของเครื่องจะไม่ทำให้การไฟล์เวียนโลหิตบกพร่องเป็นเวลานานเมื่อใช้เครื่องนี้ชำ ๆ
- เราไม่ได้ทดสอบทางคลินิกกับทารกแรกเกิดและสตรีมีครรภ์ ห้ามใช้กับทารกแรกเกิดหรือสตรีมีครรภ์
- หากคุณเคยผ่าตัดเด้านมแล้ว ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่อง
- อย่าให้เด็กใช้เครื่องด้วยตัวเองและห้ามใช้เครื่องในสถานที่ที่ทารกเข้าถึงได้ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย
- มีชิ้นส่วนเล็ก ๆ ที่อาจทำให้หายใจไม่ออกหากทารกกลืนเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ห้ามสัมผัสส่วน, แจ็ค DC และผู้ป่วยในเวลาเดียวกัน เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าซื้อต์ได้
- ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ AC เมื่อไม่ได้ใช้งานขณะวัดผล
- การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือนี้อาจทำให้เกิดอันตรายได้
- หากถ่านลัดวงจร เครื่องอาจร้อนจนไฟไหม้ได้
- ให้เครื่องได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบก่อนใช้งาน (ประมาณหนึ่งชั่วโมง)
- อย่าสูบลมผ้ารัดแขนโดยไม่พันรอบแขนส่วนบนก่อน

ข้อห้าม


ต่อไปนี้เป็นข้อควรระวังในการใช้เครื่องอย่างเหมาะสม

- อย่าใช้ผ้าพันแขนที่ติดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์อื่น ๆ เพราะอุปกรณ์อาจทำงานผิดพลาด
- ผู้ที่มีอาการขาดเลือดในแขนอย่างรุนแรงต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้เครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางการแพทย์
- อย่าวินิจฉัยผลการวัดด้วยตัวเองและเริ่มต้นการรักษาด้วยตัวเอง ปรึกษาแพทย์ของคุณเสมอสำหรับการประเมินผลลัพธ์และการรักษา
- อย่าใช้ผ้าพันแขนที่มีบาดแผลที่ยังรักษาไม่หาย
- อย่าใช้ผ้าพันแขนที่รับการหยดยาเข้าหลอดเลือดหรือรับการถ่ายเลือด เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุได้
- ห้ามใช้เครื่องเมื่อมีก้าชไฟ เช่น แก๊สยาสลบ เพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้
- อย่าใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนความเข้มข้นสูง เช่น ห้องออกซิเจนความดันสูงหรือเต็นท์ออกซิเจน เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้


การระบุชิ้นส่วน

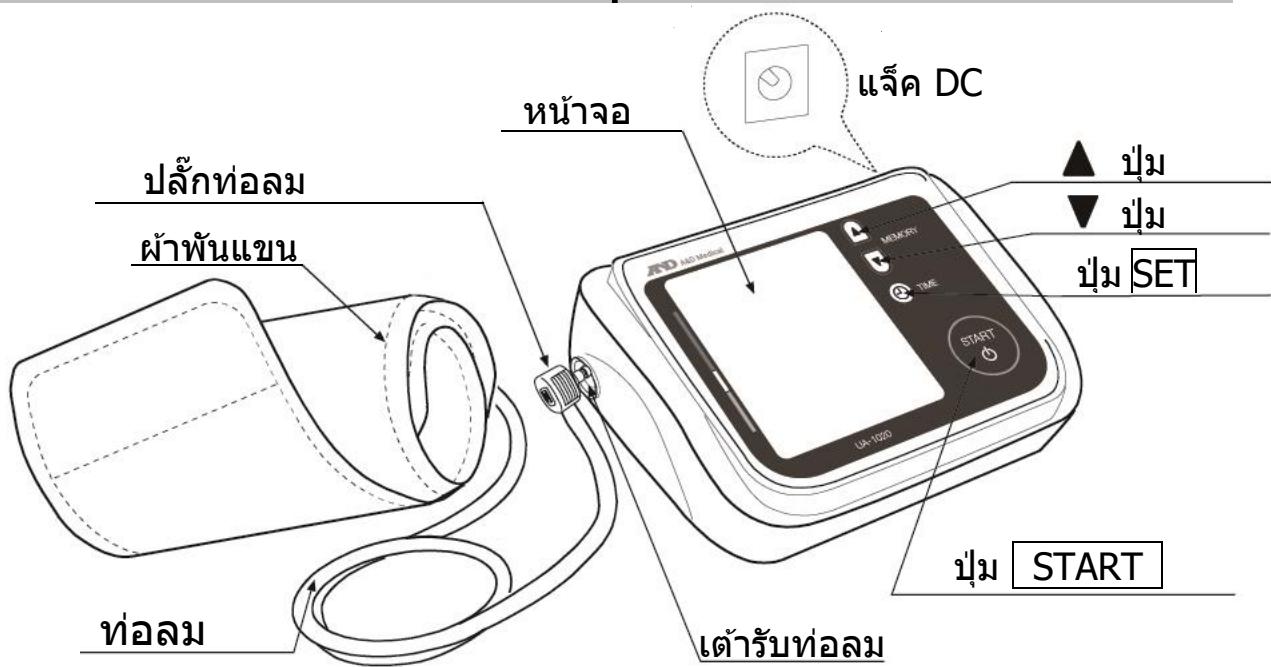

ช่องใส่ถ่าน

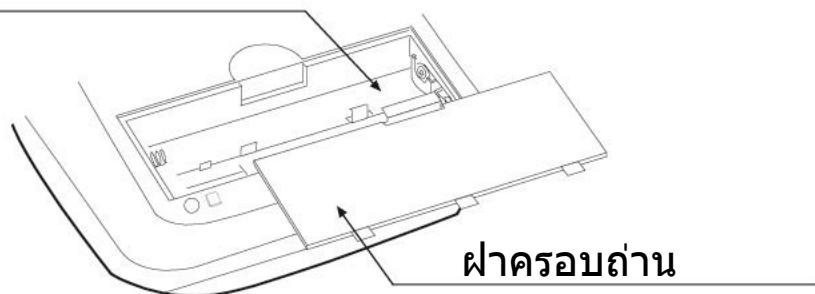

หน้าจอ

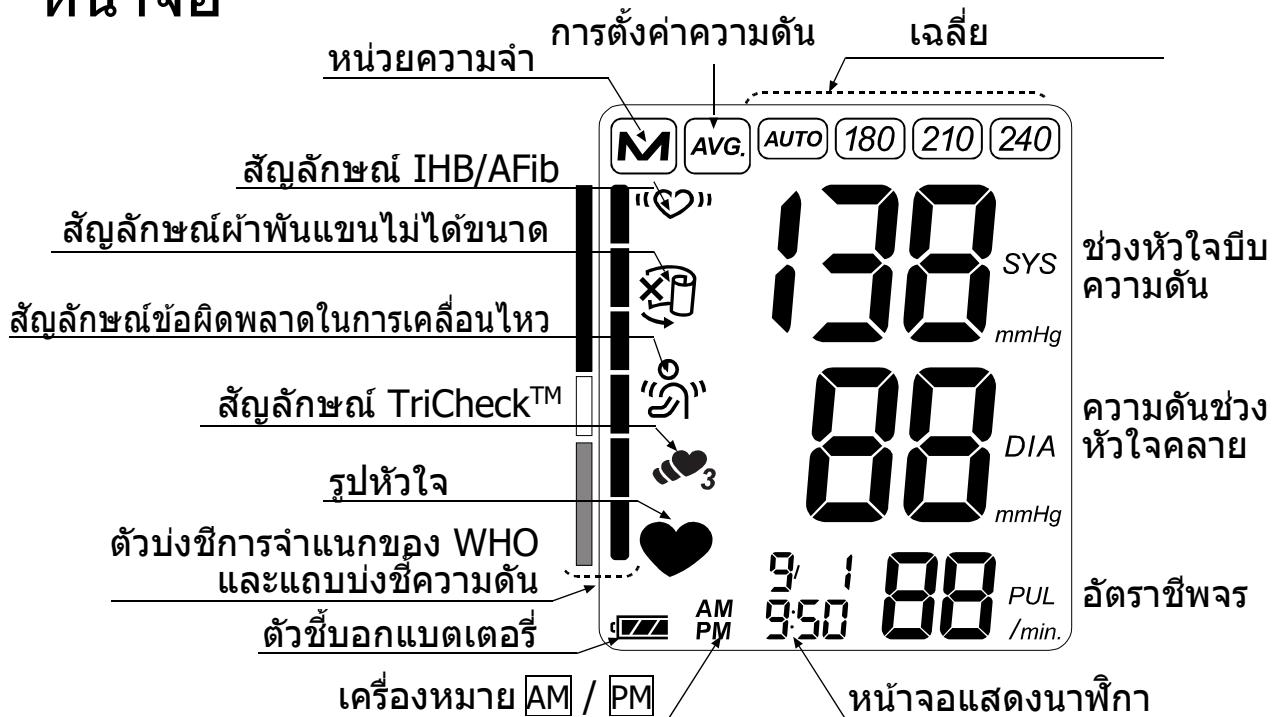

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ที่พิมพ์อยู่บนกล่องอุปกรณ์

สัญลักษณ์	หน้าที่/ความหมาย
⊕	สแตนด์บายและเปิดเครื่อง
(+) R6(LR6,AA)(-)	คุณภาพการใช้ถ่าน
---	ไฟฟ้ากระแสตรง
SN	หมายเลขผลิตภัณฑ์
ਮ	ผู้ผลิต
2020	วันที่ผลิต
	ประเภท BF: ผ้าพันแขนออกแนวมาเพื่อป้องกันจากการถูกไฟฟ้าช็อก เป็นพิเศษ
	อุปกรณ์ ชิ้นส่วน และถ่านที่ใช้แล้วไม่ถือเป็นขยะในครัวเรือนทั่วไป ต้องกำจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น
	ดูคู่มือ/แผ่นพับอธิบายการใช้งาน
⊖-C-⊕	ขั้วของแจ็ค DC
IP	สัญลักษณ์การคุ้มครองระหว่างประเทศ
	เก็บไว้ให้แห้ง

สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนหน้าจอ

สัญลักษณ์	หน้าที่/ความหมาย	ข้อควรปฏิบัติ
	ปรากฏขณะกำลังวัดผล กะพริบเมื่อเครื่องตรวจพบเชื้อ	ขณะวัดผล ให้อยู่นิ่ง ๆ
	สัญลักษณ์ IHB/AFib ปรากฏเมื่อต ตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอ อาจสว่างขึ้นมาเมื่อตรวจพบการสั่นสะเทือนเล็กน้อยอย่างอาการสั่นเทาหรือการขยายตัวได้	_____
	โหมด TriCheck™ จะทำการวัดติดต่อกันสามครั้งโดยอัตโนมัติและแสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งสามครั้ง	_____
	ปรากฏเมื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือแขน	ค่าที่อ่านได้อาจไม่ถูกต้อง ลองวัดผลอีกครั้ง อยู่นิ่ง ๆ ขณะวัดผล

สัญลักษณ์	หน้าที่/ความหมาย	ข้อควรปฏิบัติ
	ปรากฏขณะวัดผลเมื่อใส่ผ้าพันแขนอย่างหลวง ๆ	ค่าที่อ่านได้อาจไม่ถูกต้อง ใส่ผ้าพันแขนให้ถูกต้องแล้ว ลงวัดผลอีกครั้ง
	การวัดผลก่อนหน้านี้ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำ	_____
	ข้อมูลเฉลี่ย	_____
	แบบดูเตอร์รีเต็ม ตัวชี้บวกพลังงานจากแบบเตอร์รีขณะวัดผล	_____
	แบบเตอร์รีต่ำ พลังงานจากแบบเตอร์รีต่ำเมื่อมีการกะพริบ	ให้เปลี่ยนไปใช้ถ่านใหม่ทั้งหมด เมื่อเครื่องหมายกะพริบ
	ความดันโลหิตไม่เสถียรเพราะมีการขยายขณะวัดผล	ลงวัดผลอีกครั้ง อยู่นิ่ง ๆ ขณะวัดผล
	ค่าความดันช่วงหัวใจบีบและช่วงหัวใจคลายอยู่ภายใน 10 mmHg ของกันและกัน	ใส่ผ้าพันแขนให้ถูกต้องแล้วลงวัดผลอีกครั้ง
	ค่าความดันไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ผ้าพองตัว	
	ใส่ผ้าพันแขนไม่ถูกต้อง	
	ข้อผิดพลาดการแสดงผลซึ่งเครื่องตรวจจับซีพารอย่างไม่ถูกต้อง	ให้แกะถ่านออกแล้วกดปุ่ม START และใส่ถ่านใหม่มีกครั้ง หากยังมีข้อผิดพลาดปรากฏ ให้ติดต่อศูนย์บริการ
	ข้อผิดพลาดภายในของเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล	
SYS	ความดันโลหิตช่วงหัวใจบีบหน่วย mmHg	_____
DIA	ความดันโลหิตช่วงหัวใจคลายหน่วย mmHg	_____
PUL	อัตราชีพจรต่อนาที	_____
AM	ปรากฏเมื่อแสดงข้อมูลเฉลี่ย ข้อมูลที่เก็บตั้งแต่เวลา 4:00 ถึง 9:59	_____
PM	ปรากฏเมื่อแสดงข้อมูลเฉลี่ย ข้อมูลที่เก็บตั้งแต่เวลา 18:00 ถึง 1:59	_____
	การตั้งค่าความดัน ระบุค่าความดันที่ผู้ใช้งานได้ก่อนหน้านี้	_____

โภมดการทำงาน

1. การวัดผลแบบปกติ

กดปุ่ม **START** เครื่องจะวัดความดันโลหิตและเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำ
เครื่องนี้สามารถเก็บข้อมูลการวัดผล 90 ครั้งล่าสุดไว้ในหน่วยความจำ

2. การเรียกคืนข้อมูล

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเรียกคืนข้อมูลจากหน่วยความจำ ค่าเฉลี่ยของการวัดผลทั้งหมดจะปรากฏบนจอตามภาพทางขวาเมื่อ

เมื่อกดปุ่ม **▼** ในแต่ละครั้ง เครื่องจะแสดงข้อมูลจากหน่วยความจำดังต่อไปนี้


ข้อมูลเฉลี่ยของการวัดผลในช่วง AM (เช้า)
ทั้งหมดที่ดำเนินการตั้งแต่เวลา
4:00 ถึง 9:59 น.

↓
ข้อมูลเฉลี่ยของการวัดผลในช่วง PM (เย็น)
ทั้งหมดที่ดำเนินการตั้งแต่เวลา
18:00 ถึง 1:59 น.

↓
ข้อมูลล่าสุด
(No. ก โดยในตัวอย่างแสดงเป็น No.35)

↓
ข้อมูลสุดท้าย (No.1)

สำหรับรายละเอียดในการเรียกคืนข้อมูล โปรดดูที่
“การเรียกคืนข้อมูลความจำ”



3. การลบข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บภายในหน่วยความจำ

กดทั้งปุ่ม **▲** และ **▼** เครื่องหมาย **M** และตัวขึ้นลง
กับแบบเดอร์จะปรากฏ กดทั้งปุ่ม **▲** และ **▼** จนกว่าเครื่อง
หมาย **M** ที่สว่างอยู่จะเริ่มกะพริบเพื่อลบข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในหน่วยความจำ




4. การวัดผลด้วยค่าความดันช่วงหัวใจบีบที่ต้องการ ดูหน้า 14 เพื่ออ่านการวัดผลด้วยค่าความดันช่วงหัวใจบีบที่ต้องการ

การใช้มอนิเตอร์

การติดตั้ง/การเปลี่ยนถ่าน

1. ถอนฝาครอบถ่านออก
2. แกะถ่านที่ใช้แล้วออก จากนั้นใส่ถ่าน ก้อนใหม่ลงในช่องใส่ถ่านตามภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ตรงตำแหน่ง ตามข้อ (+ และ -) ใช้ถ่าน R6P, LR6 หรือ AA เท่านั้น
3. ปิดฝาครอบถ่าน

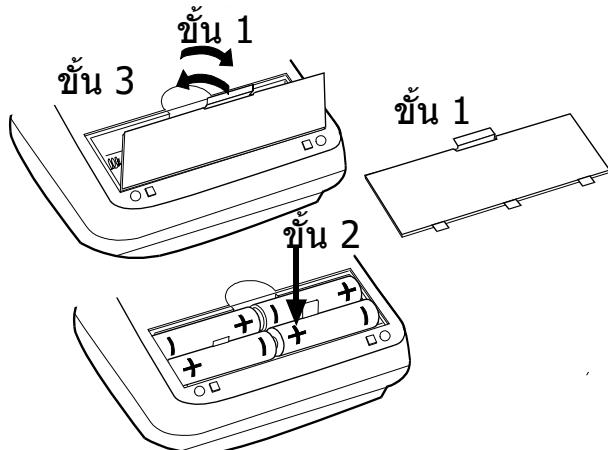


คำเตือน

- ใส่ถ่านลงในช่องตามภาพ หากใส่ไม่ถูกต้อง เครื่องจะไม่ทำงาน
- เมื่อ (เครื่องหมายแบตเตอรี่ต่ำ) กะพริบบนหน้าจอ ให้เปลี่ยนไปใช้ถ่านใหม่ทันที ห้ามใช้ถ่านก้อนเก่าร่วมกับก้อนใหม่ เพราะอาจทำให้อายุแบตเตอรี่สั้นลงหรือทำให้เครื่องทำงานบกพร่องโดยให้เปลี่ยนถ่านหลังจากปิดเครื่องไปแล้ว 2 วินาทีขึ้นไปเมื่อ (เครื่องหมายแบตเตอรี่ต่ำ) ยังปรากฏหลังจากเปลี่ยนถ่านแล้ว ให้ทำการวัดความดันโลหิต เครื่องอาจรับถ่านใหม่หลังจากนั้น
- (เครื่องหมายแบตเตอรี่ต่ำ) ไม่ปรากฏขึ้นเมื่อแบตเตอรี่หมด
- อายุแบตเตอรี่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิโดยรอบ และอายุอาจสั้นลงเมื่อยูํในที่อุณหภูมิต่ำ โดยทั่วไปแล้ว ถ่าน LR6 ใหม่ 4 ก้อนจะอยู่ได้ประมาณ 1 ปีเมื่อใช้วัดผล 2 ครั้งต่อวัน
- ใช้ถ่านตามที่ระบุไว้เท่านั้น ถ่านที่ติดมากับเครื่องมีไว้สำหรับทดสอบประสิทธิภาพมอนิเตอร์และอาจมีอายุการใช้งานจำกัด
- ให้แกะถ่านออกหากคุณไม่ได้ใช้เครื่องเป็นระยะเวลานานมิฉะนั้นถ่านอาจมีน้ำรั่วจนเครื่องทำงานบกพร่อง

การใช้มอนิเตอร์

การเชื่อมต่อห้องล้ม

เสียบปลั๊กห้องล้มเข้าไปใน
เต้ารับห้องล้มให้แน่น

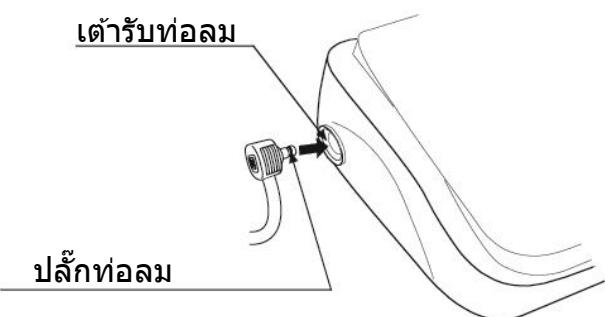

การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC

เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ AC
เข้ากับแจ็ค DC
จากนั้น เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC
เข้ากับปลั๊กไฟ

ปลั๊กอะแดปเตอร์ AC



- ใช้อะแดปเตอร์ AC ตามที่ระบุไว้
(ดูที่หน้า 22)
- เมื่อตึงอะแดปเตอร์ AC ออกจากปลั๊กไฟ ให้จับลำตัวแล้วดึงออกมา
- เมื่อตึงปลั๊กอะแดปเตอร์ AC ออกจาก เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล
ให้จับแล้วดึงปลั๊กออกจากมอนิเตอร์

การใช้มอนิเตอร์

การปรับค่านาฬิกาในตัว ตั้งนาฬิกาก่อนใช้

- กดปุ่ม **SET** จนกว่าเลขปีจะเริ่มกะพริบ
- เลือกปีโดยกดปุ่ม **▲** หรือ **▼**
กดปุ่ม **SET** เพื่อตั้งค่าปีปัจจุบัน จากนั้นจึงเปลี่ยนไปเลือกเดือน/วัน สามารถตั้งค่าเป็นวันที่ได้แก่ ด้านในช่วงระหว่างปี 2010 และ 2059
- เลือกเดือนโดยกดปุ่ม **▲** หรือ **▼**
กดปุ่ม **SET** เพื่อตั้งค่าเดือนปัจจุบัน จากนั้นจึงเปลี่ยนไปเลือกวัน
- เลือกวันโดยกดปุ่ม **▲** หรือ **▼**
กดปุ่ม **SET** เพื่อตั้งค่าวันปัจจุบัน จากนั้นจึงเปลี่ยนไปเลือกชั่วโมง/นาที
- เลือกชั่วโมงโดยกดปุ่ม **▲** หรือ **▼**
กดปุ่ม **SET** เพื่อตั้งค่าชั่วโมงปัจจุบัน จากนั้นจึงเปลี่ยนไปเลือกนาที
- เลือกนาทีโดยกดปุ่ม **▲** หรือ **▼**
(กดปุ่ม **SET** เพื่อไปที่โหมดการตั้งค่าความดัน สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่หน้า 14)
กดปุ่ม **START** เพื่อปิดเครื่อง

หมายเหตุ: เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลา 3 นาที

เครื่องจะปิดลงอัตโนมัติ

เมื่อไม่ได้ตั้งค่านาฬิกา

- - / - -

ส่วนนาฬิกาบนหน้าจอจะแสดง

- : - -

ดังเครื่องหมายยัตติภาคตั้งที่

แสดงอยู่ทางขวามือ

เมื่อใช้งานตัวเครื่องเป็นครั้งแรก

นาฬิกาจะยังไม่ตั้งค่า

เมื่อถอดเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟเป็นเวลานานกว่า 30 วินาที วันที่ เวลา

และค่าความดันที่ตั้งไว้จะถูกลบ เมื่อวันที่ เวลา และค่าความดันที่ตั้งไว้ถูก

ลบ โปรดตั้งใหม่อีกครั้ง

- การกดปุ่ม **▲** หรือ **▼** ค้างไว้จะทำให้ค่าเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง



การใช้มอนิเตอร์

การเลือกผ้าพันแขนที่มีขนาดถูกต้อง

การใช้ผ้าพันแขนขนาดที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญต่อการอ่านค่าให้แม่นยำ หากใช้ผ้าพันแขนขนาดไม่เหมาะสม ค่าความดันโลหิตที่อ่านได้อาจไม่ถูกต้อง

- ผ้าพันแขนแต่ละชิ้นมีขนาดแขนพิมพ์ไว้อยู่
- ผ้าพันแขนเป็นวัสดุสินเปลือง หากเกิดการฉีกขาด ให้ซื้อชิ้นใหม่

ขนาดแขน	ขนาดผ้าพันแขนที่แนะนำ	หมายเลขแค็ตตาล็อก
31-45 ซม.	ผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่ขนาดใหญ่	CUF-D-LA-ISO
22-42 ซม.	ผ้าพันแขนช่วงกว้าง	CUF-I-ISO
23-37 ซม.	ผ้าพันแขนขนาดกึ่งใหญ่	CUF-D-MA-ISO
22-32 ซม.	ผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่	CUF-F-A-ISO
16-24 ซม.	ผ้าพันแขนขนาดเล็ก	CUF-D-SA-ISO
17-32 ซม.	ผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่ SmoothFit	CUF-G-A-ISO

ขนาดแขน: เส้นรอบวงที่ใบเชิปส์

การใช้ผ้าพันแขน

1. นำผ้ามาพันตันแขนประมาณ 1-2 ซม. หนีบข้อพับตามภาพ ให้ตัวผ้าสัมผัสกับผิวนังโดยตรง เพราะเสื้อผ้าอาจทำให้จับซีพจรได้ยาก ส่งผลให้วัดค่าผิดพลาด
2. การบีบรัดของตันแขนที่เกิดจากกรามวันแขนเสื้อจะนแน่นอาจทำให้อ่านค่าได้ไม่ถูกต้อง



สัญลักษณ์ที่พิมพ์อยู่บนผ้าพันแขน

สัญลักษณ์	หน้าที่/ความหมาย	ข้อควรปฏิบัติ
●	เครื่องหมายตำแหน่งหลอดเลือดแดง	ให้เครื่องหมาย ● อยู่บนหลอดเลือดแดงช่วงตันแขนหรืออยู่ในแคลเดียกับนิวนางด้านในของแขน
REF	หมายเลขแค็ตตาล็อก	
LOT	หมายเลขล็อต	
MD	ผู้ผลิต	
	อุปกรณ์ทางการแพทย์	

การใช้มอนิเตอร์

วิธีการวัดผลอย่างแม่นยำ

เพื่อให้การวัดความดันโลหิตมีความแม่นยำที่สุด ให้ปฏิบัติตามดังนี้:

- นั่งบนเก้าอี้อย่างสบาย ๆ วางแขนของคุณบนโต๊ะ อย่าแน่นไขว้ข้า วางเท้าให้ติดพื้นและนั่งตัวตรง
- ผ่อนคลายประมาณ 5-10 นาทีก่อนวัดผล
- ให้ตรงกลางผ้าพันแขนอยู่ระดับเดียวกับหัวใจของคุณ
- อยู่นิ่ง ๆ เสียง ๆ ขณะวัดผล
- อย่าวัดผลโดยทันทีหลังออกจากลังกาหรืออาบน้ำ ให้พัก 20-30 นาทีก่อนวัดผล
- วัดผลความดันโลหิตของคุณเวลาเดิมทุกวัน

การวัดผล

ขณะที่วัดผล หากรู้สึกว่าผ้าพันแขนรัดแน่น นั่นเป็นเรื่องปกติ (ไม่ต้องตกใจ)

หลังการวัดผล

หลังจากวัดผล ให้กดปุ่ม **START** เพื่อปิดเครื่อง
แกะผ้าพันแขนออกแล้วบันทึกข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: เครื่องนี้มีฟังก์ชันปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะปิดเครื่องหลังการวัดผลประมาณ 1 นาทีให้มีระยะเวลาอย่างน้อย 3 นาทีระหว่างการวัดผลแต่ละครั้งของคน ๆ เดียวกัน

การวัดผล

ก่อนการวัดผล โปรดดูที่ “หมายเหตุว่าด้วยการวัดผลที่ถูกต้อง” ในหน้า 15

การวัดผลแบบปกติ

- นำผ้าพันแขน (ถ้าเป็นไปได้ให้พันแขนซ้าย)
นั่งนิ่ง ๆ ขณะวัดผล

- กดปุ่ม **START**

เช็คเมนต์ทั้งหมดจะปรากฏบนจอ
เลขศูนย์ (0) จะพรีบช้ำครู่
หน้าจอเปลี่ยนไปตามภาพด้านขวาเมื่อเริ่มก
ารวัดผล ผ้าพันแขนพองตัวขึ้น
หากรู้สึกว่าผ้าพันแขนรัดแน่น นั่นเป็นเรื่องปกติ
ແຄบบงซึ่ความดันจะแสดงอยู่ที่ขوبด้านซ้ายข
องหน้าจอขณะที่ผ้าพันแขนพองตัว

หมายเหตุ: หากคุณต้องการให้ผ้าหยุดพองตัว
ให้กดปุ่ม **START** อีกครั้ง

- เมื่อผ้าพองตัวจนเสร็จ ก็จะเริ่มแฟบโดย
อัตโนมัติและ (รูปหัวใจ) จะกะพริบ
เพื่อแสดงให้เห็นว่ากำลังวัดผล เมื่อตรวจ
จับชีพจรได้แล้ว รูปหัวใจจะกะพริบตาม
จังหวะชีพจร


หมายเหตุ: หากไม่ได้ความดันที่ถูกต้อง ผ้าพันแ
ขนจะพองตัวอีกครั้งโดยอัตโนมัติ
เพื่อเลี้ยงการพองตัวอีกครั้ง โปรดดูที่
“การวัดผลด้วยค่าความดัน SET” ในหน้าต่อไป

- เมื่อการวัดผลสิ้นสุดลง ค่าความดันช่วงหัวใจบีบ
และช่วงหัวใจคลายที่อ่านได้และอัตราชีพจรจะบ
รากฎูนนจอ
ผ้าพันแขนปล่อยลมที่เหลือจนแฟบโดยสมบูรณ์


- กดปุ่ม **START** เพื่อปิดเครื่องเมื่อไม่ใช่
ด้ใช้งานเครื่องเป็นเวลา 1 นาที
เครื่องจะปิดลงอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ให้มีระยะเวลาอย่างน้อย 3 นาทีระหว
างการวัดผลแต่ละครั้งของคน ๆ
เดียวกัน


ที่ระดับหัวใจ




เช็คเมนต์ทั้งหมด
จะปรากฏบนจอ




เลขศูนย์บนหน้าจอ
เริ่มการพองตัว



เพิ่มแรงดัน



กำลังวัดผล




ความดันช่วงหัวใจบีบ

ความดันช่วงหัวใจคลาย

การจำแนกของ WHO

อัตราชีพจร



ปล่อยลมที่เหลือโดยอัตโนมัติ


การวัดผล

รุ่น UA-1020 นี้ออกแบบมาเพื่อตรวจจับชีพจรและทำให้ผ้าพันแขนของตัวเพื่อวัดความดันช่วงหัวใจบีบโดยอัตโนมัติ หากการพองตัวอีกครั้งเกิดขึ้นช้า ๆ ให้ใช้วิธีต่อไปนี้

การวัดผลด้วยค่าความดัน SET


อาจเกิดการพองตัวช้าระหว่างการวัดผลความดันโลหิต สามารถตั้งค่าความดันแบบคงที่เพื่อหลีกเลี่ยงการพองตัวช้าได้

1. ในขั้นที่ 6 ของขั้นตอนการปรับนาฬิกา (ดูที่หน้า 10) ให้กดปุ่ม **SET** เพื่อไปที่โหมดการตั้งค่าความดัน การตั้งค่าปัจจุบันจะกระพริบ

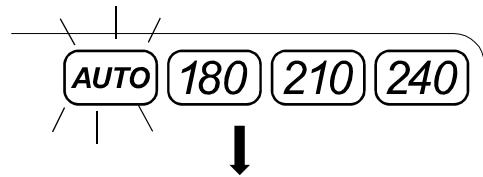

2. กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือกค่าความดันประมาณ 30 mmHg หรือสูงกว่าค่าความดันช่วงหัวใจบีบที่คาดไว้จากการรายการต่อไปนี้

AUTO : การปรับความดันอัตโนมัติ (ค่าเริ่มต้น)
180 : ค่าความดัน 180 mmHg (คงที่)
210 : ค่าความดัน 210 mmHg (คงที่)
240 : ค่าความดัน 240 mmHg (คงที่)

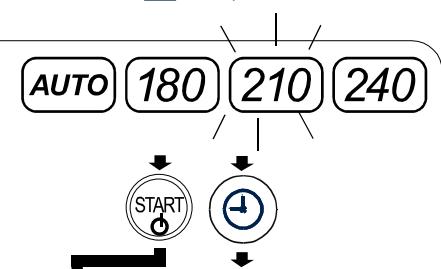

3. กดปุ่ม **SET** เพื่อไปที่โหมดการตั้งค่า TriCheck™ กดปุ่ม **START** เพื่อปิดเครื่อง เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลา 3 นาที เครื่องจะปิดลงอัตโนมัติการวัดผลครั้งต่อไปจะดำเนินการด้วยค่าความดันใหม่


ปิดเครื่อง โหมดการตั้งค่า TriCheck™

การวัดผลด้วยค่าความดันช่วงหัวใจบีบที่ต้องการ

ให้ใช้วิธีการนี้เมื่อเกิดการพองตัวช้าหลายครั้งแม้ว่าจะตั้งค่าความดันไว้ที่ **240** ในขั้นตอนข้างต้น หรือเมื่อหน้าจอไม่แสดงผลแม้ว่าความดันจะลดลงเหลือ 20 mmHg หรือต่ำกว่าแล้ว

1. นำผ้าพันแขน (ถ้าเป็นไปได้ให้พันแขนซ้าย)
2. กดปุ่ม **START** ค้างไว้จนกว่าตัวเลขสูงกว่าค่าความดันช่วงหัวใจบีบที่คุณคาดไว้ประมาณ 30 ถึง 40 mmHg จะปรากฏ
3. เมื่อถึงตัวเลขที่ต้องการ ให้ปล่อยปุ่ม **START** เพื่อเริ่มวัดผล วัดผลค่าความดันโลหิตของคุณต่อไปตามที่ได้บรรยายไว้ในหน้าที่แล้ว

ที่ระดับหัวใจ



กดปุ่มค้างไว้

ปล่อยมือจากปุ่มเมื่อได้ค่าความดันช่วงหัวใจบีบที่ต้องการ



ดูหน้าที่แล้วเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับการวัดผล

หมายเหตุว่าด้วยการวัดผลที่ถูกต้อง

- นั่งลงในท่าที่รู้สึกสบาย วางแขนของคุณบนโต๊ะ หายใจลึกๆ ให้ผ้าพันแขนอยู่ระดับเดียวกับหัวใจ
- ผ่อนคลายประมาณ 5-10 นาทีก่อนวัดผล หากคุณตื่นเต้นหรือหงุดหงิดหัวใจเป็นผลมาจากการความเครียดทางอารมณ์ ความเครียดนี้จะทำให้วัดผลได้ค่าที่สูงกว่า (หรือต่ำกว่า) ค่าความดันโลหิตที่อ่านได้ตามปกติ และโดยทั่วไปชีพจรที่อ่านได้จะสูงกว่าปกติ
- ค่าความดันโลหิตของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำอะไรหรือกินอะไรมา สิ่งที่คุณดื่มสามารถส่งผลกระทบแรงรุนแรงรวมต่อความดันโลหิต
- เครื่องนี้อาศัยการวัดผลจากการเต้นของหัวใจ หากคุณมีอัตราการเต้นของหัวใจอ่อนหรือไม่สม่ำเสมอ ตัวเครื่องอาจมีปัญหาในการหาค่าความดันโลหิตของคุณ
- หากเครื่องตรวจพบความผิดปกติ เครื่องจะหยุดการวัดผลแล้วแสดงสัญลักษณ์ข้อผิดพลาดบนจอ ไปที่หน้า 6 เพื่อดูคำอธิบายสัญลักษณ์
- เครื่องนี้ทำมาเพื่อให้ผู้ใหญ่ใช้งาน ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้เครื่องนี้กับเด็กเด็กไม่ควรใช้เครื่องนี้โดยไม่มีผู้ดูแล
- อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป ความชื้น หรือระดับความสูงอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลอัตโนมัติ


การวัดผล TriCheck™

โหมด TriCheck™ จะทำการวัดติดต่อกันสามครั้งโดยอัตโนมัติและแสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งสามครั้ง

การเลือกโหมด TriCheck™

1. ในโหมดการตั้งค่าความดัน ให้กดปุ่ม **SET** เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่า TriCheck™ การตั้งค่าปัจจุบันจะกะพริบ
2. กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเปิดหรือปิดโหมด TriCheck™
เปิด: โหมด TriCheck™
ปิด: โหมดการวัดผลแบบปกติ (ค่าเริ่มต้น)
3. กดปุ่ม **START** หรือ **SET** เพื่อปิดเครื่อง เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลา 3 นาที เครื่องจะปิดลงอัตโนมัติ

ในโหมดการตั้งค่าความดัน



การตั้งค่าปัจจุบันจะกะพริบ

↓
หรือ
เปลี่ยนการตั้งค่า




การวัดผลโดยใช้โนมด TriCheck™

- กดปุ่ม **START**
เช็คเมนต์ทั้งหมดจะปรากฏบนจอ
เลขศูนย์ (0) กะพริบข่าวครู่และจะ
เริ่มวัดผลครั้งที่ 1
- เมื่อการวัดผลสิ้นสุดลง ค่าความดันข่วงหัวใจบีบและข่วงหัวใจคลายที่อ่านได้และอัตราชีพจรจะปรากฏบนจอ จากนั้นจะนับถอยหลัง 1 นาทีเพื่อเริ่มการวัดผลครั้งที่ 2
- การวัดผลครั้งที่ 2 จะเริ่มขึ้นหลังจากผ่านไป 1 นาที
- เมื่อการวัดผลสิ้นสุดลง ค่าเฉลี่ยที่อ่านได้ของ การวัดผลครั้งที่ 1 และ 2 จะปรากฏบนจอ จากนั้นจะนับถอยหลัง 1 นาทีเพื่อเริ่มการวัดผลครั้งที่ 3
- การวัดผลครั้งที่ 3 จะเริ่มขึ้นหลังจากผ่านไป 1 นาที
- เมื่อการวัดผลสิ้นสุดลง ค่าเฉลี่ยที่อ่านได้ของ การวัดผลหั้งสามครั้งจะปรากฏบนจอ และจะได้รับการจัดเก็บภายในหน่วยความจำ

หมายเหตุ:


- ในระหว่างการวัดผล สัญลักษณ์ TriCheck™ จะปรากฏขึ้น
- เพื่อยกเลิกการวัดผล ให้กดปุ่ม **START** ในกรณีนี้ เครื่องจะไม่จัดเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำ
- เมื่อสัญลักษณ์ผ้าพันแขนไม่ได้ขนาดปรากฏขึ้นระหว่างการวัดผลครั้งแรก ให้ยกเลิกการวัดผลแล้วสูบผ้าพันแขนใหม่ให้ถูกต้อง จากนั้นจึงเริ่มทำการวัดผลใหม่
- หลังการวัดผล ค่าเฉลี่ยที่อ่านได้ของ การวัดผลหั้งสามครั้งจะได้รับการจัดเก็บภายในหน่วยความจำ เมื่อยกเลิกการวัดก่อนการวัดผลครั้งที่ 3 จะเสร็จสิ้น เครื่องจะไม่จัดเก็บข้อมูล

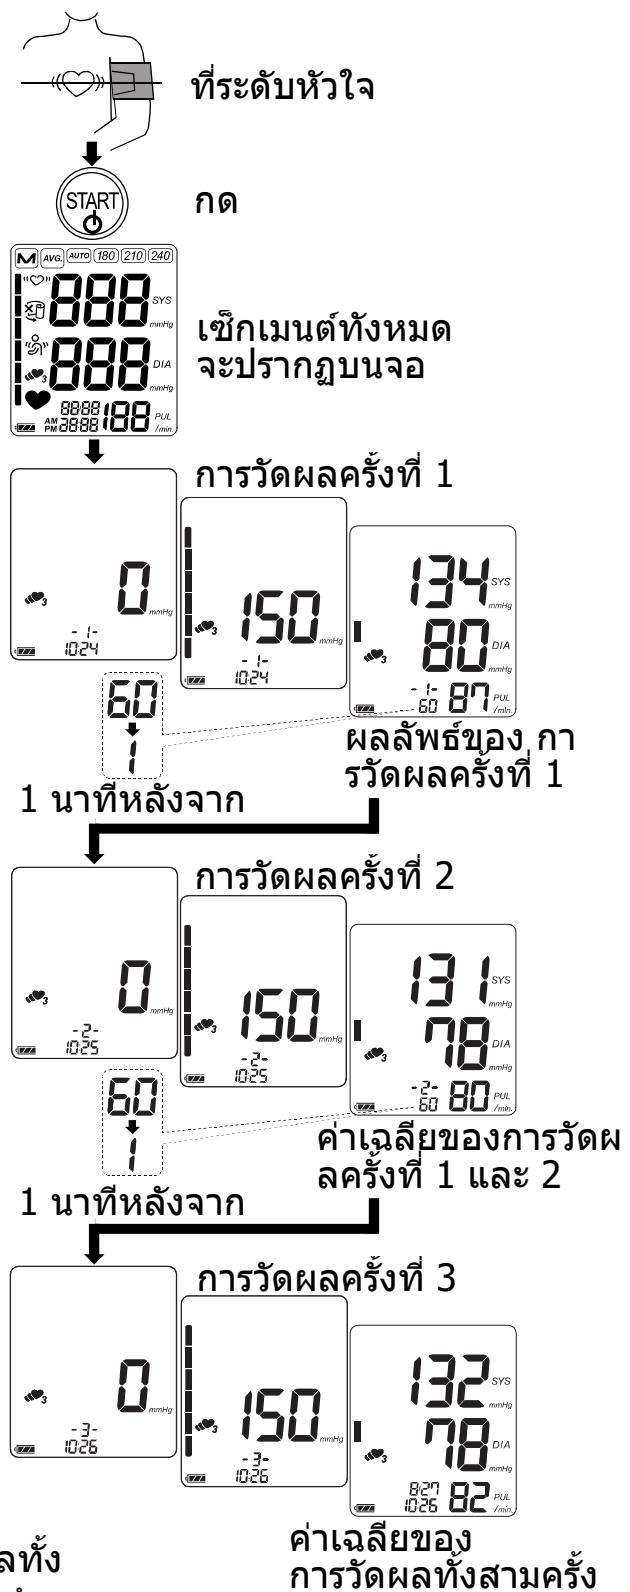

การเรียกคืนข้อมูลความจำ

หมายเหตุ: เครื่องนี้สามารถเก็บข้อมูลการวัดผล 90 ครั้งล่าสุดไว้ในหน่วยความจำ

- กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ ค่าเฉลี่ยของการวัดผลและจำนวนข้อมูลทั้งหมดจะปรากฏ (หากไม่มีข้อมูล เครื่องจะแสดงค่า "0" กดปุ่ม ▲, ▼ หรือ **START** เพื่อปิดเครื่อง)
- เมื่อกดปุ่ม ▼ (หรือกดปุ่ม ▲ เพื่อแสดงข้อมูลโดยเรียงย้อนกลับ) ในแต่ละครั้ง เครื่องจะแสดงข้อมูลจากหน่วยความจำดังต่อไปนี้
 - ข้อมูลเฉลี่ยของการวัดผลในช่วง AM (เช้า) ทั้งหมดที่ดำเนินการตั้งแต่เวลา 4:00 ถึง 9:59 น. (จากตัวอย่างการวัดผล 10 ครั้ง หากไม่มีข้อมูล เครื่องจะแสดงค่า "--")
 - ข้อมูลเฉลี่ยของการวัดผลในช่วง PM (เย็น) ทั้งหมดที่ดำเนินการตั้งแต่เวลา 18:00 ถึง 1:59 น. (จากตัวอย่างการวัดผล 9 ครั้ง หากไม่มีข้อมูล เครื่องจะแสดงค่า "--")
 - ข้อมูลล่าสุด (No.ก โดยในตัวอย่าง แสดงเป็น No.35) หลังจากแสดงตัวเลขข้อมูลได้ 3 วินาที ข้อมูลการวัดผลจะแสดงขึ้น
 - ⋮
 - ข้อมูลล่าสุดท้าย (No.1) หลังจากแสดงตัวเลขข้อมูลได้ 3 วินาที ข้อมูลการวัดผลจะแสดงขึ้น
- หลังจากแสดงข้อมูลล่าสุดท้ายแล้ว ให้กดปุ่ม ▼ เพื่อกลับไปยังหน้าจอแสดงค่าเฉลี่ยจากการวัดผลทั้งหมด
- กดปุ่ม **START** เพื่อปิดเครื่อง เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลา 1 นาที เครื่องจะปิดลงอัตโนมัติ

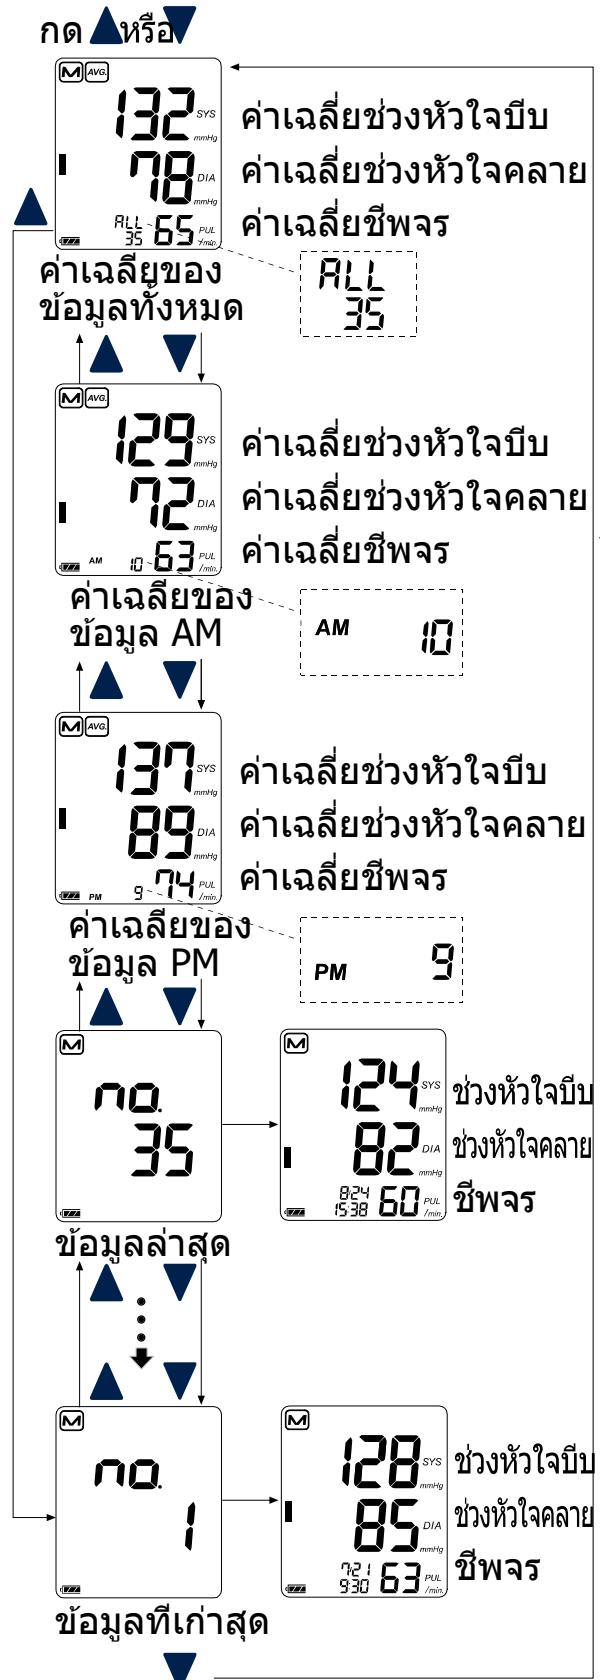

ตัวบ่งชี้ IHB/AFib คืออะไร

เมื่อมอนิเตอร์ตรวจจับจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอขณะวัดผล ตัวบ่งชี้ IHB/AFib จะปรากฏบนหน้าจอพร้อมค่าการวัดผล


หมายเหตุ: เราแนะนำให้ติดต่อหาแพทย์ของคุณหากพบเห็นสัญลักษณ์ «» ตัวบ่งชี้ IHB/AFib นี้บ่อยครั้ง

ตัวบ่งชี้ AFib คืออะไร

หัวใจหดตัวเนื่องจากสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในหัวใจแล้วส่งเลือดไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (AFib) เกิดขึ้นเมื่อสัญญาณไฟฟ้าในหัวใจห้องบนเกิดสับสนจนทำให้ชีพจรเบป่วน AFib สามารถทำให้เลือดซึ่งสักไหลอยู่ในหัวใจจนเกิดเป็นลิมเลือดได้ง่าย เป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ

แบบบ่งชี้ความดัน

แบบบ่งชี้คือการตรวจจับความคืบหน้าของความดันขณะวัดผล
เพิ่มแรงดัน → ปล่อยลม

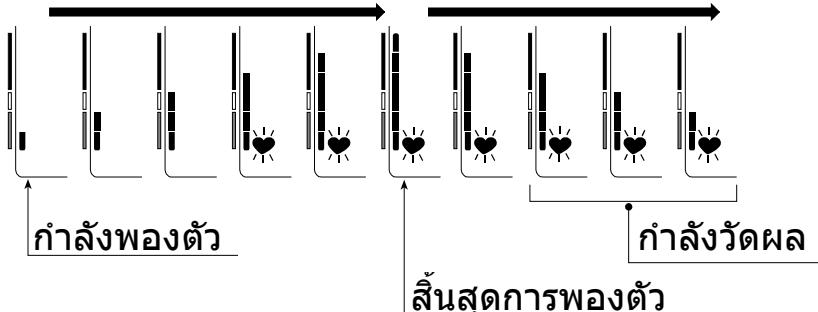

ตัวบ่งชี้การจำแนกของ WHO

แต่ละเช็กเมนต์ของแบบบ่งชี้สอดคล้องกับการจำแนกความดันโลหิตของ WHO โดยมีคำอธิบายในหน้าถัดไป

ตัวบ่งชี้การจำแนกของ WHO

- ─ ความดันสูงระดับที่ 3
- ─ ความดันสูงระดับที่ 2
- ─ ความดันสูงระดับที่ 1
- ─ ความดันเริ่มสูงกว่าปกติ
- ─ ความดันปกติ
- ─ ความดันเหมาะสม

■ : ตัวบ่งชี้แสดงเช็กเมนต์โดยอิงตามข้อมูลปัจจุบันที่สอดคล้องกับการจำแนกของ WHO

ตัวอย่าง:



ความดันสูงระดับที่ 2



ความดันสูงระดับที่ 1



ความดันเริ่มสูงกว่าปกติ

เกี่ยวกับความดันโลหิต

ความดันโลหิตคืออะไร

ความดันโลหิตเป็นแรงที่เลือดส่งออกมายังร่างกายผ่านหลอดเลือดแดง ความดันช่วงหัวใจบีบเกิดขึ้นเมื่อหัวใจหดตัว ความดันช่วงหัวใจคลายเกิดขึ้นเมื่อหัวใจขยายตัว ความดันโลหิตมีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรปอร์ต (mmHg) ความดันหลักที่วัดผลต่อน้ำซึ่งก่อให้เกิดการอุ่นหัวใจ ความดันโลหิตจะสูงขึ้นขณะที่บุคคลยังคงสูบบุหรี่และยังไม่ได้รับประทานอาหาร ถือเป็นความดันโลหิตตามธรรมชาติ

ความดันสูงคืออะไร และควบคุมได้อย่างไร

ความดันสูงคือความดันโลหิตภายในหลอดเลือดแดงที่อยู่ในระดับสูงผิดปกติ โดยหากไม่ได้รับการรักษา อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายประการ เช่น โรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ ความดันสูงสามารถควบคุมได้โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน หลีกเลี่ยงความเครียด และรับประทานยาภายใต้การดูแลของแพทย์

วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดความดันสูงหรือควบคุมระดับไว้มีดังนี้:

- ห้ามสูบบุหรี่
- ลดปริมาณแอลกอฮอล์และไขมันที่รับประทาน
- ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม
- ออกกำลังกายเป็นประจำ
- เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ


ทำไมจึงควรวัดความดันโลหิตที่บ้าน

การวัดความดันโลหิตที่คลินิกหรือห้องตรวจของหมอออาจสร้างความวิตกกังวลและสามารถส่งผลให้ค่าที่อ่านสูงขึ้นกว่าการวัดที่บ้านที่ $25 \text{ ถึง } 30 \text{ mmHg}$ การวัดผลที่บ้านช่วยลดผลกระทบจากอิทธิพลภายนอกในการอ่านค่าความดันโลหิต เสริมภัยคุกคามที่แพทย์อ่านได้ และบันทึกประวัติความดันโลหิตที่สมบูรณ์และแม่นยำกว่า

การจำแนกความดันโลหิตของ WHO

มาตรฐานการประเมินความดันโลหิตสูงโดยไม่คำนึงถึงอายุได้ตั้งขึ้นโดยองค์กรอนามัยโลก (WHO) ดังที่แสดงในแผนภูมิ

เอกสารอ้างอิง: Journal of Hypertension ประจำปี 1999 ฉบับที่ 17 เลขที่ 2

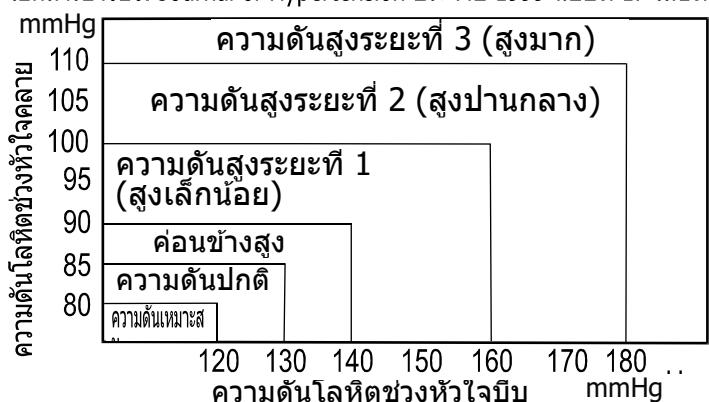


ความแปรผันของความดันโลหิต

ความดันโลหิตของบุคคลหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในแต่ละวันและแต่ละฤดูกาล ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ $30 \text{ ถึง } 50 \text{ mmHg}$

โดยขั้นอยู่กับเงื่อนไขหลายประการในระหว่างวัน ในผู้ป่วยความดันสูง ความแปรผันยังสังเกตได้ชัดยิ่งขึ้น โดยปกติแล้ว ความดันโลหิตจะสูงขึ้นขณะทำงานหรือร่วมเล่นในกิจกรรมต่าง ๆ และลดลงในระดับต่ำสุดขณะนอนหลับ ฉะนั้นแล้ว อย่าติงกังวลเกินไปกับการวัดผลเพียงหนึ่งครั้ง

วัดผล ณ เวลาเดิมทุกวันโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายในคู่มือนี้ เพื่อให้ทราบความดันโลหิตในระดับปกติของคุณ การอ่านค่าเป็นประจำจะช่วยให้ประวัติการวัดความดันโลหิตมีความครอบคลุมยิ่งขึ้น อย่าลืมบันทึกวันที่และเวลาเมื่อทำการบันทึกความดันโลหิตของคุณ ปรึกษาแพทย์เพื่อให้ติดความข้อมูลความดันโลหิตของคุณ

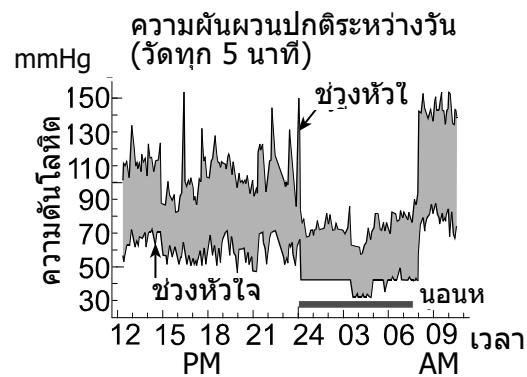

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	ข้อควรปฏิบัติ
ไม่มีข้อมูลใดปรากฏบนหน้าจอแม็ตตอนที่เปิดเครื่อง	แบตเตอรี่หมด ข้าวของถ่านอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง	ให้เปลี่ยนไปใช้ถ่านใหม่ทั้งหมด ใส่ถ่านอีกครั้งโดยจัดตำแหน่งข้าวของไว้ในช่องใส่ถ่าน
ผ้าพันแขนไม่พอดีตัวขึ้น	แรงดันแบบเตอร์ต่าเกินไป (เครื่องหมายแบตเตอรี่ต่า) หากแบตเตอรี่หมดโดยสมบูรณ์ เครื่องหมายจะไม่ปรากฏ	ให้เปลี่ยนไปใช้ถ่านใหม่ทั้งหมด
เครื่องไม่รับผลค่าที่อ่านได้สูงหรือต่ำกว่า	ใส่ผ้าพันแขนไม่ถูกต้อง	ใส่ผ้าพันแขนให้ถูกต้อง
	คุณขยายแขนหรือร่างกายขณะวัดผล	พยายามนั่งให้นิ่งและเงียบที่สุดขณะวัดผล
	ตำแหน่งผ้าพันแขนไม่ถูกต้อง	นั่งนิ่ง ๆ สบาย ๆ วางแผนของคุณบนโต๊ะ หงายฝ่ามือให้ผ้าพันแขนอยู่ระดับเดียวกับหัวใจ
	_____	หากคุณมีอัตราการเต้นของหัวใจอ่อนหรือไม่สม่ำเสมอ ตัวเครื่องอาจมีปัญหาในการหาค่าความดันโลหิตของคุณ
อื่น ๆ	ค่าที่ได้แตกต่างจากที่วัดผลที่คลินิกหรือสำนักงานของแพทย์	ดูที่ “ทำไมจึงควรวัดความดันโลหิตที่บ้าน”
	_____	แกะถ่านออก ใส่เข้าไปใหม่ให้ถูกต้องแล้วลองวัดผลอีกครั้ง

หมายเหตุ: หากข้อปฏิบัติข้างต้นไม่ได้แก้ปัญหา ให้ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย อย่าลองเปิดหรือซ่อมผลิตภัณฑ์นี้ เพราะการพยายามทำสิ่งดังกล่าวจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

การบำรุงรักษา

อย่าเปิดตัวเครื่อง เพราะใช้ชิ้นส่วนไฟฟ้าที่ละเอียดอ่อนและเครื่องควบคุมลมที่ซับซ้อนอาจเสียหายได้ หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาโดยใช้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตในห้องถินของคุณหรือฝ่ายบริการลูกค้าของเรา การบริการลูกค้าของ A&D จะให้ข้อมูลทางเทคนิค ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอะไหล่แก่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

ตัวเครื่องออกแบบและผลิตมาให้ใช้งานได้นาน แต่เราแนะนำให้นำเครื่องไปตรวจสอบทุก ๆ 2 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตในห้องถินของคุณหรือ A&D สำหรับการบำรุงรักษา

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	UA-1020
วิธีการวัดผล	การวัดผลแบบօอสซิลโลเมทริก
ช่วงการวัดผล	ความดัน: 0 - 299 mmHg ความดันช่วงหัวใจบีบ: 60 - 279 mmHg ความดันช่วงหัวใจคลาย: 40 - 200 mmHg ชีพจร: 40 - 180 ครั้ง/นาที
ความแม่นยำในการวัดผล	ความดัน: ± 3 mmHg ชีพจร: ± 5 %
ช่วงระดับ แหล่งจ่ายไฟ	DC 6V 3W ถ่าน 1.5 V 4 ก้อน (R6P, LR6 หรือ AA) หรือ อะแดปเตอร์ AC (TB-233C INPUT: AC 100 – 240V 50 / 60 Hz 0.15A) (ไม่รวม)
จำนวนการวัดผล	ประมาณ 1,000 ครั้ง เมื่อใช้ถ่านอัลคาไลน์ AA จนหมดและค่าความดันอยู่ที่ 180 mmHg ที่อุณหภูมิห้อง 23 องศาเซลเซียส
การจำแนก	อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ชั้นเคลื่อนภายใน (ใช้พลังงานจากถ่าน) / คลาส II (ใช้พลังงานจากอะแดปเตอร์) โหมดการทำงานต่อเนื่อง
การทดสอบทางคลินิก	เป็นไปตาม ISO81060-2 : 2013
EMD	ในการศึกษาเพื่อตรวจสอบทางคลินิก มีการใช้ K5 กับผู้ป่วย 85 รายเพื่อวิเคราะห์หาความดันโลหิต ช่วงหัวใจคลาย
หน่วยความจำ	IEC 60601-1-2: 2014 การวัดผล 90 ครั้งล่าสุด

เงื่อนไขการทำงาน	+10 ถึง +40 องศาเซลเซียส / 15 ถึง 85 %RH / 800 ถึง 1,060 เэкโตรัลป์กาล
การขนส่ง/สภาพการเก็บรักษา	-20 ถึง +60 องศาเซลเซียส / 10 ถึง 95 %RH / 700 ถึง 1,060 เэкโตรัลป์กาล
ขนาด	ประมาณ 140 [กว้าง] x 60 [สูง] x 105 [ลึก] มม.
น้ำหนัก	ประมาณ 285 ก. ไม่รวมถ่าน
ระดับการกันน้ำและกันฝุ่น	เครื่อง: IP20
ส่วนที่ใช้งาน	ผ้าพันแขนประเภท BF 
อายุการใช้งาน	เครื่อง: 5 ปี (เมื่อใช้ 6 ครั้งต่อวัน) ผ้าพันแขน: 2 ปี (เมื่อใช้ 6 ครั้งต่อวัน) อะแดปเตอร์ AC: 5 ปี (เมื่อใช้ 6 ครั้งต่อวัน)
อะแดปเตอร์ AC เสริม	อะแดปเตอร์ต้องเชื่อมต่อระหว่างมอนิเตอร์วัดค่าความดันโลหิตกับแหล่งพลังงานที่บ้าน
TB-233C	โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย A&D ในท้องถิ่นของคุณหากต้องการซื้อ คุณต้องตรวจสอบหรือเปลี่ยนอะแดปเตอร์ AC ใหม่เป็นระยะ ๆ
สัญลักษณ์ที่พิมพ์อยู่บนอะแดปเตอร์ AC	
 สัญลักษณ์	หน้าที่/ความหมาย
	สำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น
	อุปกรณ์คลาส II
	ฟิวส์ความร้อน
	ฟิวส์
	ฉลากผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งประชามติของ欧盟
	ฉลากผลิตภัณฑ์ที่ EAC รับรอง
	ข้าวของปลักจะแดปเตอร์ AC

อุปกรณ์เสริมจำหน่ายแยกต่างหาก

ผ้าพันแขน

หมายเลขแค็ตตาล็อก	ขนาดผ้าพันแขน	ขนาดแขน
CUF-D-LA-ISO	ผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่ขนาดใหญ่	31-45 ซม.
CUF-I-ISO	ผ้าพันแขนช่วงกว้าง	22-42 ซม.
CUF-D-MA-ISO	ผ้าพันแขนขนาดกึ่งใหญ่	23-37 ซม.
CUF-F-A-ISO	ผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่	22-32 ซม.
CUF-D-SA-ISO	ผ้าพันแขนขนาดเล็ก	16-24 ซม.
CUF-G-A-ISO	ผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่ SmoothFit	17-32 ซม.

อะแดปเตอร์ AC

หมายเลขแค็ตตาล็อก	ปลั๊ก (ประเภทปลั๊กไฟ)
TB-233C	ประเภท C

หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การจำแนก IP เป็นระดับการปกป้องอุปกรณ์ภายใต้มาตรฐาน IEC 60529
อุปกรณ์นี้ป้องกันวัตถุและกลบลอมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. ขึ้นไปได้
เช่น น้ำ อุปกรณ์นี้กันน้ำไม่ได้

บันทึก

Nội dung

Lời ngỎ.....	2
Chú thícH sơ bō	2
Lưu ý.....	2
Chống chỉ định.....	3
Mô tả thiết b̄i	4
Ký hiệu.....	5
Sử dụng thiết b̄i	7
Sử dụng thiết b̄i	8
Lắp đặt / thay pin	8
Nối ống hơi	9
Nối bộ chuyển đổi nguồn điện	9
Điều chỉnh đồng hồ	10
Chọn kích thước vòng bít chính xác.....	11
Đeo vòng bít chính xác	11
Cách thực hiện các phép đo chính xác	12
Tiến hành đo	12
Sau khi đo	12
Đo huyết áp	13
Đo bình thường.....	13
Đo với huyết áp với tâm thu mong muốn	14
Lưu ý để đo chính xác	15
Đo TriCheck™	15
Chọn Chế độ TriCheck™	15
Đo bằng cách sử dụng Chế độ TriCheck™	15
Xem lại dữ liệu bộ nhớ	17
Chỉ báo nhịp tim bất thường/Rung nhĩ IHB/AFib là gì?	18
Rung nhĩ là gì?	18
Chỉ báo thanh áp suất.....	18
Chỉ báo phân loại mức huyết áp theo WHO	18
Thông tin về bệnh Tăng huyết áp	19
Huyết áp là gì?.....	19
Tăng huyết áp là gì và được kiểm soát như thế nào?	19
Tại sao nên đo huyết áp tại nhà?	19
Phân loại huyết áp theo WHO	19
Sự thay đổi của huyết áp	19
Xử lý sự cố	20
Bảo trì	21
Thông số kỹ thuật	21

Lời ngỏ

Cảm ơn bạn đã mua và tin dùng Máy đo huyết áp A&D, đây là một trong những máy đo huyết áp hiện đại nhất hiện nay. Thiết bị được thiết kế dễ sử dụng và độ chính xác cao, máy đo huyết áp A&D sẽ hỗ trợ bạn theo dõi huyết áp hàng ngày.

Chúng tôi khuyến khích bạn nên đọc kỹ Hướng dẫn này trước khi dùng thiết bị lần đầu tiên.

Chú thích sơ bộ

- Thiết bị được thiết kế để sử dụng cho người lớn, không phải trẻ sơ sinh và trẻ em.
- Thiết bị được thiết kế để sử dụng ở môi trường trong nhà.
- Thiết bị này được thiết kế để đo huyết áp và nhịp tim dùng trong chẩn đoán

Lưu ý

- Các linh kiện của thiết bị đã được lắp ráp một cách chính xác. Tránh để thiết bị ở nơi nhiệt độ / độ ẩm cao, ánh nắng trực tiếp, bị va đập hoặc bám bụi.
- Làm sạch thiết bị và vòng bít bằng vải khô, vải mềm hoặc vải được làm ẩm bằng nước và xà phòng. Không được sử dụng cồn hoặc các hóa chất tẩy rửa mạnh để làm sạch thiết bị hoặc vòng bít.
- Tránh gấp chặt vòng bít và ống hơi trong thời gian dài. Điều này có thể làm giảm tuổi thọ của vòng bít và ống hơi.
- Không vặn ống hơi trong khi đo vì có thể làm bạn bị thương do áp lực lên vòng bít liên tục.
- Thiết bị và vòng bít không có khả năng chống nước. Cần ngăn mưa, mồ hôi và nước bắn vào thiết bị và vòng bít.
- Các phép đo có thể không chính xác nếu để thiết bị sử dụng gần TV, lò vi sóng, điện thoại di động, máy chụp X-Quang hoặc các thiết bị khác có điện trường mạnh.
- Thiết bị liên lạc không dây, chẳng hạn như thiết bị mạng gia đình, điện thoại di động, điện thoại không dây và trạm gốc của chúng, bộ đàm có thể ảnh hưởng đến máy đo huyết áp này. Do đó, nên giữ khoảng cách tối thiểu 30 cm từ các thiết bị đó.
- Thiết bị, các bộ phận và pin đã qua sử dụng không được xử lý như rác thải sinh hoạt thông thường mà phải được xử lý theo các quy định hiện hành của địa phương.
- Khi sử dụng bộ chuyển đổi nguồn điện AC, hãy đảm bảo rằng bộ chuyển đổi nguồn điện AC có thể dễ dàng tháo ra khỏi ổ cắm điện khi cần thiết.
- Đảm bảo thiết bị được giữ sạch trước khi sử dụng lần sau.


- Không tự ý sửa thiết bị. Điều này có thể gây thương tích hoặc hư hỏng thiết bị.
- Để đo huyết áp, cánh tay phải được siết đủ chặt bởi vòng bít đủ cứng để tạm ngừng lưu thông máu qua động mạch. Điều này có thể gây đau, tê hoặc hàn một vết đỏ tạm thời trên cánh tay. Tình trạng này sẽ xuất hiện nhiều hơn khi lặp lại phép đo nhiều lần liên tiếp. Mọi cảm giác đau, tê hay vết đỏ trên tay sẽ giảm dần theo thời gian.
- Đo huyết áp quá thường xuyên có thể gây hại do cản trở lưu lượng máu. Hãy kiểm tra với bác sĩ đảm bảo rằng sử dụng thiết bị nhiều lần không gây ảnh hưởng làm suy giảm lưu thông máu.
- Thủ nghiệm lâm sàng chưa được thực hiện ở trẻ sơ sinh và phụ nữ có thai. Không dùng cho trẻ sơ sinh hoặc phụ nữ có thai.
- Nếu bạn đã phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị.
- Không để trẻ em sử dụng thiết bị và không sử dụng thiết bị ở nơi trong tầm với của trẻ em vì có thể gây thương tích không mong muốn.
- Có những bộ phận nhỏ trong thiết bị có thể gây nguy cơ nghẹt thở nếu trẻ em nuốt nhầm.
- Không chạm vào pin, giắc cắm DC và người dùng cùng lúc vì có thể dẫn tới giật điện.
- Rút phích cắm bộ chuyển đổi nguồn điện AC khi không sử dụng.
- Sử dụng các phụ kiện không chi tiết trong hướng dẫn này có thể ảnh hưởng đến sự an toàn.
- Nếu pin bị đoán mạch, pin có thể bị nóng và có khả năng gây bong.
- Để thiết bị thích ứng với môi trường xung quanh trước khi sử dụng (khoảng 01 giờ).
- Không bơm hơi vòng bít mà không cuốn vòng bít quanh tay.

Chống chỉ định



Sau đây là các biện pháp phòng ngừa để sử dụng thiết bị đúng cách.

- Không đeo vòng bít trên cánh tay có gắn thiết bị y tế khác. Điều này dẫn tới thiết bị bị hoạt động không bình thường.
- Những người bị suy giảm tuần hoàn nặng ở cánh tay nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị, để tránh bị các vấn đề y tế nguy hiểm.
- Không nên tự chẩn đoán kết quả đo và tự bắt đầu điều trị, hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ để đánh giá kết quả và điều trị.
- Không đeo vòng bít trên cánh tay có vết thương chưa lành.
- Không đeo vòng bít trên cánh tay đang được truyền máu hoặc truyền nhỏ giọt tĩnh mạch. Điều này có thể gây ra thương tích.
- Không sử dụng thiết bị ở những nơi có khí dễ cháy như chất gây mêt. Điều này có thể dễ gây cháy nổ.
- Không sử dụng thiết bị trong môi trường ôxy đậm đặc, chẳng hạn như buồng oxy cao áp hoặc lều oxy. Điều này có thể dễ gây cháy nổ.


Mô tả thiết bị

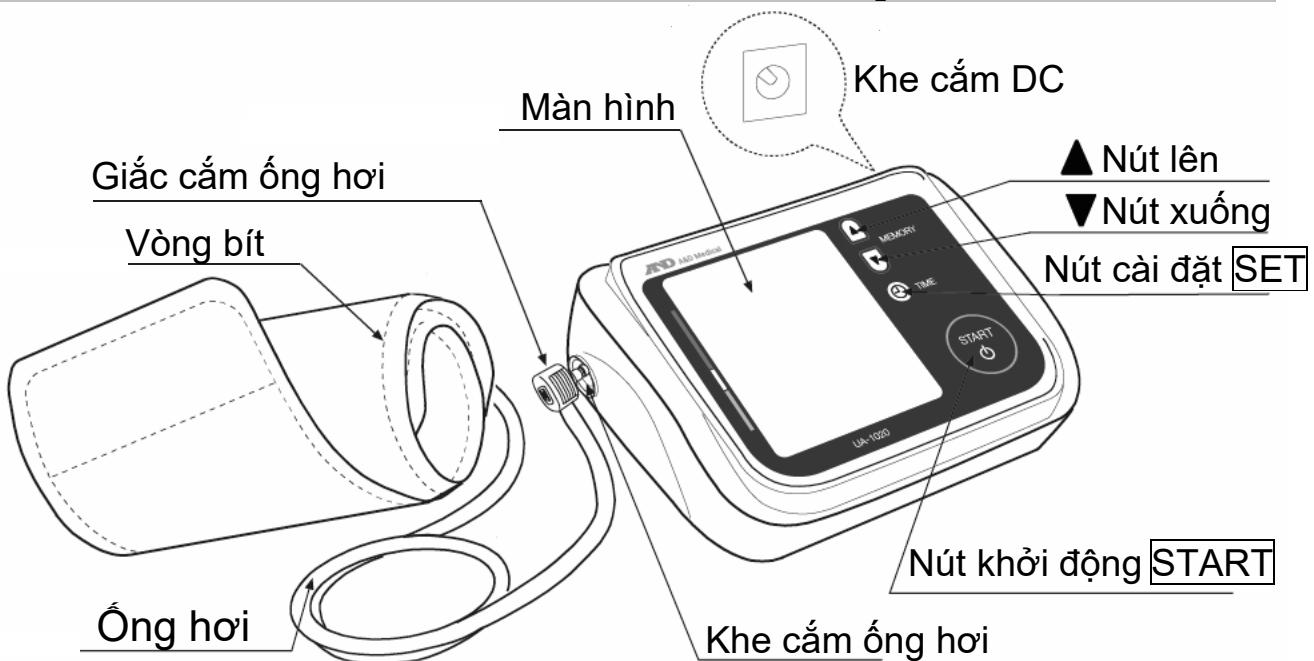

Ngăn chứa pin

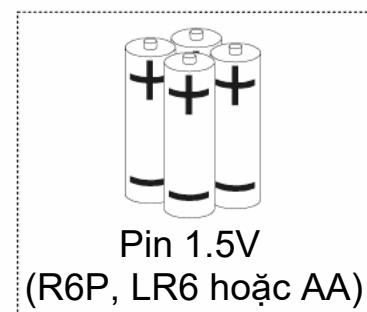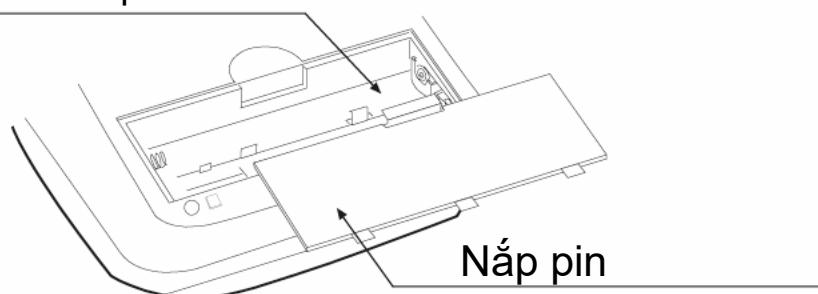

Màn hình

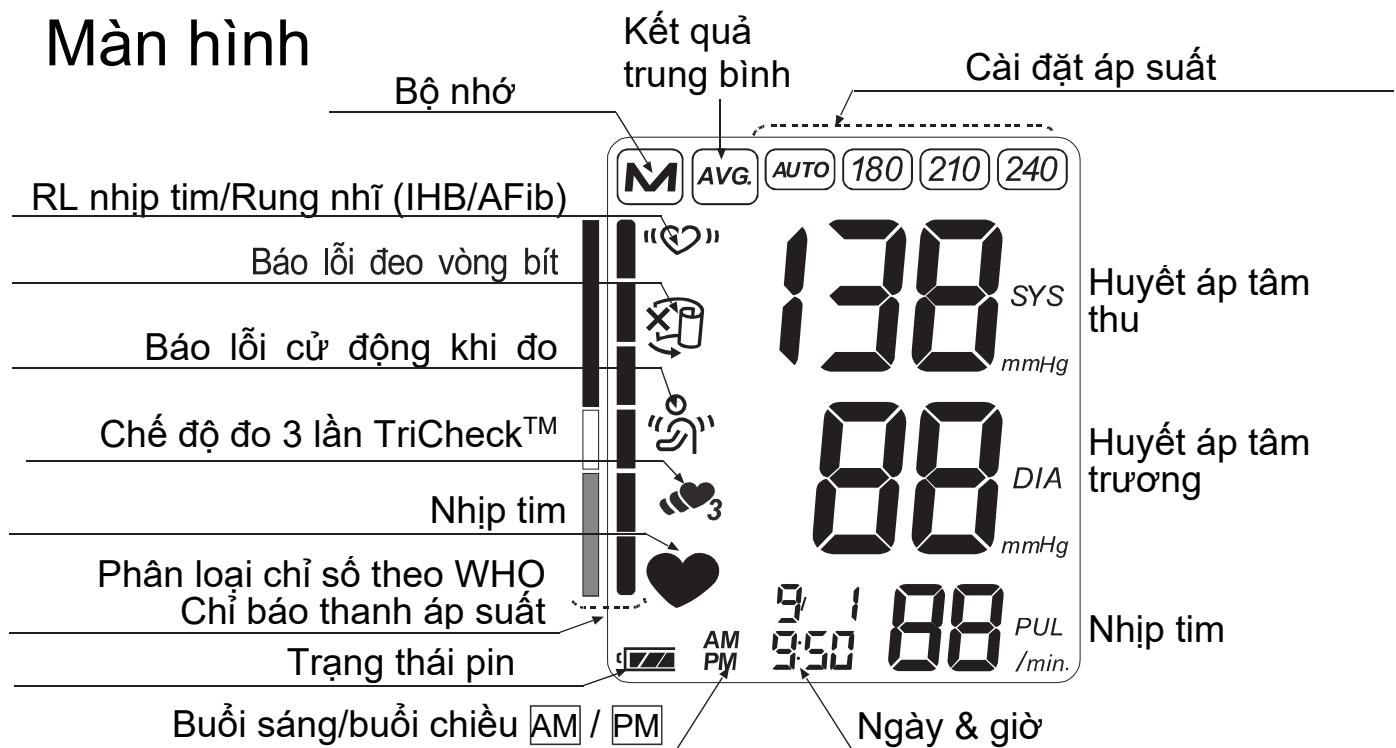

Ký hiệu

Ký hiệu được in trên vỏ thiết bị

Ký hiệu	Chức năng/ Ý nghĩa
	Chế độ chờ và Khởi động thiết bị
	Hướng dẫn lắp đặt pin
	Dòng điện một chiều
SN	Số sê-ri
	Nhà sản xuất
2020	Năm sản xuất
	Kiểu BF: vòng bít được thiết kế đặc biệt để bảo vệ chống sốc điện.
	Các thiết bị, phụ tùng và pin đã qua sử dụng không được coi là chất thải giá đình thông thường và phải được xử lý theo các quy định hiện hành của địa phương.
	Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng
	Cực tính của giắc cắm DC
IP	Biểu tượng bảo vệ quốc tế
	Giữ khô

Ký hiệu xuất hiện trên màn hình

Ký hiệu	Chức năng/ Ý nghĩa	Hành động được khuyến nghị
	Xuất hiện trong khi quá trình đo. Ký hiệu nhấp nháy khi phát hiện nhịp tim.	Thiết bị đang tiến hành đo. Giữ yên tư thế khi đo.
	Biểu tượng IHB/AFib. Xuất hiện khi phát hiện nhịp tim không đều. Biểu tượng sẽ sáng lên khi phát hiện thấy rung động nhẹ.	_____
	Chế độ TriCheck™ Tự động thực hiện ba lần đo liên tiếp và hiển thị giá trị trung bình của ba lần đo đó.	_____
	Xuất hiện khi phát hiện cử động của cơ thể hoặc cánh tay.	Kết quả của phép đo có thể không chính xác. Nên thực hiện một phép đo khác.
	Xuất hiện trong quá trình đo khi đeo vòng bít quá rộng/không chắc.	Kết quả của phép đo có thể không chính xác. Nên đeo lại vòng bít và đo lại.

Ký hiệu	Chức năng/ Ý nghĩa	Hành động được khuyến nghị
	Các kết quả được lưu trước đó.	_____
	Kết quả trung bình	_____
	PIN ĐẦY Trạng thái năng lượng của pin trong quá trình đo.	_____
	PIN YẾU Khi biểu tượng nhấp nháy là pin yếu.	Thay tất cả pin mới khi biểu tượng nhấp nháy.
	Huyết áp không ổn định do di chuyển trong quá trình đo. Giá trị tâm thu và tâm trương cách nhau 10 mmHg. Chỉ báo áp suất không tăng trong quá trình bơm hơi.	Thử đo lại. Vẫn đang trong quá trình đo. Đeo vòng bít một cách chính xác và thực hiện một phép đo khác.
	Vòng bít đeo không đúng cách..	
	LỖI HIỂN THỊ NHỊP TIM Nhịp tim không được đo chính xác.	
	Máy đo huyết áp báo lỗi bên trong	Tháo pin và nhấn nút START sau đó lắp lại pin. Nếu vẫn xuất hiện báo lỗi, hãy liên hệ với nhà cung cấp ở địa phương.
SYS	Huyết áp tâm thu tính bằng mmHg	_____
DIA	Huyết áp tâm trương tính bằng mmHg	_____
PUL	Nhịp tim mỗi phút	_____
AM	Xuất hiện khi kết quả trung bình được hiển thị Kết quả được đo từ 4:00 đến 9:59	_____
PM	Xuất hiện khi kết quả trung bình được hiển thị Kết quả được đo từ 18:00 đến 1:59	_____
	Chỉ báo áp suất Cho biết giá trị huyết áp do người dùng cài đặt trước đó.	_____

Sử dụng thiết bị

1. Đo bình thường

Nhấn nút **START**. Huyết áp được đo và dữ liệu được lưu trong bộ nhớ. Thiết bị này có thể lưu 90 phép đo gần nhất trong bộ nhớ.

2. Xem lại dữ liệu

Nhấn nút **▲** hoặc **▼** để xem lại kết quả đo trong bộ nhớ. Kết quả trung bình của tất cả các lần đo được hiển thị, như được chỉ ra trong hình bên phải.

Sau đó mỗi khi nút **▼** được nhấn, kết quả lưu trữ được hiển thị như sau:


Kết quả trung bình của tất cả các lần đo AM (buổi sáng) được thực hiện trong khoảng thời gian từ 4:00 đến 9:59.

Kết quả trung bình của tất cả các lần đo PM (buổi trưa/chiều/tối) được thực hiện trong khoảng thời gian từ 18:00 đến 1:59.

Kết quả gần đây nhất
(Lần thứ n, trong ví dụ là Lần thứ 35)


Kết quả gần nhất (Lần thứ 1)

Để biết chi tiết về cách xem lại bộ nhớ, hãy tham khảo phần “**Xem lại dữ liệu bộ nhớ**”.

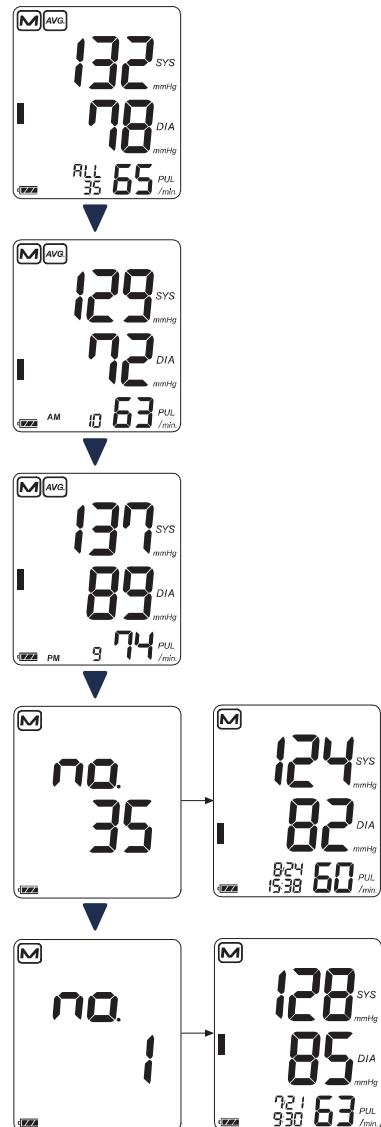

3. Xóa tất cả dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ

Ở chế độ chờ, nhấn đồng thời nút **▲** và **▼**. Dấu **M** và chỉ báo dấu pin xuất hiện. Nhấn và giữ cả hai nút **▲** và **▼** cho đến khi dấu **M** phát sáng bắt đầu nhấp nháy để xóa tất cả dữ liệu được lưu trong bộ nhớ.




4. Đo với Huyết áp tâm thu mong muốn

Tham khảo trang 14 để biết cách đo với huyết áp tâm thu mong muốn.

Sử dụng thiết bị

Lắp đặt / Thay pin

- Tháo nắp pin.
- Tháo pin đã sử dụng và lắp pin mới vào ngăn chứa pin như hình minh họa, chú ý lắp đúng các cực (+ và -) của pin.
Chỉ sử dụng pin R6P, LR6 hoặc AA.
- Đóng lại nắp pin.

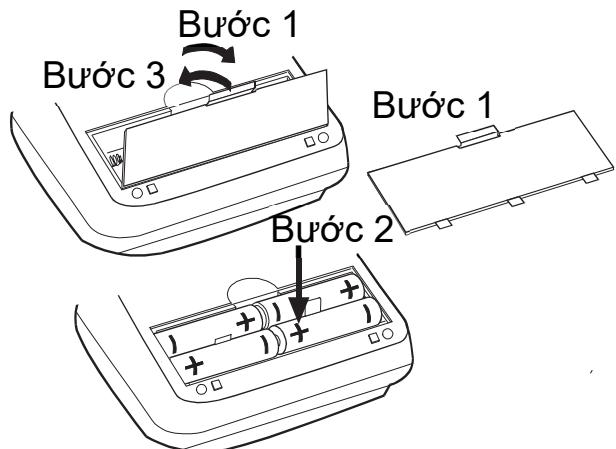


THÂN TRỌNG

- Lắp pin vào ngăn chứa pin như hình minh họa. Nếu lắp sai thiết bị sẽ không hoạt động.
- Khi biểu tượng (PIN YẾU) nhấp nháy trên màn hình, hãy thay tất cả pin bằng pin mới. Không nên dùng pin cũ chung với pin mới. Việc làm đó có thể rút ngắn tuổi thọ pin, hoặc làm cho thiết bị trục trặc.
Thay pin từ hai giây trở lên sau khi tắt thiết bị.
Nếu (PIN YẾU) xuất hiện ngay cả sau khi thay pin, hãy đo huyết áp. Sau đó, thiết bị có thể nhận ra pin mới.
- Biểu tượng (PIN YẾU) không xuất hiện khi hết pin.
- Tuổi thọ pin thay đổi theo nhiệt độ môi trường và có thể ngắn hơn ở nhiệt độ thấp. Nói chung, bốn viên pin LR6 mới sẽ dùng được khoảng ba tháng khi sử dụng hai lần mỗi ngày để đo.
- Chỉ sử dụng pin theo chỉ định. Pin được cung cấp cùng với thiết bị để kiểm tra hiệu suất của thiết bị và có thể có tuổi thọ hạn chế.
- Tháo pin ra nếu không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài.
Pin có thể bị rò rỉ và gây ra sự cố.

Sử dụng thiết bị

Kết nối ống hơi


Cắm giắc cắm ống hơi và khe cắm ống hơi thật chắc chắn.

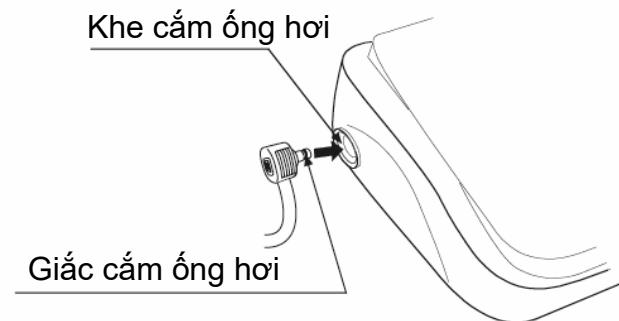

Kết nối bộ chuyển đổi nguồn điện AC

Lắp giắc cắm DC vào khe cắm DC

Tiếp theo, lắp bộ chuyển đổi nguồn điện AC vào ổ cắm điện.

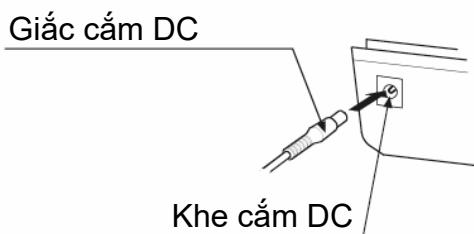

- Sử dụng bộ đổi nguồn điện AC được khuyến cáo.
(Tham khảo trang 22.)
- Khi ngắt kết nối bộ chuyển đổi nguồn điện AC ra khỏi ổ điện, hãy rút bộ chuyển đổi nguồn điện ra khỏi ổ cắm điện.
- Khi ngắt kết nối bộ chuyển đổi nguồn điện AC ra khỏi máy đo huyết áp, hãy rút giắc cắm DC ra khỏi khe cắm DC.

Sử dụng thiết bị

Điều chỉnh đồng hồ tích hợp

Điều chỉnh đồng hồ trước khi sử dụng.

1. Nhấn nút **SET** cho đến khi năm bắt đầu nhấp nháy.
2. Chọn năm sử dụng nút **▲** hoặc nút **▼**.
Nhấn nút **SET** để cài đặt năm hiện tại và chuyển sang lựa chọn tháng/ngày. Ngày có thể được cài đặt ở bất kỳ ngày nào trong khoảng từ năm 2010 đến năm 2059.
3. Chọn tháng bằng cách dùng nút **▲** hoặc **▼**.
Nhấn nút **SET** để cài đặt tháng hiện tại và chuyển sang chọn ngày.
4. Chọn ngày bằng cách dùng nút **▲** hoặc **▼**.
Nhấn nút **SET** để đặt ngày hiện tại và chuyển sang lựa chọn giờ/phút.
5. Chọn giờ bằng cách dùng nút **▲** hoặc **▼**.
Nhấn nút **SET** để cài đặt giờ hiện tại và chuyển sang lựa chọn phút.
6. Chọn phút bằng cách dùng nút **▲** hoặc **▼**.
(Nhấn nút **SET** để chuyển đến chế độ cài đặt áp suất. (Tham khảo trang 14.)
Nhấn nút **START** để tắt thiết bị.

Lưu ý: Sau ba phút không hoạt động, thiết bị sẽ tự động tắt.


Khi đồng hồ chưa được đặt, **- - / - -** màn hình đồng hồ hiển thị **- : - -** dấu gạch ngang như hình bên phải.

Khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, đồng hồ chưa được chỉnh.

Khi thiết bị bị ngắt kết nối khỏi nguồn điện trong hơn 30 giây, ngày, giờ và giá trị áp suất đã đặt sẽ bị xóa.

Khi ngày, giờ và giá trị áp suất đã cài đặt bị xóa, vui lòng điều chỉnh lại.

- ☐ Nhấn giữ nút **▲** hoặc **▼** sẽ thay đổi giá trị liên tục.

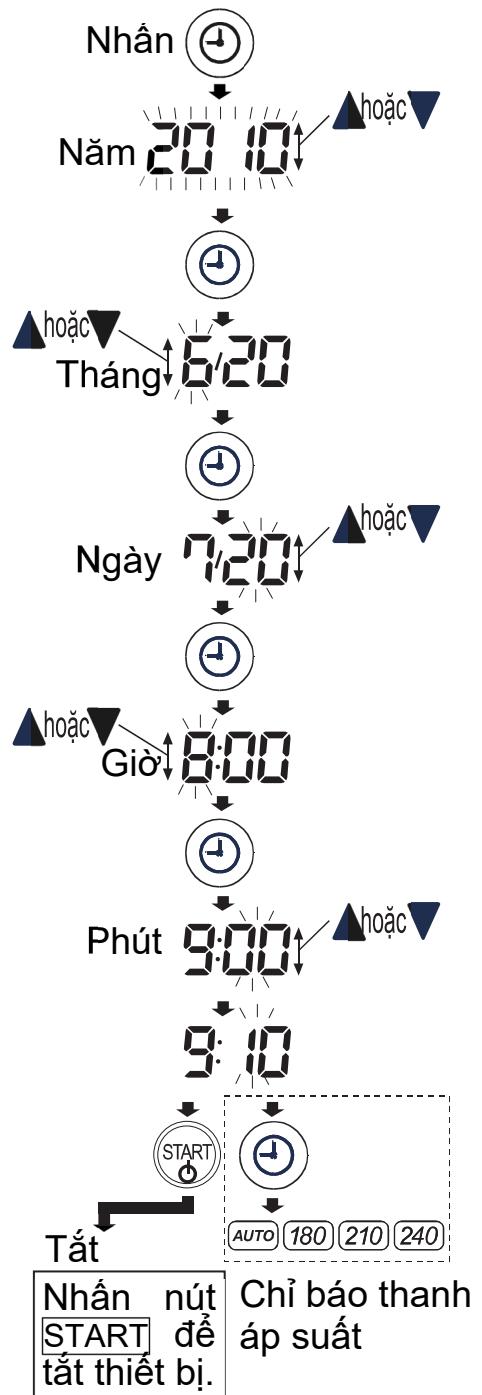

Tắt
Nhấn nút **START** để tắt thiết bị.
Chỉ báo thanh
áp suất

Sử dụng thiết bị

Chọn đúng kích thước vòng bít chính xác

Sử dụng đúng kích thước vòng bít rất quan trọng. Nếu vòng bít không có kích thước phù hợp có thể dẫn tới kết quả đo không chính xác.

- Kích thước cánh tay được in trên mỗi vòng bít.
- Vòng bít là một vật tư tiêu hao. Nếu bị hư hỏng, hãy mua một cái mới.

Kích cỡ cánh tay	Kích thước vòng bít khuyến nghị	Mã sản phẩm
31 cm đến 45 cm	Vòng bít người trưởng thành lớn	CUF-D-LA-ISO
22 cm đến 42 cm	Vòng bít có phạm vi phù hợp rộng	CUF-I-ISO
23 cm đến 37 cm	Vòng bít người trưởng thành trung bình	CUF-D-MA-ISO
22 cm đến 32 cm	Vòng bít tiêu người trưởng thành	CUF-F-A-ISO
16 cm đến 24 cm	Vòng bít nhỏ	CUF-D-SA-ISO
17 cm đến 32 cm	Vòng bít người trưởng thành SmoothFit	CUF-G-A-ISO

Kích cỡ cánh tay: Chu vi ở bắp tay.

Sử dụng vòng bít

1. Quấn vòng bít quanh bắp tay, cách mặt trong khuỷu tay khoảng 1 - 2cm như hình bên phải.
Đeo vòng bít trực tiếp ngoài da, vì quần áo có thể gây cản trở làm vòng bít cảm nhận mạch yếu và dẫn đến sai kết quả đo.
2. Nếu bạn cuộn chặt tay áo lên trên vòng bít có thể gây co thắt mạch, dẫn đến sai kết quả đo.



Ký hiệu được in trên vòng bít

Ký hiệu	Chức năng/Ý nghĩa	Hành động được khuyến nghị
●	Đánh dấu vị trí động mạch	Đặt dấu ● trên động mạch của cánh tay hoặc thẳng hàng với ngón tay đeo nhẫn
[REF]	Mã sản phẩm	_____
[LOT]	Số lô	_____
[Mfg]	Nhà sản xuất	_____
[MD]	Thiết bị y tế	_____

Sử dụng thiết bị

Cách thực hiện các phép đo chính xác

Để đo huyết áp chính xác nhất:

- Ngồi thoải mái trên ghế. Đặt cánh tay trên bàn. Không được bắt chéo chân Để bàn chân trên mặt phẳng sàn. Giữ thẳng lưng.
- Thư giãn trong khoảng 5 - 10 phút trước khi đo
- Đặt tâm của vòng bít ngang với tim.
- Giữ yên tư thế và im lặng khi đo.
- Không nên đo ngay sau khi tập thể dục hoặc tắm. Nghỉ ngơi trong khoảng 20 - 30 phút trước khi thực hiện đo huyết áp.
- Cố gắng đo huyết áp vào cùng một thời điểm mỗi ngày

Trong quá trình đo

Trong quá trình đo, việc cảm thấy vòng bít chặt là bình thường. (Không cần quá chú ý về điều đó).

Sau khi đo

Nhấn nút **START** để tắt thiết bị.

Tháo vòng bít và lưu trữ kết quả.

Lưu ý: Thiết bị được cung cấp chức năng tắt nguồn tự động, lưu trữ dữ liệu hiện tại trong bộ nhớ và tự động tắt thiết bị một phút sau khi đo.
Đo cách ít nhất ba phút giữa các lần đo trên cùng một người.


Đo huyết áp

Trước khi đo, hãy tham khảo “Lưu ý để đo chính xác” ở trang 15.

Đo bình thường

- Đeo vòng bít trên cánh tay (tốt nhất là cánh tay trái).
Ngồi yên lặng trong quá trình đo.
- Nhấn nút **START**.
Tắt cả các thông số màn hình sẽ hiển thị.
Xuất hiện số 0 nhấp nháy.
Màn hình sẽ thay đổi như hình bên phải và bắt đầu đo. Áp suất bắt đầu bơm vào vòng bít. Vòng bít sẽ siết chặt bắp tay, đây là điều bình thường. Thanh áp suất sẽ hiển thị phía bên trái màn hình trong suốt quá trình bơm hơi.
Lưu ý: Nếu bạn muốn ngừng bơm hơi bất cứ lúc nào hãy nhấn nút **START**.
- Sau khi hoàn thành quá trình bơm hơi, thiết bị sẽ tự động xả hơi. Khi đó biểu tượng  sẽ nhấp nháy, mỗi lần nhấp nháy tương ứng cho 1 nhịp tim.
Lưu ý: Nếu áp suất không đủ để đo huyết áp, quá trình bơm hơi sẽ tự động bơm lại. Để tránh trường hợp này, vui lòng tham khảo mục “Đo huyết áp với áp suất tâm thu mong muốn” ở trang tiếp theo.
- Khi quá trình đo hoàn thành, kết quả các chỉ số huyết áp tâm thu, tâm trương và nhịp tim/phút sẽ hiển thị trên màn hình.
Vòng bít được xả hơi hoàn toàn.
- Nhấn nút **START** để tắt thiết bị.
Sau một phút không hoạt động, thiết bị sẽ tự động tắt.

Lưu ý: Đo cách ít nhất 3 phút giữa các lần đo trên cùng một người.

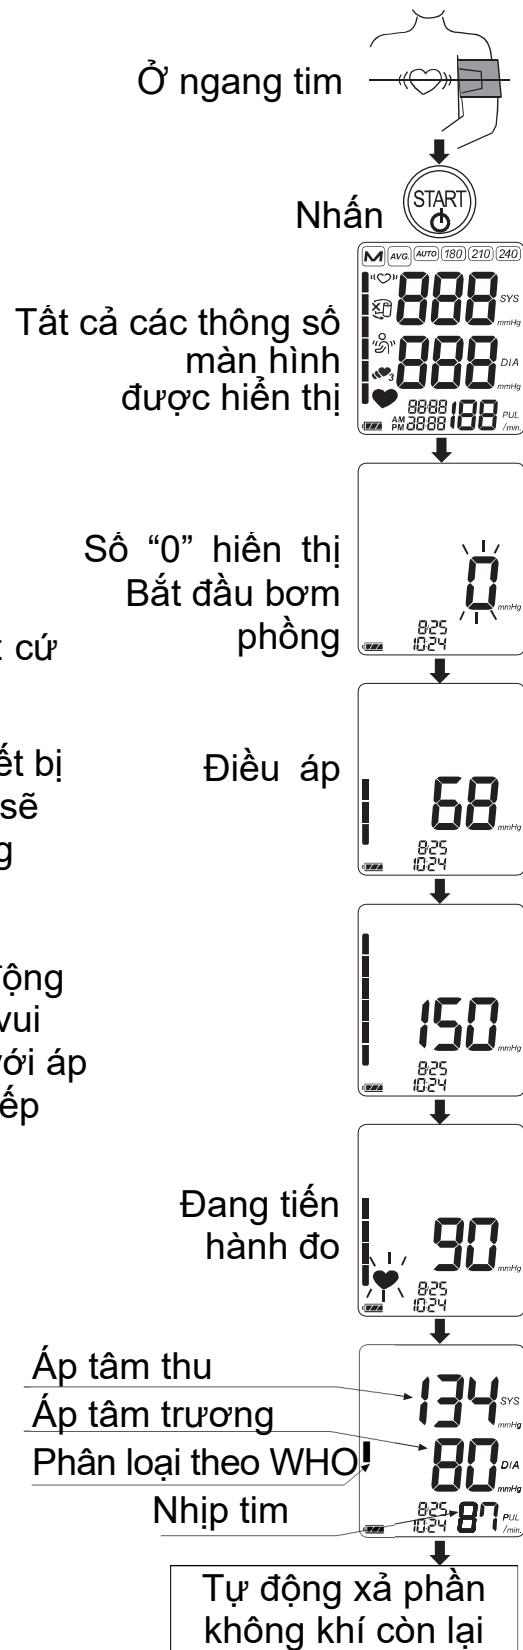

Đo huyết áp


Model UA-1020 được thiết kế để cảm biến mạch và bơm vòng bít đến mức áp suất tâm thu một cách tự động.

Áp dụng phương pháp này khi quá trình bơm lại từ đầu xảy ra nhiều lần hoặc khi áp suất giảm xuống dưới 20mgHg mà kết quả vẫn chưa hiển thị.

Đo với áp suất tâm thu mong muốn


Trong quá trình đo huyết áp, có thể xảy ra hiện tượng bơm phòng lại. Một huyết áp cố định có thể được thiết lập để tránh bị phòng lại.

- Tại bước 6 của quy trình điều chỉnh đồng hồ (tham khảo trang 10), nhấn **SET** để chuyển đến chế độ cài đặt huyết áp. Cài đặt hiện tại nhấp nháy.

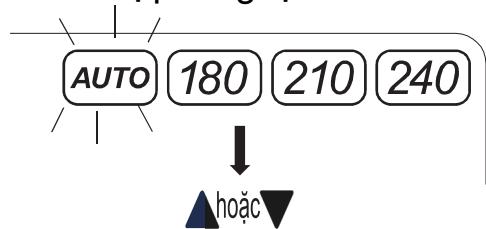

- Nhấn nút **▲** hoặc **▼** để chọn một giá trị áp suất cao hơn khoảng 30 mmHg hoặc cao hơn huyết áp tâm thu mong muốn của bạn từ các giá trị sau.


AUTO : Điều áp tự động (giá trị mặc định)
180 : Giá trị huyết áp là 180 mmHg (cố định)
210 : Giá trị huyết áp là 210 mmHg (cố định)
240 : Giá trị huyết áp là 240 mmHg (cố định)

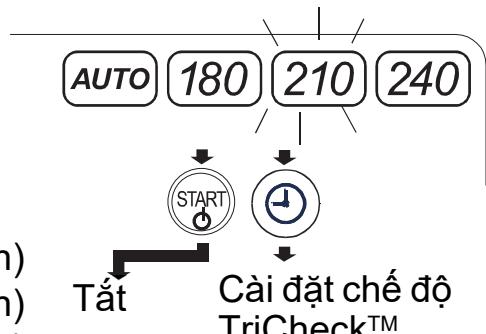

- Nhấn nút **SET** để chuyển đến chế độ cài đặt **TriCheck™**. Nhấn nút **START** để tắt thiết bị. Sau ba phút không hoạt động, thiết bị sẽ tự động tắt. Lần đo tiếp theo sẽ được thực hiện với giá trị huyết áp mới.

Đo với Huyết áp tâm thu mong muốn

Sử dụng phương pháp này khi xảy ra việc bị phòng lại nhiều lần ngay cả khi giá trị áp suất được cài đặt thành **240** ở quy trình phía trên hoặc khi kết quả không được hiển thị ngay cả khi áp suất giảm xuống 20 mmHg hoặc thấp hơn.



- Đeo vòng bít trên cánh tay (tốt nhất là cánh tay trái).
- Nhấn và giữ nút **START** cho đến khi áp suất cao hơn huyết áp tâm thu mong muốn từ 30 đến 40 mmHg.
- Khi đạt được áp suất mong muốn, hãy thả nút **START** để bắt đầu đo. Sau đó tiếp tục đo huyết áp của bạn như mô tả trong trang trước.



Lưu ý để đo chính xác

- Ngồi thoải mái trên ghế. Đặt cánh tay trên bàn với lòng bàn tay hướng lên trên và tay vòng bít ngang với tim.
- Thư giãn khoảng 5 - 10 phút trước khi đo. Nếu bạn đang trong trạng thái kích thích hoặc trầm cảm do căng thẳng, kết quả đo sẽ cao hơn (hoặc thấp hơn) so với chỉ số huyết áp bình thường và nhịp tim sẽ nhanh hơn.
- Huyết áp của một người sẽ luôn thay đổi, chỉ số huyết áp còn phụ thuộc vào hoạt động và đồ ăn của bạn. Đồ uống bạn sử dụng có thể nhanh chóng tác động mạnh mẽ đến chỉ số huyết áp.
- Phương pháp đo của thiết bị dựa trên nhịp tim. Nếu nhịp tim của bạn quá yếu hoặc không đều, thiết bị có thể gặp khó khăn trong việc xác định huyết áp của bạn.
- Nếu thiết bị phát hiện tình trạng bất thường, thiết bị sẽ dừng phép đo và hiển thị ký hiệu lỗi. Tham khảo trang 6 để biết mô tả về các ký hiệu.
- Thiết bị được thiết kế để sử dụng cho người lớn. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị này cho trẻ em. Khi sử dụng cho trẻ em phải có người giám sát.
- Hiệu suất hoạt động của máy đo huyết áp tự động có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện nhiệt độ, độ ẩm và độ cao quá mức.

Đo TriCheck™


Chế độ TriCheck™ tự động thực hiện ba lần đo liên tiếp và hiển thị kết quả trung bình của ba lần đo đó.

Chọn Chế độ TriCheck™

1. Trong chế độ cài đặt áp suất, nhấn nút **SET** để vào chế độ cài đặt TriCheck™. Cài đặt hiện tại nhấp nháy.
2. Nhấn nút **▲** hoặc **BẮT ĐẦU ▼** để tắt Chế độ TriCheck™ BẮT HOẶC TẮT. **BẮT:** Chế độ TriCheck™ **TẮT:** Chế độ đo bình thường (giá trị mặc định)
3. Nhấn nút **START** hoặc **SET** để tắt thiết bị. Sau ba phút không hoạt động, thiết bị sẽ tự động tắt.

Trong chế độ cài đặt áp suất,


Nhấn



Cài đặt hiện tại nhấp nháy

▲ hoặc **▼**

Thay đổi cài đặt




Đo bằng cách sử dụng Chế độ TriCheck™

- Nhấn nút **START**.
Tất cả các thông số màn hình được hiển thị.
Số không (0) được hiển thị nhấp nháy trong thời gian ngắn và phép đo đầu tiên bắt đầu.
- Khi hoàn thành đo, việc đọc áp suất tâm thu và tâm trương cũng như nhịp tim sẽ được hiển thị, sau đó thiết bị đếm ngược một phút bắt đầu cho phép đo thứ hai.
- Sau một phút, đo lần hai bắt đầu.
- Khi quá trình đo hoàn tất, giá trị trung bình của đo thứ nhất và thứ hai được hiển thị, sau đó bắt đầu đếm ngược một phút cho đo lần ba.
- Sau một phút, đo lần ba bắt đầu.
- Khi quá trình đo hoàn tất, giá trị trung bình của ba lần đo được hiển thị và lưu trong bộ nhớ.

Lưu ý:

- Trong quá trình đo, Ký hiệu TriCheck™ được hiển thị.
- Để hủy lần đo, nhấn nút **START**.
Trong trường hợp này, không có dữ liệu nào được lưu trữ trong bộ nhớ.
- Khi biểu tượng lỗi đeo vòng bít xuất hiện trong lần đo đầu tiên, hãy hủy lần đo, dán lại vòng bít cho đúng và bắt đầu lần phép đo mới.
- Sau khi đo, dữ liệu trung bình của ba phép đo được lưu trong bộ nhớ.
Không có dữ liệu nào được lưu trữ, khi hủy bỏ các lần đo, trước khi hoàn thành lần đo thứ ba.

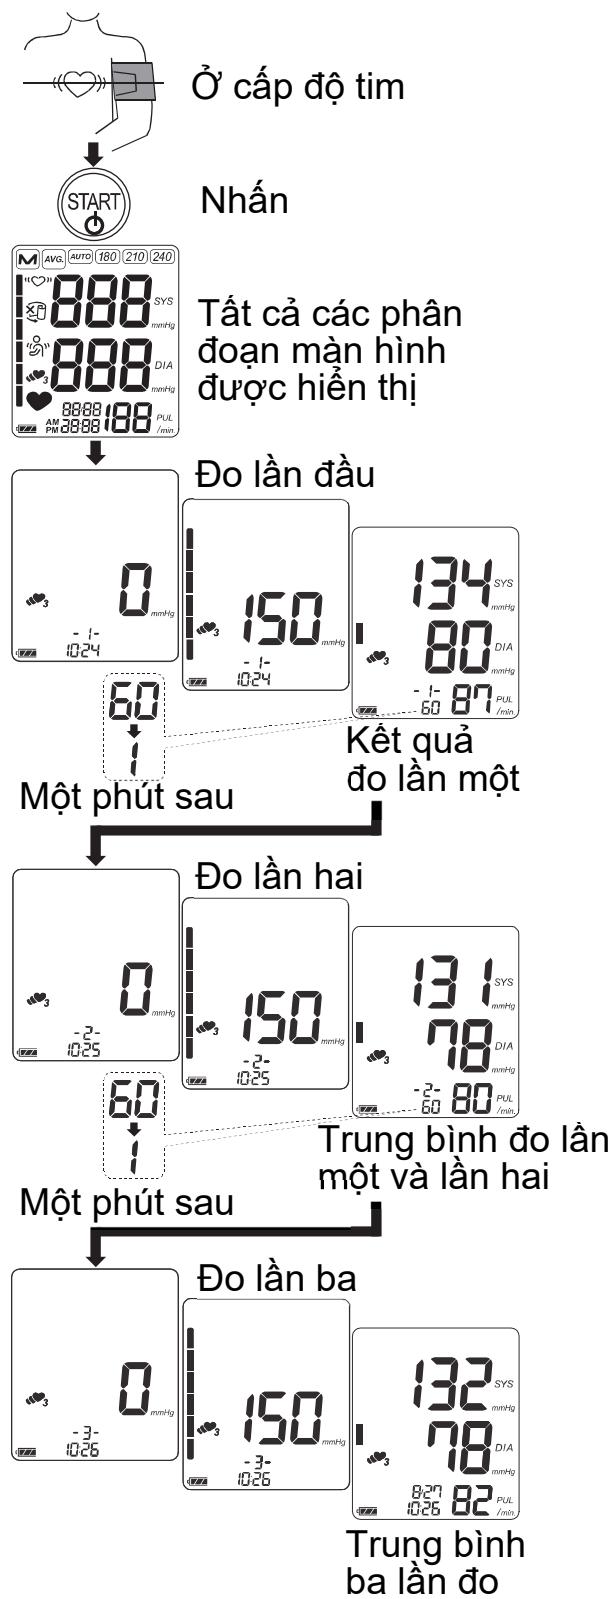

Xem lại dữ liệu bộ nhớ

Lưu ý: Thiết bị này lưu trữ 90 lần đo cuối cùng trong bộ nhớ.

- Nhấn nút **▲** hoặc nút **▼**.
Màn hình sẽ hiển thị kết quả trung bình của tất cả các lần đo
(Nếu không có dữ liệu, thì số “0” sẽ hiển thị. Nhấn nút **▲**, **▼** hoặc **START** để tắt thiết bị.)
- Mỗi lần nhấn nút **▼** (hoặc nút **▲** để hiển thị dữ liệu theo thứ tự ngược lại), dữ liệu bộ nhớ sẽ hiển thị như sau:


Kết quả trung bình của tất cả các lần đo AM (buổi sáng) được thực hiện trong khoảng thời gian từ 4:00 đến 9:59.
(Trong ví dụ là 10 lần đo. Nếu không có dữ liệu thì dấu “--” được hiển thị)

↓
Kết quả trung bình của tất cả các lần đo PM (buổi trưa/chiều/tối) được thực hiện trong khoảng thời gian từ 18:00 đến 1:59.
(Trong ví dụ là 9 lần đo. Nếu không có dữ liệu thì dấu “--” được hiển thị)

↓
Kết quả gần đây nhất (Lần thứ n, trong ví dụ là Lần thứ 35)
Số thứ tự hiển thị 3 giây, sau đó kết quả đo được hiển thị.

⋮

↓
Kết quả xa nhất (Lần thứ 1)
Số thứ tự hiển thị 3 giây, sau đó kết quả đo được hiển thị.
- Sau khi kết cuối cùng được hiển thị, nhấn nút **▼** để trả về hiển thị trung bình của tất cả các lần đo.
- Nhấn nút **START** để tắt thiết bị.
Sau một phút không hoạt động, thiết bị sẽ tự động tắt.

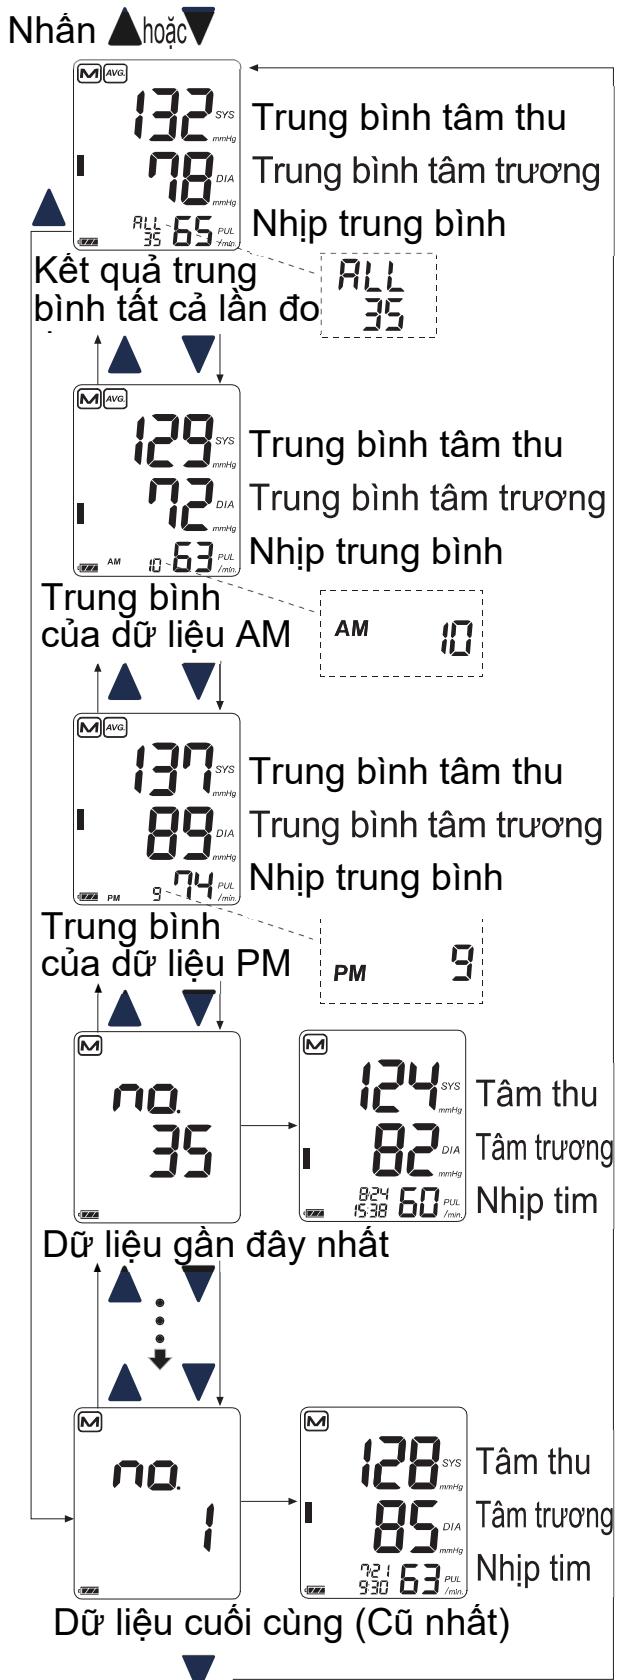

Chỉ báo Nhịp tim bất thường/Rung nhĩ (IHB/AFib) là gì?

Khi thiết bị phát hiện nhịp tim bất thường trong quá trình đo, chỉ báo nhịp tim bất thường/Rung nhĩ (IHB/AFib) sẽ xuất hiện trên màn hình cùng kết quả đo.


Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với bác sĩ nếu bạn thấy ký hiệu IHB/AFib (❤️) xuất hiện thường xuyên.

AFib là gì?

Tim co bóp do các xung điện bên trong tim và từ đó đưa máu đi khắp cơ thể. Rung nhĩ (AFib) xảy ra khi xung điện trong tâm nhĩ hoạt động không bình thường, sẽ dẫn đến co bóp của tim bị rối loạn. Rung nhĩ (AFib) có thể khiến máu trong tim bị ứ, dễ tạo thành các cục máu đông, gây ra đột quỵ và nhồi máu cơ tim

Chỉ báo thanh áp suất

Chỉ báo theo dõi tiến trình của áp suất trong quá trình đo.

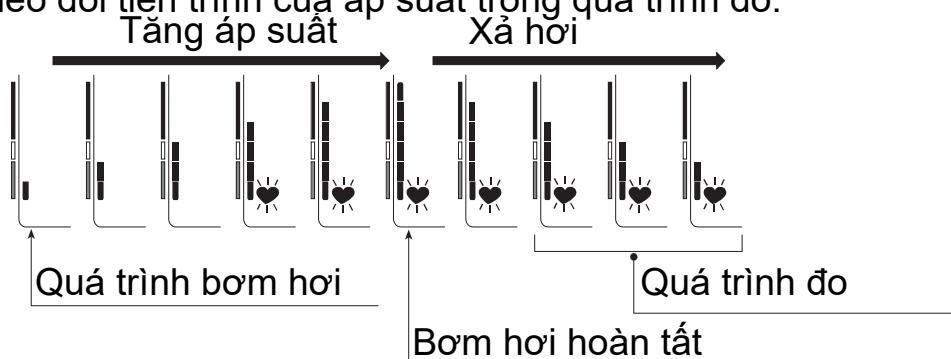

Phân loại mức huyết áp theo WHO

Mỗi đoạn vạch tương ứng với phân loại huyết áp theo chuẩn WHO (được mô tả ở trang sau).

Phân loại huyết áp theo WHO

- Tăng huyết áp nặng (độ 3)
- Tăng huyết áp trung bình (độ 2)
- Tăng huyết áp nhẹ (độ 1)
- Bình thường cao
- Bình thường
- Tối ưu

- : Chỉ mục hiển thị 1 đoạn vạch, dựa trên kết quả đo hiện tại, tương ứng với phân loại theo WHO.

Ví dụ:



Tăng huyết áp trung bình



Tăng huyết áp nhẹ



Bình thường cao

Tăng huyết áp

Huyết áp là gì?

Huyết áp là áp lực máu tác động lên thành động mạch. Huyết áp tâm thu xảy ra khi tim co bóp. Huyết áp tâm trương xảy ra khi tim giãn ra. Huyết áp được đo bằng milimét thủy ngân (mmHg). Huyết áp tự nhiên của một người được được đo lần đầu tiên vào buổi sáng, khi cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi và trước khi ăn.

Tăng huyết áp là gì và kiểm soát như thế nào?

Tăng huyết áp là hiện tượng áp suất máu ở động mạch tăng cao bất thường, nếu không được kiểm soát sẽ gây ra những ảnh hưởng lớn đến sức khỏe như đột quỵ và đau tim. Tăng huyết áp có thể được kiểm soát bằng cách thay đổi lối sống, tránh căng thẳng và dùng thuốc dưới sự giám sát của bác sĩ.

Để ngăn ngừa tăng và kiểm soát bệnh cao huyết áp.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Không hút thuốc | <input type="checkbox"/> Tập thể dục thường xuyên |
| <input type="checkbox"/> Giảm muối và chất béo | <input type="checkbox"/> Kiểm tra sức khỏe thường xuyên |
| <input type="checkbox"/> Duy trì cân nặng thích hợp | |


Tại sao nên đo huyết áp tại nhà?

Huyết áp đo tại phòng khám hoặc bệnh viện có thể cao hơn 25 - 30 mmHg so với ở nhà do bạn bị lo lắng. Đo huyết áp tại nhà có thể tránh được những tác động bên ngoài lên kết quả đo, bổ sung cùng kết quả đo của bác sĩ sẽ có thông tin về huyết áp chính xác, đầy đủ hơn.

Phân loại huyết áp theo WHO

Những tiêu chuẩn để đánh giá bệnh tăng huyết áp, không tính đến tuổi tác, đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xây dựng như ở biểu

Tài liệu tham khảo: Tạp chí tăng huyết áp năm 1999, tập 17 số 2

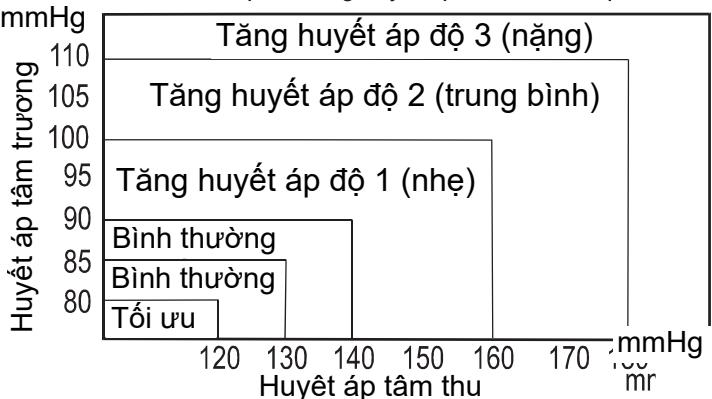


Biến đổi huyết áp

Huyết áp của một người thay đổi rất nhiều theo ngày hoặc theo mùa. Trong một ngày, ở các thời điểm và điều kiện

khác nhau thì huyết áp có thể thay đổi dao động từ 30-50mmHg. Ở những người bị tăng huyết áp thì sự thay đổi của huyết áp sẽ rõ ràng hơn. Thông thường, huyết áp sẽ tăng khi làm việc hoặc vận động và giảm xuống mức thấp nhất khi ngủ. Vì vậy bạn không nên quá lo lắng về một kết quả đo.

Hãy thực hiện đo huyết áp vào cùng 1 thời điểm trong ngày theo hướng dẫn sử dụng để biết được huyết áp bình thường của bạn. Các kết quả đo hàng ngày sẽ phản ánh chỉ số huyết áp của bạn toàn diện hơn. Hãy lưu lại kết quả đo của bạn cùng thông tin ngày và giờ. Tham khảo ý kiến bác sĩ để được giải thích về chỉ số huyết áp

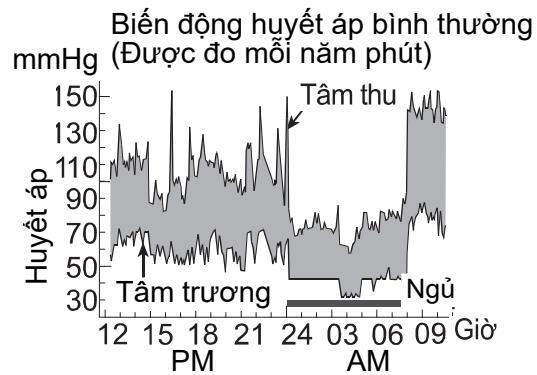

Xử lý sự cố

Vấn đề	Lý do có thể gây ra	Hành động được khuyên
Không có gì xuất hiện trên màn hình, ngay cả khi thiết bị được bật.	Hết pin Các cực pin không được lắp đúng vị trí.	Thay tất cả pin bằng pin mới Lắp lại pin với các cực âm (-) và cực dương (+) phù hợp với các đầu nối được chỉ dẫn trên ngăn chứa pin.
Vòng bít không được bơm hơi.	Điện áp pin quá thấp. PIN YẾU nháy. Nếu hết pin, ký hiệu này sẽ không xuất hiện.	Thay tất cả pin bằng pin mới
Thiết bị không đo ra kết quả. Kết quả quá cao hoặc quá thấp.	Vòng bít không được đeo đúng cách. Bạn đã di chuyển cơ thể hoặc cánh tay khi đo. Vị trí đeo vòng bít không đúng.	Đeo vòng bít một cách chính xác. Đảm bảo giữ yên tư thế và im lặng trong khi đo. Ngồi thoải mái và yên lặng. Đặt cánh tay lên bàn và lòng bàn hướng lên trên và tâm vòng bít ngang với tim.
Khác	Kết quả đo khác với kết quả được đo tại phòng khám/bệnh viện.	Nếu bạn có nhịp tim quá yếu hoặc không đều, thiết bị có thể gặp khó khăn trong việc xác định huyết áp của bạn
		Tham khảo “Tại sao nên đo huyết áp tại nhà?”. Tháo pin. Lắp lại pin đúng cách và thử đo lại.

Lưu ý: Nếu các hành động được mô tả ở trên không giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ với nhà phân phối tại địa phương. Không được tự ý sửa thiết bị vì như vậy sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.

Bảo trì

Thiết bị bao gồm những linh kiện điện tử tinh xảo và bộ phận không khí phức tạp. Vì vậy không được tháo mở thiết bị vì có thể dẫn tới hư hỏng. Nếu bạn gặp phải sự cố và không thể khắc phục bằng hướng dẫn sử dụng, hãy liên hệ với nhà phân phối độc quyền tại địa phương để được bảo hành bằng những linh kiện chính hãng.

Thiết bị được thiết kế và sản xuất có tuổi thọ sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, nên kiểm tra thiết bị thường xuyên 2 năm/lần để đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường và chính xác. Hãy liên hệ với nhà phân phối độc quyền tại địa phương để được bảo trì chính hãng.

Thông số kỹ thuật

Kiểu	UA-1020
Phương pháp đo	Đo dao động
Phạm vi đo	Huyết áp: 0 - 299 mmHg Áp tâm thu: 60 - 279 mmHg Áp tâm trương: 40 - 200 mmHg Nhịp tim: 40 - 180 nhịp / phút
Độ chính xác	Áp suất: ± 3 mmHg Nhịp tim: ± 5 %
Nguồn điện	DC 6 V 3W
Nguồn pin	4 x pin 1,5 V (R6P, LR6 hoặc AA) hoặc Bộ sạc xoay chiều (TB-233C INPUT: AC 100 – 240 V 50 / 60 Hz 0.15A) (Không bao gồm)
Số lần đo	Khoảng 1000 lần đo, khi sử dụng Pin kiềm AA, với giá trị huyết áp là 180 mmHg ở nhiệt độ phòng 23°C.
Phân loại	Thiết bị ME được cấp nguồn bên trong (cung cấp bằng pin) / Loại II (Cung cấp bằng bộ chuyển đổi nguồn điện AC). Chế độ hoạt động liên tục
Xét nghiệm lâm sàng	Theo ISO81060-2 : 2013 Trong nghiên cứu độ tin cậy lâm sàng này, K5 đã được sử dụng trên 85 đối tượng để xác định huyết áp tâm trương.
EMD	IEC 60601-1-2: 2014
Bộ nhớ	Lưu lại 90 lần đo cuối

Điều kiện hoạt động	10 đến +40 °C / 15 đến 85 %RH / 800 đến 1060 hPa
Điều kiện vận chuyển/ lưu trữ	-20 đến +60 °C / 10 đến 95 %RH / 700 đến 1060 hPa
Kích thước	Khoảng 140 [R] x 60 [C] x 105 [D] mm
Trọng lượng	Khoảng 285 g, không bao gồm pin
Bảo vệ chống xâm nhập	Thiết bị: IP20
Phần áp dụng	Kiểu vòng bít BF 
Vòng đời	Thiết bị: 5 năm (khi sử dụng sáu lần một ngày) vòng bít: 2 năm (khi sử dụng sáu lần một ngày) Bộ chuyển đổi nguồn điện AC: 5 năm (khi sử dụng sáu lần một ngày)

Bộ chuyển đổi nguồn điện AC dùng để kết nối máy đo huyết áp với nguồn điện ở nhà.

Vui lòng liên hệ với đại lý A&D tại địa phương để mua bộ chuyển đổi nguồn điện AC này.

Bộ chuyển đổi nguồn điện AC được yêu cầu phải được kiểm tra hoặc thay thế định kỳ.

Các biểu tượng được in trên bộ chuyển đổi nguồn điện AC

Ký hiệu	Chức năng/ Ý nghĩa
	Chỉ sử dụng trong nhà
	Cách điện 2 lớp
	Cầu chì nhiệt
	Cầu chì
	Nhãn thiết bị chỉ hướng EC
	Nhãn thiết bị chứng nhận EAC
	Cực của phích cắm bộ chuyển đổi nguồn điện AC

Phụ kiện bán riêng
Vòng bít

Mã sản phẩm	Kích thước vòng bít	Kích thước cánh tay
CUF-D-LA-ISO	Vòng vít người trưởng thành lớn	31 cm đến 45 cm
CUF-I-ISO	Vòng bít có phạm vi phù hợp rộng	22 cm đến 42 cm
CUF-D-MA-ISO	Vòng bít lớn trung bình	23 cm đến 37 cm
CUF-F-A-ISO	Vòng bít người trưởng thành	22 cm đến 32 cm
CUF-D-SA -ISO	Vòng bít nhỏ	16 cm đến 24 cm
CUF-G-A-ISO	Vòng bít người trưởng thành SmoothFit	17 cm đến 32 cm

Bô chuyển đổi nguồn điện AC

Mã sản phẩm	Loại đầu cắm
TB-233C	Loại C

Lưu ý: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Phân loại chỉ báo IP là mức độ bảo vệ được cung cấp bởi lớp vỏ máy bảo vệ theo tiêu chuẩn IEC 60529. Thiết bị này được bảo vệ để chống lại những vật thể lạ dạng rắn có đường kính 12 mm trở lên ví dụ như ngón tay. Thiết bị này không được bảo vệ chống lại nước.

MEMO

មាតិកា

ស្ថិស្ថានចំពោះអតិថិជនជាទីគោរ	3
កំណត់សម្ងាត់ដំបូង	3
ប្រុងប្រយ័ត្ន	3
ការណែនាំផ្សេងៗ	5
កំណត់អតិថិជនជាទីក	6
និមិត្តសញ្ញា	7
រៀបចំប្រតិបត្តិការ	9
1. ការវាស់ចម្លាត	9
2. ការរំលើកទិន្នន័យអង្គចងចាំ	9
3. ការលុបទិន្នន័យទាំងអស់ដែលមួកកុងអង្គចងចាំ	9
4. ការវាស់ដែងជាមួយនឹងសម្ងាត់សុស្សិតិកដែលចង់បាន	9
ការប្រើមួយីទេរ	10
ការដំឡើង / ការផ្តាស់ប្តូរមួយ	10
ការប្រើមួយីទេរ	11
ការភ្លាប់បំពង់ខ្សោយ	11
ការភ្លាប់អាមេរិក AC	11
ការប្រើមួយីទេរ	12
ការផែតម្រោនទិន្នន័យការនៅខាងក្រោម	12
ការប្រើមួយីទេរ	13
ការធ្វើសិសទំហំប្រជាប់រុងដែលត្រូវបានប្រើបាយ	13
រៀបចំជាក់ប្រជាប់រុង	13
ការប្រើមួយីទេរ	15
រៀបចំប្រើការវាស់ត្រូវបានប្រើបាយ	15
ការវាស់	15
បន្ទាប់ពីការវាស់	15
ការវាស់	16
ការវាស់ចម្លាត	16
ការវាស់	17
ការវាស់ដោយប្រើសម្ងាត់ដែលបានកំណត់	17
ការវាស់ដែងជាមួយនឹងសម្ងាត់សុស្សិតិកដែលចង់បាន	17
កំណត់សម្ងាត់សម្រាប់ការវាស់ត្រូវបានប្រើបាយ	18
ការវាស់ TriCheck™	18
ការវាស់ដោយប្រើមួយីទេរ TriCheck™	18
ការវាស់ដោយប្រើមួយីទេរ TriCheck™	19
ការរំលើកទិន្នន័យអង្គចងចាំ	20
តើអ្នកទៅជាសុចនាករ IHB/AFib?	21

តើ AFib គឺជាអ្វី?	21
សូចនាករបានសម្ងាត់	21
សូចនាករចំណាត់ថ្នាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក	22
អំពីសម្ងាត់ជុំជាមួយ	23
តើសម្ងាត់ជុំជាមួយគឺជាអ្វី?	23
តើការលើសិល្បាយគឺជាអ្វីហើយតើវាគ្រេចបានគ្រប់គ្រងដោយ រហូមណា?	23
ហេតុអ្វីបានគ្រេចរាស់សម្ងាត់ជុំជាមួយនៅថ្ងៃ?	23
ការបែងចែកសម្ងាត់ជុំជាមួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក	23
ការប្រើប្រាស់សម្ងាត់ជុំជាមួយ	24
ការដោះស្រាយបញ្ហា	24
ការចែកទាំ	25
ទិន្នន័យបច្ចេកទេស	25

សូមជួនចំពោះអតិថិជនជានីគោល

កំណត់សម្ងាត់ជូន

ប្រធានប្រយ័ត្ន

- សមាសធាតុផ្សាស់លាស់ ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការដែលចិត្តខករណ៍នេះ។ អ្នកគួរចេចសភាងនៅក្នុងស៊ីតុណ្ឌភាពកម្រិតខ្លាំង សំណើម ពន្លឹះព្រះអាណិត្យដោយធ្វាល់ ការដែក ប្រួលដី។
 - សម្ងាត់ខករណ៍ និងប្រជាប់ទុកដោយក្រុណាតំនៃ ស្ថិត ប្រក្សាតំដែលសេចក្តីដោយទីក និងមេរីសាបូណ៍តាម មិនត្រូវប្រើបាតិអាល់កូល ហាតិបេនហ្មោន សារធាតុគីឡូស្ទើដែលមានប្រព័ន្ធអ្នកប្រជាប់ខ្លាំងដើម្បីក្នុងស៊ីតុណ្ឌខករណ៍ ប្រជាប់ទំនៈទេ។
 - ដោរសភាងកំបត់ប្រជាប់ទុកដោន ប្រុទុកទុកដោយដែលបត់ណែនយេះពេលយូរ ព្រះការធ្វើបែបនេះអាចបន្ថយអាយុកាលរបស់សមាសធាតុ។
 - សូមប្រយ័ត្នដោរសភាងកំឱ្យរំណែករបស់ទារក ប្រកុមារតូចដោយថែដីនូវជាមួយទុកដោយនិងខ្សោយ។
 - សូមកំបត់ទុកដោយអំឡុងពេលវាស់។ នេះអាចបណ្តាលឱ្យមានការខ្ចោចខាត ដោយសារតែសម្ងាត់ខ្លាំងឡើងរបស់ប្រជាប់ទៅ។
 - ខករណ៍ និងប្រជាប់ទុកដោយនិងទីកទេ។ ទៅស្ថាត់ទីកត្រូវដោរស៊ីស និងទីកពីការធ្វើឱ្យប្រឡាក់ខករណ៍ និងប្រជាប់ទៅ។
 - ការរៀស់អាចនិងមិនត្រូវត្រូវ ប្រសិនបើខករណ៍ត្រូវបានប្រើនៅដីតូចទស្សន៍ ម៉ាសីនីមីក្រុង ទូរសព្ទចលប់ត កំស្បីអូច ប្រុខខករណ៍ដោរឃីនឡើតដែលមានចាន់អតិថិជននិកម្មាំងខ្លាំង។
 - ខករណ៍ទាំងនៅក្នុងបណ្តាលូកដែលបានប្រើបាន ទូរសព្ទចលប់ត ទូរសព្ទតំខ្សោយ និងបណ្តុកប្រព័ន្ធរបស់ពួកក្រុង ខករណ៍អាយក្សម កំអាចប៉ះពាល់ដល់ខករណ៍រាស់សម្ងាត់យាមនេះ។ ជូនីច្ចៃះ គូរក្រុចមាយអប្បបរមា 30 សម ពីខករណ៍នេះ។




- គ្រឿងបរិញ្ញារ គ្រឿងបន្ទាស់ និងម្បីដែលបើរួច មិនត្រូវបានចាត់ទុកជាកាតសំណាល់ក្នុងផ្ទះធម្មតាថ្វីយ ហើយត្រូវតែបានចាត់ទុកជាកាតសំណាល់ក្នុងផ្ទះធម្មតាថ្វីយ
- នៅពេលបើរីអាជាប់ទៅ AC, ត្រូវប្រាកដថាអាជាប់ទៅ AC អាចចេញបានយ៉ាងឆាយស្រួលបានដើម្បីនៅពេលចាំបាច់។
- នៅពេលបើរីខបករណ៍ឡើងវិញ ត្រូវប្រាកដថាបានខបករណ៍នេះត្រូវតាំង។
- កុំកែប្រើប្រាករណ៍ដូចជាភាសា: ភាគចបណ្តាលឱ្យគ្រោះឆ្នាក់ ឬមានការខួចខាតដល់ខបករណ៍។
- ដើម្បីរកស់សម្ងាត់ឈាម ប្រជាប់រីត្រូវតែបើដែលខ្សោយស្រួលបានយ៉ាងឆាយស្រួលបានដើម្បីរកស់សម្ងាត់ឈាម បណ្តាឃោះអាសន្នសិន។ នេះអាចបណ្តាលឱ្យយើងចាប់ ស្តីក ឬស្មាមក្រហមបណ្តាឃោះអាសន្ននៅលើដៃ។ លក្ខណៈនេះ នឹងលើចាប់ឡើង ជាពីស់នៅពេលការរកស់ត្រូវបានធ្វើប្រើប្រាស់។ កន្លែការលើចាប់ ស្តីក ឬស្មាមក្រហមនឹងបានចាប់ឡើងតាមពេលវេលា។
- ការរកស់សម្ងាត់ឈាម ត្រូវបានចាប់ឡើងពេលវេលាដែលមានការចេញបានយ៉ាងហ្មត់ ពិនិត្យមើលថាប្រព័ន្ធបានខ្សោយស្រួលបានយ៉ាងឆាយស្រួលបានដើម្បីប្រើប្រាករណ៍នេះ មិនបណ្តាលឱ្យមានការចុះខ្សោយនៃចេញបានយ៉ាងហ្មត់ នៅពេលដែលបើរីខបករណ៍មួនហើយ។
- ការធ្វើតែស្ថិត្រាណាមួយ មិនត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះទាក់ទងទីបន្ទាន់ នៅពេលទីបន្ទាន់នេះ មិនត្រូវបានឡើងឡើងទៅទាក់ទងទីបន្ទាន់។
- ប្រសិនបើអ្នកមានការរំភាគិសន៍ សូមពិគ្រោះជាមួយដែលបានបណ្តុះបណ្តាលមុនពេលបើរីខបករណ៍នេះ។
- កុំអនុញ្ញាតឱ្យក្នុងការបើរីខបករណ៍ដោយខ្សោយនឹង ហើយកុំប្រើខបករណ៍ នេះនៅក្នុងនឹងដែលកូមារចូចឈានដល់។ ការចបណ្តាលឱ្យគ្រោះឆ្នាក់ ឬមានការខួចខាត។
- មានគ្រឿងតូចចាប់ដែលអាចបង្ហាញគ្រោះឆ្នាក់ដោយការស្វោគ់ ប្រសិនបើទាក់ទងបានដើម្បីប្រើប្រាករណ៍នេះ។
- សូមកុំបែនក្នុង DC និងអ្នកដំឡើងក្នុងពេលតិចមួយ។ នេះអាចបណ្តាលឱ្យមានការរៀបចំចេញអតិថិជន។
- ឯកអាជាប់ទៅ AC នៅពេលមិនបើរីខបករណ៍នេះ។
- ការបើរីខបករណ៍បែន្នែមដោយឡើងឡើត ដើម្បីបានរៀបចំបែន្នែមនៅក្នុងស្ថូរកែវិភាគ។
- អនុញ្ញាតឱ្យខបករណ៍នេះសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិយាកាសដូចឲ្យ មុនពេលបើរីប្រាស់ (ប្រើបាលម្បួយម៉ោង)។
- សូមកុំបែនក្នុងដោយមិនបានរៀបជាប់រីដូចឲ្យដើម្បីដោនៅលើ។

ការណែនាំផ្សេងៗ

ខាងក្រោមនេះគឺជាការប្រចងប្រយ័ត្នចំពោះការប្រើប្រាករណ៍ច្បាស់តានត្រីមត្រា

- សូមកំរឿប្រជាប់ទុំលើដើមដៃ ដែលមានជាប់ខបករណ៍អតិសនីទេឡើងវា
ឡើតា ខបកណ៍នេះប្រហែលជាចិនអាចដើរការប្រាស់ត្រីមត្រា។
- អ្នកដែលមានបញ្ហាលួយមានចំណុចផ្តល់ច្បាស់ដែលត្រូវតែតិចគ្នា
ដើម្បីបណ្តុតមុនពេលប្រើប្រាករណ៍នេះ ដើម្បីធ្វើសការបញ្ហាដែលសារស្តី។
- កំពើការវិភាគដោយខ្លួនឯងនូវលទ្ធផលនៃការភាស់ ហើយចាប់ដើម្បីរាយការជាមួយនឹងការព្យាពាល។
តើនេតែតិចគ្នា ដើម្បីបណ្តុតរបស់អ្នក សម្រាប់ការភាស់ដែលត្រូវបាននិងការព្យាពាល។
- សូមកំរឿប្រជាប់ទុំនៅលើដែលមានរូបសមិទ្ធសាន្តា
- សូមកំរឿប្រជាប់ទុំនៅលើដែលមានកន្លែងចាក់ឆ្នាំ បុរាណបញ្ហាលួយមាន។ វាអាចបណ្តាលឱ្យមានរូបស
ប្រគ្រាប់ឆ្នាំ។
- សូមកំរឿប្រជាប់ទុំនៅលើដែលមានខស្សែនដែលដោះ ដូចជាបេលមានខស្សែនជាតិ
ស្តីកា វាអាចបណ្តាលឱ្យមានការឆ្លែះ។
- សូមកំរឿប្រជាប្រាករណ៍នៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានកំហាប់អុកសុីសែនខ្លួន ដូចជាបន្ទូប់អុកសុីសែន
បុត្រិនអុកសុីសែនដែលមានសម្រាប់ខ្លួន វាអាចបណ្តាលឱ្យដោះ បុង្គោះ។

កំណត់អត្ថសញ្ញាណជោគ

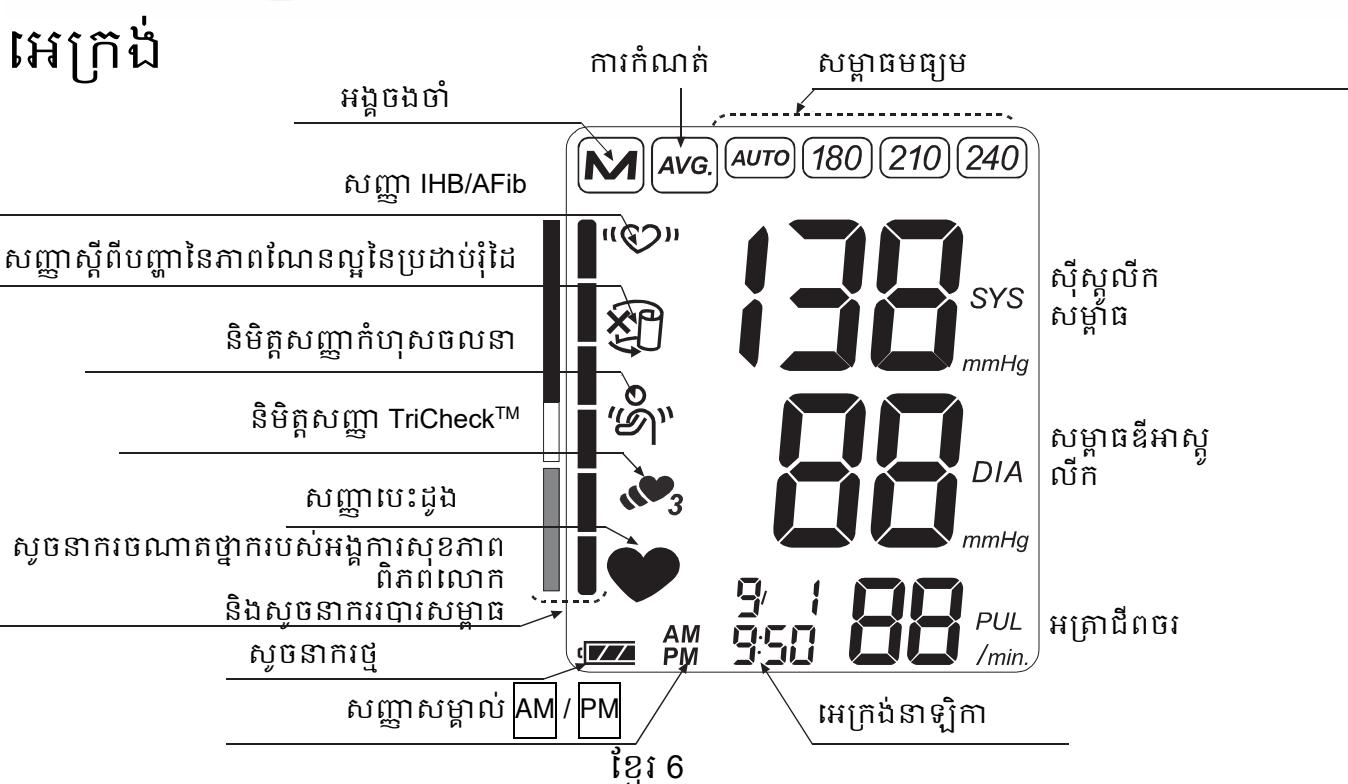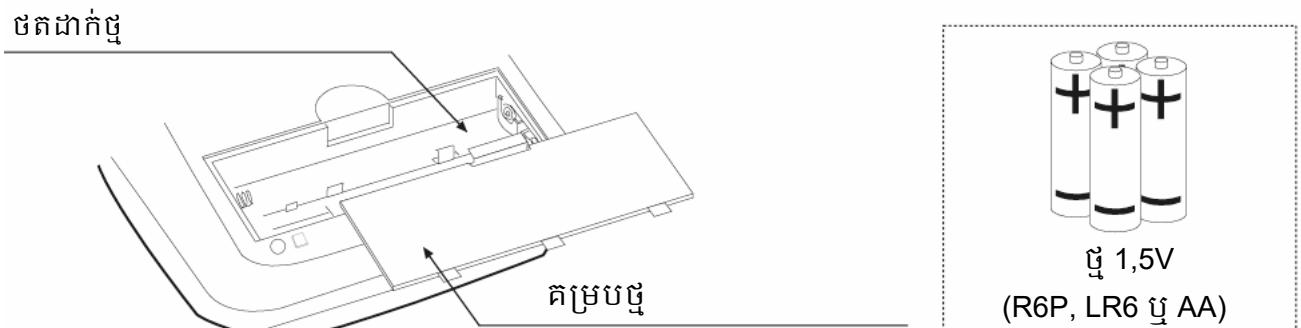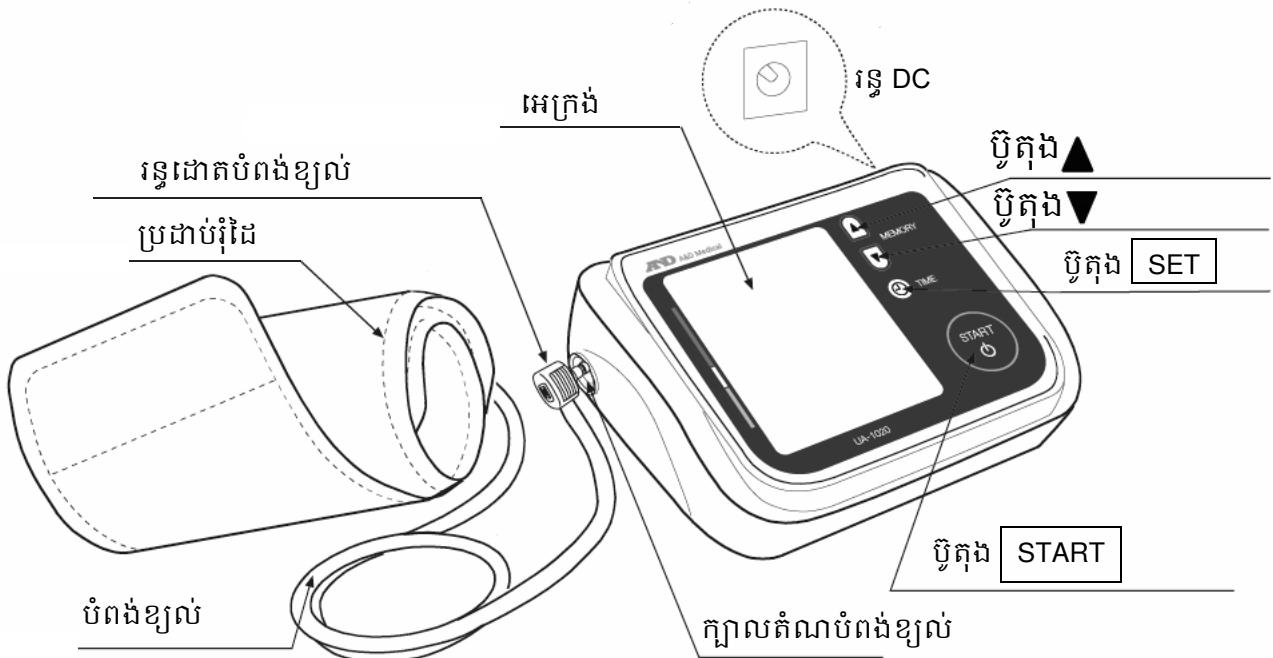

និមិត្តសញ្ញា

និមិត្តសញ្ញាដែលគ្រួរបានពោះពុម្ពលើប្រអប់ខបករណា

និមិត្តសញ្ញា	មុខងារ / អគ្គន័យ
	ផែចាំ និងបើកខបករណា
	ការណែនាំដំឡើងថ្មី
	បច្ចុប្បន្នផ្ទាល់
SN	លេខសម្ងាត់
	ក្រុមហិរិនដលិត
2020	កាលបរិច្ឆេទដលិត
	ប្រភេទ BF% ប្រជាប់រី គ្រួរបានចេញឡើងដើម្បី ផ្តល់ការការពារពីសេសប្រចាំនីងការនៃកំអតិសនី។
	គ្រឿងបរិត្រា គ្រឿងបន្ទាស់ និងថ្មីដែលបើរើច មិនគ្រួរបានចាត់ទុកជាកកសំណាល់ ក្នុងថ្មីដែលបានបង្ហាញ ហើយគ្រឿតចោះចោលតាមបទប្បញ្ញត្តិក្នុងតំបន់បានមេន។
	សូមមេលស្រួលរោគណា / ស្រួលរោគដូចជាយករាយ
	បូលនៃរន្ត DC
IP	និមិត្តសញ្ញាការពារអនុវត្តតាតិ
	ទុកឱ្យស្អួល

និមិត្តសញ្ញាដែលបង្ហាញនៅលើអេក្រង់

និមិត្តសញ្ញា	មុខងារ / អគ្គន័យ	សកម្មភាពដែលបានណែនាំ
	លេចឡើងពេលកំពុងកាស់។ ភាមានពន្លឹះបន្ថែត នៅពេលរកយើងូចឆ្នាក់ដីចារ៉ា	ការរោស់កំពុងដំណើរការ។ សូមនៅឱ្យ ស្រួមតាមដែលអាចធ្វើបាន។
	សញ្ញា IHB/AFib លេចឡើងនៅពេលរកយើងូចឆ្នាក់បែងចុះឱ្យបាន ភាមាននឹងវិញនៅពេលដែលរកយើងូចមានការព្យែរខ្លះនឹង ជួចជាប្រាប់ ប្រាប់។	_____
	មុខងារ TriCheckTM ធ្វើការរោស់ដែលបង្ហាញត្រូវដោយស្ម័យប្រវត្តិ ហើយបង្ហាញពីមួយមួយនៃការរោស់ទាំងបី។	_____
	លេចឡើងនៅពេលដែលរកយើងូចលាភនាកងកាយ ប្រាប់។	អំណែនការអាចផ្តល់តម្លៃមិនត្រឹមត្រូវ សាកល្បងរក សំអុងឡើតា នៅនឹង ក្នុងអំឡុងពេលរាយ។

សិទ្ធិសញ្ញា	មុខងារ / អត្ថន័យ	សកម្មភាពដែលបានណែនាំ
	លេចឡើងក្នុងអំឡុងពេលវាស់ នៅពេលដែលប្រជាប់រំគ្រោបានប្រើមិនបានតីងណែន	អំណែនការអាចផ្តល់តម្លៃមិនត្រឹមត្រូវ។ ដាក់ប្រជាប់វិញបានត្រឹមត្រូវ រួចហើយពុរាយកាមភាស់អ្នកដោយឡើង។
	ការវាស់ពីមុននៃគ្រោបានរក្សាទុកក្នុងអង្គចងចាំ។	_____
	ទិន្នន័យមធ្យោម	_____
	ពេញបរិមាណមួយ សូចនាករចាយពលមួយអំឡុងពេលវាស់	_____
	មួយខ្សោយ បានពលមួយមានការប្រើបាន នៅពេលដែលវាស្តីបន្ថែត។	បូរចូទំនិងអស់ជាមួយបុរី នៅពេលដែលសញ្ញាលោត វិបន្ថែត។
	សម្ងាត់មិនមានលក្ខណៈដោយសារចំណាត់ក្នុងកំឡុងពេលវាស់។	សាកល្បងវាស់អ្នកដោយឡើង។ នៅនឹងក្នុងអំឡុងពេលវាស់។
	តម្លៃស្តីស្តូលីក និងខិអាស្តូលីកស្តិតនៅក្នុងរដ្ឋ 10 mmHg។	_____
	តម្លៃសម្ងាត់មិនកែនឡើងក្នុងអំឡុងពេលសប់បន្តីន។	ដាក់ប្រជាប់វិញបានត្រឹមត្រូវ រួចហើយពុរាយកាមភាស់អ្នកដោយឡើង។
	ប្រជាប់វិដី មិនគ្រោបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវទេ។	_____
	កំហុសអេក្រិនបង្ហាញនឹងពចេរ ដីពចេរមិនគ្រោបានរកឃើញត្រឹមត្រូវទេ។	_____
	បញ្ជាផ្ទាល់ក្នុងនៃការត្រួតពិនិត្យសម្ងាត់មិន បញ្ហាទាងក្នុងនៃការត្រួតពិនិត្យសម្ងាត់មិន។	ដោះចូរចូចចូរក្នុង START ហើយបញ្ហាប់មកដាក់មួយអ្នកដោយឡើង។ ប្រសិនបើបញ្ហានៅតែលើឡើង សូមទាក់ទង អ្នកលក់។
SYS	សម្ងាត់មិនស្តីស្តូលីក ជា mmHg	_____
DIA	សម្ងាត់មិនខិអាស្តូលីក ជា mmHg	_____
PUL	ចង្វាក់ដីពចេរក្នុងមួយនាទី	_____
AM	លេចឡើងនៅពេលទិន្នន័យជាមួយគ្រោបានបង្ហាញ។ ទិន្នន័យដែលបានយកនៅថ្ងៃនោះម៉ោង 4:00 និង 9:59	_____
PM	លេចឡើងនៅពេលទិន្នន័យជាមួយគ្រោបានបង្ហាញ។ ទិន្នន័យដែលបានយកនៅថ្ងៃនោះម៉ោង 18:00 និង 1:59	_____
	ការកំណត់សម្ងាត់ បង្ហាញពីតម្លៃសម្ងាត់ដែលបានកំណត់ពីមុនដោយអ្នកប្រើប្រាស់។	_____

របៀបប្រតិបត្តិការ

1. ការរាស់ធ្លាតា

ចូចបឹកតុង **START** ។ សម្ងាត់លម្អាមត្រូវបានរាស់ ហើយទិន្នន័យត្រូវបានក្រឡុកក្នុងអង្គចងចាំ។ ខាបករណ៍នេះអាចរក្សាទុកការរាស់ចុងក្រោយ 90 ដងក្នុងអង្គចងចាំ។

2. ការរំលើកទិន្នន័យអង្គចងចាំ

ចូចបឹកតុង **▲** **▼** ដើម្បីបង្ហាញទិន្នន័យនៅក្នុងអង្គចងចាំ។
ក្រិតមធ្យមនៃការរាស់ទាំងអស់ត្រូវបានបង្ហាញ
ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរបន់ថ្ងៃខែឆ្នាំ។

កល់ពេលដែលបឹកតុង **▼** ត្រូវបានចូច
ទិន្នន័យអង្គចងចាំត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម។


ជាមួយមនុស្សនៃការរាស់ AM (ពេលព្រឹក) ទាំងអស់
ដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះម៉ោង 4:00 ដល់ 9:59។

ក្រិតមធ្យមនៃការរាស់ PM (ពេលល្ងាច) ទាំងអស់
ដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះម៉ោង 18:00 ដល់ 1:59។

ទិន្នន័យចុងក្រោយបំផុត (No.n ក្នុងខាងក្រោម លេខ 35)

ទិន្នន័យចុងក្រោយ (លេខ 1)

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីការលើបទិន្នន័យ សូមមេត្តលើ
“ការរំលើកទិន្នន័យអង្គចងចាំ”។



3. ការលើបទិន្នន័យទាំងអស់ដែលធ្វើក្នុងអង្គចងចាំ

ចូចទាំងបឹកតុង **▲** និង **▼** ។ **M** សញ្ញាសម្ងាត់ និង
សូចនាករច្បាស់និងលេចបេឡើង។ សូមចូចទាំងបឹកតុង **▲** និង **▼**
ទាំងពីរឱ្យបាប់ហ្មតដល់សញ្ញាសម្ងាត់ **M** ដែលមានក្រើនក្នុបក្រោត
ដើម្បីលើបទិន្នន័យដែលបានក្រឡុកទាំងអស់នៅក្នុងអង្គចងចាំ។


4. ការរាស់នឹងជាមួយនឹងសម្ងាត់សុំស្តូលីកដែលចង់បាន

សូមមេត្តលើទីទី 17 សម្រាប់សម្ងាត់សុំស្តូលីកដែលចង់បាន។

ការប្រើប្រួល

ការដំឡើង / ការផ្តាស់ប្បរព្យ

- ដោះគម្រោង។
- ដកចូលដែលប្រើប្រាស់បញ្ចូនដោយយកចិត្តទុកដាក់ចូល (+ និង -)
គីត្រីមគ្រឿវា
ប្រើតែចូល R6P, LR6 ឬ AA ប៉ុណ្ណោះ។
- ត្រាប់គម្រោង។

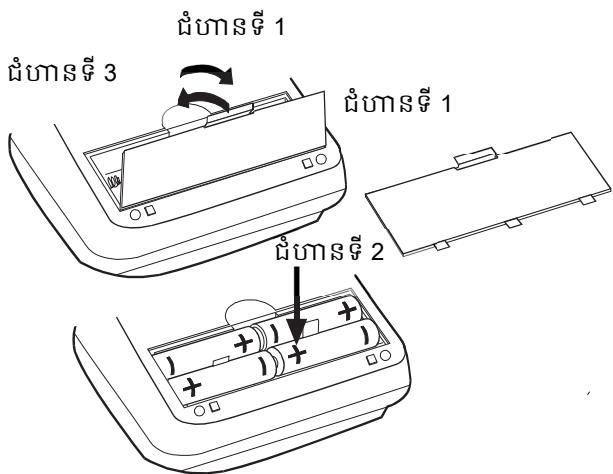

ការប្រើប្រាស់

- បញ្ចូនចូលដែលបញ្ចាយក្នុងចិត្តទុកដាក់ចូល។ ប្រសិនបើដំឡើងមិនត្រឹមត្រូវទេ ឬបករណ៍នឹងមិនជំនោះការទេ។
- នៅពេលដែល  (សញ្ញាសម្ងាល់ចូល) លោកត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងអ្វីក្នុងថ្ងៃខែឆ្នាំ ឬបញ្ចូនចូលដែលបញ្ចាយក្នុងចិត្តទុកដាក់ចូល។ ក្នុងថ្ងៃខែឆ្នាំ ឬបញ្ចូនចូលដែលបញ្ចាយក្នុងចិត្តទុកដាក់ចូល នឹងធ្វើឱ្យអាមេរិកាលចូលដែលបញ្ចូនចូលដែលបញ្ចាយក្នុងចិត្តទុកដាក់ចូល។
-  (សញ្ញាសម្ងាល់ចូល) មិនបញ្ចាយនៅពេលអស់ចូល។
- អាមេរិកាលចូលដែលបញ្ចាយក្នុងចិត្តទុកដាក់ចូលត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងអ្វីក្នុងថ្ងៃខែឆ្នាំ ឬបញ្ចូនចូលដែលបញ្ចាយក្នុងចិត្តទុកដាក់ចូល។ ក្នុងថ្ងៃខែឆ្នាំ ឬបញ្ចូនចូលដែលបញ្ចាយក្នុងចិត្តទុកដាក់ចូល នឹងធ្វើឱ្យអាមេរិកាលចូលដែលបញ្ចូនចូលដែលបញ្ចាយក្នុងចិត្តទុកដាក់ចូល។
- សូមប្រើតែចូលដែលបញ្ចាក់ប៉ុណ្ណោះ។ ចូលដែលបញ្ចូនចិត្តទុកដាក់ចូល គីត្រីមគ្រឿវាទៅ គីត្រីមគ្រឿវាទៅ ឬបញ្ចូនចូលដែលបញ្ចាយក្នុងចិត្តទុកដាក់ចូល។
- ដកចូលដែលបញ្ចាយក្នុងចិត្តទុកដាក់ចូល។ ចូលដែលបញ្ចូនចិត្តទុកដាក់ចូល គីត្រីមគ្រឿវាទៅ ឬបញ្ចូនចូលដែលបញ្ចាយក្នុងចិត្តទុកដាក់ចូល។

ការប្រើម៉ឺនីទេរ

ការភ្លាប់បំពង់ខ្សោល

បញ្ចូលខ្ពស់តំណាក្យល់ចូលទៅក្នុង
នូវខ្សោលផ្ទិចផ្ទាត់។

ក្នុងតំណាក្យល់បំពង់ខ្សោល

នូវដោតបំពង់ខ្សោល

ការភ្លាប់អាជាប់ទេរ AC

បញ្ចូលអាជាប់ទេរ AC ទៅក្នុងនូវ DC។
បន្ទាប់មកភ្លាប់អាជាប់ទេរ AC ទៅព្រឹក្តិ៍។

ខ្ពស់ដោតអាជាប់ទេរ AC

នូវ DC


- ប្រើឯកអាជាប់ទេរ AC ដើលបានបញ្ចាក់តែបុង្ញលេការៈ។
(ស្មើមីលទំនួរទី 22។)
- នៅពេលផ្តាច់អាជាប់ទេរ AC ពីព្រឹក្តិ៍ សូមចាប់ និងទាញក្នុងអាជាប់ទេរ AC ចេញពីព្រឹក្តិ៍។
- នៅពេលផ្តាច់ខ្ពស់អាជាប់ទេរ AC ចេញពីម៉ឺនីទេរសម្រាប់សម្រាប់ សូមចាប់ និងទាញខ្ពស់អាជាប់ទេរ AC ចេញពីម៉ឺនីទេរ។

ការប្រើប្រួលនៃការពន្លានក្នុង

ការតម្លៃនៃការពន្លានក្នុង

តម្លៃនៃការពន្លានក្នុង

1. ចូចបូតុង **SET** រហូតទាល់តែត្រាំចាប់ដើមសាងស្តីប៉ោត។
2. ព្រឹសធីសត្វាំដោយប្រើប្រួល **▲ បុ ▼**។
ចូចបូតុង **SET** ដើម្បីកំណត់ត្រាំបច្ចុប្បន្ន ហើយផ្តាស់ទីទៅការ
ព្រឹសធីសខែ/ថ្ងៃ។ កាលបរិច្ឆេទអាជីវកម្មបានកំណត់នៅត្រូវប៉ោត
កន្លែងរក្សាទ្វាក់ 2010 និង 2059។
3. ព្រឹសធីសខែដោយប្រើប្រួល **▲ បុ ▼**។
ចូចបូតុង **SET** ដើម្បីកំណត់ខែបច្ចុប្បន្ន
ហើយផ្តាស់ទីទៅការព្រឹសធីសថ្ងៃ។
4. ព្រឹសធីសថ្ងៃដោយប្រើប្រួល **▲ បុ ▼**។
ចូចបូតុង **SET** ដើម្បីកំណត់ថ្ងៃបច្ចុប្បន្ន
ហើយផ្តាស់ទីទៅការព្រឹសធីសម៉ោង/នាទី។
5. ព្រឹសធីសត្វាំដោយប្រើប្រួល **▲ បុ ▼**។
ចូចបូតុង **SET** ដើម្បីកំណត់ម៉ោងបច្ចុប្បន្ន
ហើយផ្តាស់ទីទៅការព្រឹសធីសនាទី។
6. ព្រឹសធីសនាទីដោយប្រើប្រួល **▲ បុ ▼**។
(ចូចបូតុង **SET** ដើម្បីចូលទៅកាន់មុខងារការកំណត់សម្ងាត់
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមឈឺលទ្ធផលទី 17។)
ចូចបូតុង **START** ដើម្បីចូលទៅកាន់សម្ងាត់។

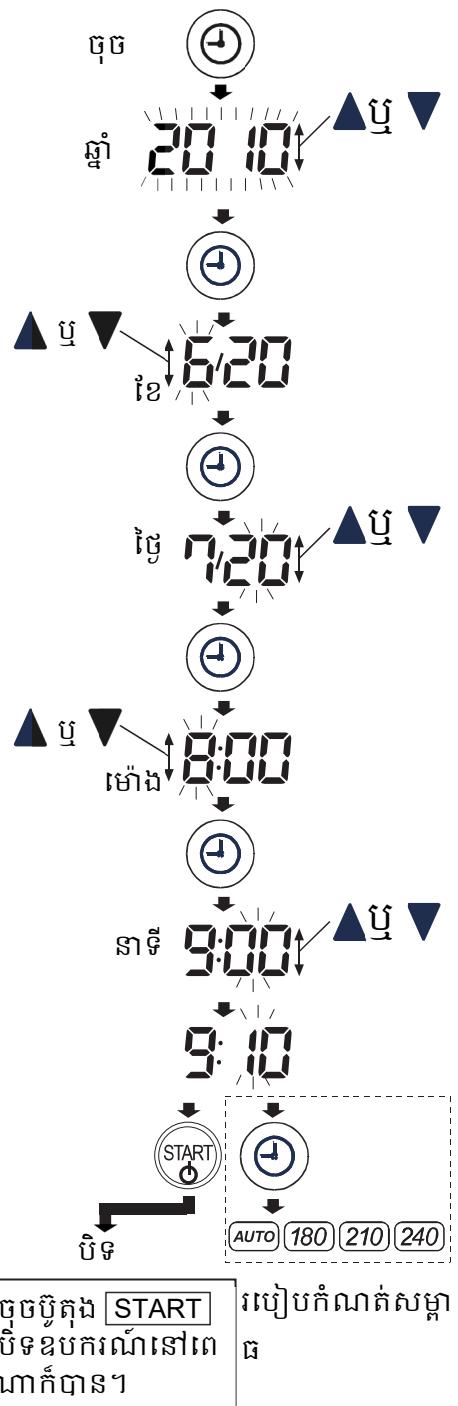

- ចំណាំ៖ បញ្ជាប់ពីមិនជាំណែរការប៉ីនាទី
ឧបករណ៍នឹងបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
នៅពេលដែលនានាដឹកមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់
ការបង្ហាញនានាដឹកបង្ហាញសញ្ញាចុចចាប់ដែល
បានបង្ហាញនៅខាងក្រោម។
នៅពេលប្រើឧបករណ៍នេះជាលើកជិំបួង។
នានាដឹកមិនត្រូវបានតម្លៃ
នៅពេលដែលឧបករណ៍ត្រូវបានដោឡើងចំណែកដោយលើសពី 30 វិនាទី
នៅក្នុងកាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់ចុច ម៉ោង និងកំលែសម្ងាត់នឹងត្រូវបានលុបបាល។
នៅពេលដែលកាលបរិច្ឆេទកំណត់ ពេលដែលបានកំណត់ត្រូវបានលុបចេញ
សូមកើតប្រើអ្នកដោត។
- ការចូចសង្គតិបូតុង **▲ បុ ▼** នឹងធ្វើឱ្យផ្តាស់ប្បរតនៅបញ្ហាប្រើប្រាស់

ការចូចបូតុង **START**
នឹងបិទឧបករណ៍នៅពេល
បានកំណត់សម្ងាត់។

ការប្រើម៉ឺនីទេរ

ការរៀនបែកចំណោមបំបាត់រឿងដែលត្រឹមត្រូវា

ការប្រើចំហេប្រជាប់រឿងត្រឹមត្រូវ គឺមានសារ៖ សំខាន់សម្រាប់អំណោនកាថ្មីលំកតម្លៃសម្រាប់មិនត្រឹមត្រូវា

ប្រសិនបើប្រជាប់រឿងមានចំហេប្រជូន អំណោនកាថ្មីលំកតម្លៃសម្រាប់មិនត្រឹមត្រូវា


- ចំហេងត្រូវបានពេញនៅលើប្រជាប់រឿងនីមួយា។
- ប្រជាប់រឿង គឺអាចប្រើប្រាស់បាននិងផ្ទាល់ប្រើបាន។ ប្រសិនបើរហាក សូមទិញតួ។

ចំហេង	ចំហេប្រជាប់រឿងដែលបានណែនាំ	លេខការាណុក
31 សម ទៅ 45 សម	ប្រជាប់រឿងចំហេប្រជាប់មនុស្សពេញរឿង	CUF-D-LA-ISO
22 សម ទៅ 42 សម	ប្រជាប់រឿងចំហេប្រជាប់មនុស្ស	CUF-I-ISO
23 សម ទៅ 37 សម	ប្រជាប់រឿងចំហេប្រជាប់មនុស្ស	CUF-D-MA-ISO
22 សម ទៅ 32 សម	ប្រជាប់រឿងសម្រាប់មនុស្សពេញរឿង	CUF-F-A-ISO
16 សម ទៅ 24 សម	ប្រជាប់រឿង	CUF-D-SA-ISO
17 សម ទៅ 32 សម	ប្រជាប់រឿងសម្រាប់មនុស្សពេញរឿង SmoothFit	CUF-G-A-ISO

ចំហេងទៅចំណោមបំបាត់រឿង

រយៈបងាក់ប្រជាប់រឿង

1. រួមប្រជាប់រឿងនិងដែកខាងលើប្រហែល 1 ទៅ 2 សង្គម ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការបងាក់ប្រជាប់រឿង។
ដាក់ប្រជាប់រឿងដោយប៉ះឆ្នាល់ទៅនឹងសូវក ព្រោះសម្បៀកបំពាក់អាចបងាក់ប្រជាប់រឿងបាន។
បណ្តាលឱ្យមានកំហុសក្នុងការរាយ។
2. ការតិចបន្ទីនិងដែកដែលបណ្តាល មកពីការមួរដែករាយការកំងមិនឱ្យមានអំណោនត្រឹមត្រូវ។

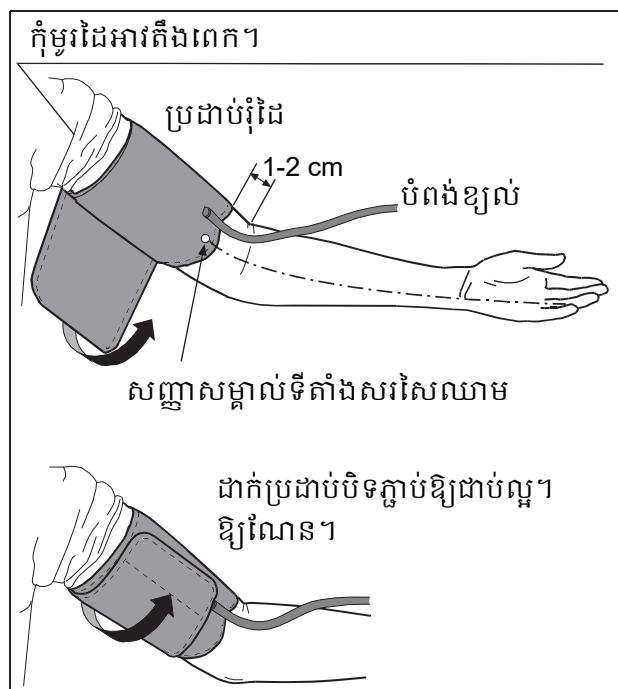

និមិត្តសញ្ញាណដែលគ្រប់ពាន់ពុម្ពនៅលើប្រជាប់

និមិត្តសញ្ញា	មុខងារ/អគ្គន៍យ	សកម្មភាពដែលបានណែនាំ
●	សញ្ញាសម្ងាល់ទីតាំងសរស់សំយាម	កំណត់សញ្ញាសម្ងាល់ ● លើសរស់សំយាមនៃផ្ទះដូចត្រូវ ប្រុងបនឹងម្រាមដែនាងនៅផ្ទះដូចត្រូវខាងក្រោមនេះ។
[REF]	លេខការតាមក្រុក	_____
[LOT]	លេខទូរតួ	_____
[M]	ធមិត្ត	_____
[MD]	ឧបករណ៍ផ្ទះសាស្ត្រ	_____

ការប្រើមួនីទេរ

រយៈប្រើការភស់ត្រីមត្រូ

ចំពោះការភស់សម្ងាត់យាមបានត្រីមត្រូរបំផុត៖

- អង្គួយឱ្យស្រលៃនៅលើកោដ្ឋា ដាក់សម្រាកដើរបស់អ្នកនៅលើគុា កំតិចដើរបស់អ្នក។
ដាក់ដើរបស់អ្នកកាបស្ថើនៅលើតួអ្នកនិងតម្លៃខ្លួនបស់អ្នក។
- បន្ទូរការមួនធនេះពេលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ឡើងបានទៅនឹងពេលភស់។
- ដាក់ថ្មីកកណ្តាលនៃប្រជាប់រូបនៅក្រើមធនិតិថ្មីនឹងបេះដូងបស់អ្នក។
- នៅនឹងស្រែម ហើយស្វែបស្ថាត់ក្នុងពេលកំណើនភស់។
- សូមកំស់ត្រាមឯកត្រាប៉ុណ្ណោះប្រចាំថ្ងៃ បុងតិក្រួច។ សម្រាករួយៗពេលឡើង បុសាមសិបនាទីមុនពេលភស់។
- ព្យាយាមភស់សម្ងាត់យាមបេះដូងក្នុងពេលដែលរាយការណ៍។

ការភស់

ក្នុងកំឡុងពេលភស់ រាយការណ៍ដែលត្រូវបានប្រជាប់រូបនៅក្នុងតាមរយៈប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង។ (កំភ្លាក់ដើរ)

បន្ទាប់ពីការភស់

បន្ទាប់ពីការភស់រួច ចុចចិត្តតុង **START** ដើរបីចិទ្ធបករណ៍។ ដោះប្រជាប់រីនិងកត់ត្រាឌីនូនីយរបស់អ្នក។

ចំណាំ៖ ឧបករណ៍នេះមានមុខងារបិទមាមពលដោយស្ម័័យប្រវត្តិ
ដែលបិទខាងក្រោមប្រព័ន្ធមួយនាទីបន្ទាប់ពីការភស់។ ទុកចន្លោះ
យកឯងចោរពាណិជ្ជកម្មនៃការភស់ឡើមនូស្សតែ ម្នាក់។

ការវាត់

មុនពេលវាស់ សូមម៉ែល “កំណត់សម្ងាត់សម្រាប់ការវាស់ត្រីមត្រី” នៅលើទីទី 18។

ការវាស់ចម្លាតា

- ជាក់ប្រជាប់រុន្តោលើដៃ (បើយកលូតីដៃធ្វើ) ។
អង្គយុវជ្រើមអំឡុងពេលវាស់។

2. ចូចចូចឲ្យកុង **START**

គ្រប់ផ្ទួកបង្ហាញ គ្រប់បង្ហាញបង្ហាញ។

សូន្យ (0) គ្រប់បង្ហាញបង្ហាញដោយតិចប៉ុត្រូតយកត្រីមត្រី។
បន្ទាប់មកអេក្រង់បែប្រូ, ឬចូចដែលបង្ហាញក្នុងរូបនៅខាងក្រោម,
នៅពេលដែលការវាស់ចាប់ផើម។ ប្រជាប់រុន្តោលើដៃ ចាប់ផើមប៉ះពេល។
ការរៀងចម្លាត់ទេ ដែលប្រជាប់រុន្តោលើដៃមានការមួលកិច្ចខ្ពស់។
សូចនាករបានបង្ហាញនៅតិចមានធ្វើនៅ

អេក្រង់អំឡុងពេលសប័ប៉ះពេល។

ចំណាំ៖ ប្រសិនបើអ្នកចង់បញ្ចប់ខ្សោយប៉ះពេលនៅពេលណាមួយ
សូមចូចចូចឲ្យកុង **START** មួយឡើត។

- នៅពេលការប៉ះពេលបញ្ចប់ ការបន្ទូរខ្សោយលីនិងចាប់ផើមដោយ
ស្អែយប្រភ័ត្តិ (សញ្ញាសម្ងាត់បែប្រូ) តិចប៉ុត្រូតយកត្រីមត្រី ដែលបង្ហាញថា
ការវាស់នៅពេលការប៉ះពេលមានពន្លឹកតិចប៉ុត្រូតយកត្រីមត្រី។
ការប៉ះពេលការប៉ះពេលមានពន្លឹកតិចប៉ុត្រូតយកត្រីមត្រី។

ចំណាំ៖ ប្រសិនបើចង់ទូទាត់បង្ហាញសម្ងាត់សម្រាប់ទូទាត់
ខបករណ៍ចាប់ផើមសប័បនិងមួនឡើតដោយស្អែយប្រភ័ត្តិ។
ដើម្បីចេញសកាងខ្សោយប៉ះពេលឡើងឡើងវិញ
“ការវាស់ដោយប្រើសម្ងាត់ដែលបានកំណត់” នៅទីទី 18
បន្ទាប់។

- នៅពេលដែលការវាស់បានបញ្ចប់ អំណានសម្ងាត់សុំស្តូលីក
និងខិះអាស្សូលីក និងអគ្គានីតចេរគ្រប់បង្ហាញឡើង
។ប្រជាប់រុន្តោលើដៃ បញ្ចប់ខ្សោយប៉ះពេលនៅពេលនៅ
ហើយធ្វើឱ្យសំបើតដោយអស់ទាំងប្រើប្រាស់។

5. ចូចចូចឲ្យកុង **START**

ដើម្បីបិទខបករណ៍បន្ទាប់ពីមួយនាទីនៅការមិនដំ
ណើរការ ខបករណ៍នឹងបិទដោយស្អែយប្រភ័ត្តិ។


ចំណាំ៖ ទូកចន្ទោះយ៉ាងហេចណាស់បីនាទីចន្ទោះរោងការវាស់
លើមនុស្សតែម្ខាក់។

នៅកម្រិតបែប្រូ

អេក្រង់ទាំងអស់
អ្នកដែលបង្ហាញឡើង

ការបង្ហាញសូន្យ
ចាប់ផើមប៉ះពេល

ការជាក់សម្ងាត់

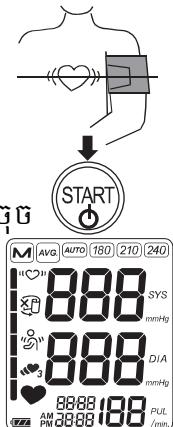

សម្ងាត់សុំស្តូលីក
សម្ងាត់ខិះអាស្សូលីក

ការចាត់ម្ខាក់សំអង្គការសុខភាពពិភពលោក
អគ្គានីតចេរ

បញ្ចប់ខ្សោយប៉ះពេលនៅពេល
ដោយស្អែយប្រភ័ត្តិ

ការវាត់

មួយដែល UA-1020 គ្រឿងរចនាអ្វីវិធីដើម្បីចាប់រកដឹងទៅ និងដើម្បីបង្កើតប្រជាប់វិធីដោយភ្លាមៗ ស្ថិស្សលីកដោយស្ថិស្សយប្រភ័ន្ធនា ប្រសិនបើការសំបុត្រិនកើតឡើងមួយហើយមួយឡើត សូមប្រើដើម្បីខាងក្រោម។


ការវាត់ដោយប្រើសម្ងាត់ដែលបានកំណត់

នៅពេលភាស់សម្ងាត់លើមួយ ការបំពេញឡើងឡើងវិញអាចនឹងកើតឡើង។ តម្លៃសម្ងាត់ដែលបានកំណត់ដើម្បីដោយភ្លាមៗការបំពេញឡើងវិញ។

- នៅជំហានទី 6 នៃនីតិវិធីកើតប្រភ័ន្ធឌីក (សូមមើលទី 12), សូមចូចចូង **SET** ដើម្បីចូលទៅកាន់មុខងារការកំណត់សម្ងាត់។ ការកំណត់ត្រូវបានបញ្ជូនឡើង។
- ចូចចូង **▲** ឬ **▼** ដើម្បីប្រើសំបត់តម្លៃសម្ងាត់ដែលអ្នករៀនឡើងឡើង។ ចូចចូង **▲** ឬ **▼** ដើម្បីប្រើសំបត់តម្លៃសម្ងាត់ស្ថិស្សលីកដោយអ្នករៀនឡើងឡើង។

AUTO : ការផ្តល់សម្ងាត់ដោយស្ថិស្សយប្រភ័ន្ធ (តម្លៃលំនាំដើម)
180 : តម្លៃសម្ងាត់ចំនួន 180 mmHg (ថែរ)
210 : តម្លៃសម្ងាត់ចំនួន 210 mmHg (ថែរ)
240 : តម្លៃសម្ងាត់ចំនួន 240 mmHg (ថែរ)


- ចូចចូង **SET** ដើម្បីចូលទៅកាន់មុខងារការកំណត់ **TriCheck™** ចូចចូង **START** ដើម្បីបិទខ្លួនរៀន។ បន្ទាប់ពីមិនដំណើរការបើនាទី ខ្លួននឹងបិទដោយស្ថិស្សយប្រភ័ន្ធ។ ការវាត់បន្ទាប់នឹងគ្រឿងរចនាអនុវត្តបាយយនឹងតម្លៃសម្ងាត់ម្ខី។

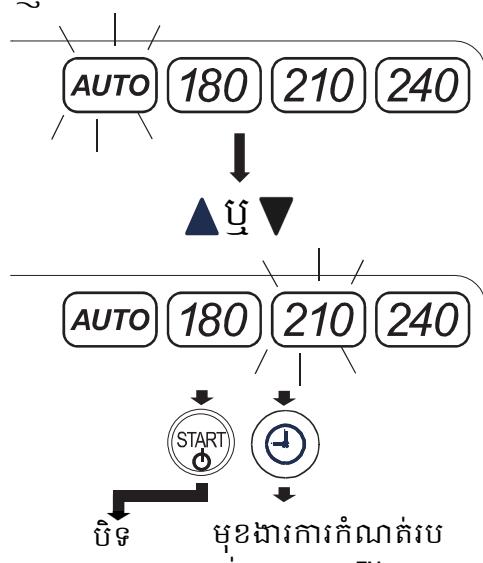

ការវាត់ដែលបានកំណត់សម្ងាត់ស្ថិស្សលីកដែលចង់បាន

ប្រើដើម្បីសាស្ត្រនេះនៅពេលដែលបំពេញឡើងមួយហើយមួយឡើត ទោះបីជាតិតម្លៃសម្ងាត់គ្រឿងរចនាកំណត់ទៅ **240** ក្នុងនីតិវិធីខាងលើ ឬនៅពេលដែលបានបង្ហាញមិនគ្រឿងរចនាបង្ហាញ ទោះបីជាសម្ងាត់ចយចុះដល់ 20 mmHg ប្រចិតបង្ហាញនេះ។

- ជាក់ប្រជាប់វិញនៅលើដៃ (បើយកណូតីដែលបាន)។
- សូមចូចចូងសង្គត់ចូង **START** ហើយដល់លេខប្រឈាល 30 ទៅ 40 mmHg ឱ្យសំបានសម្ងាត់ស្ថិស្សលីកដោយអ្នករៀនឡើង។
- នៅពេលដែលបានដល់លេខដែលចង់បាន សូមលើចូង **START** ដើម្បីចាប់ផ្តើមការសំបាន បន្ទាប់ការសំបានយាមបែលអ្នកជួយបាន។

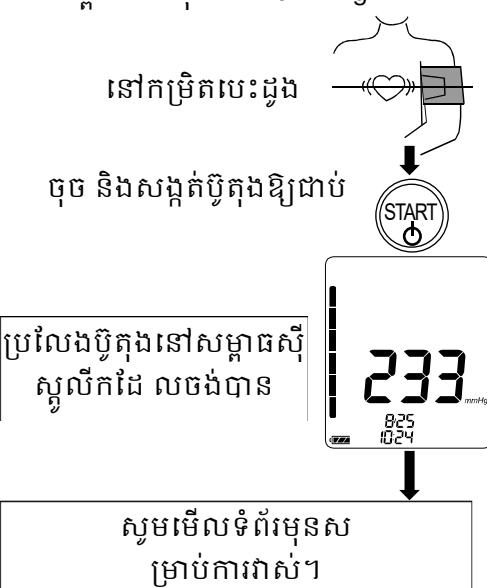

កំណត់សម្ងាត់សម្រាប់ការវាស់ត្រីមត្រូវ

- អង្គយនទោះតាំងល្អមានជាសុកភាព។
ជាក់ដៃបេស់អ្នកនៅលើគុម្ភយដោយបាត់ដៃបេស់អ្នករួចឡើងលើនិងប្រជាប់រីដៃ
នៅក្រឹមត្រូចគ្នានឹងហេះដូចបេស់អ្នក។
- បន្ទាយអាមូណាយ៖ពេលប្រាលបារាំង ទៅដែលនាទីមុនពេលចាប់ធ្វើមកស់។
ប្រសិនបើអ្នកមានអាមូណាយដើម្បីបង្កើតប្រជាប់នៅក្នុងការបាត់ដៃបេស់អ្នក,
ការវាស់ដែងនេះនឹងឆ្លើងបញ្ចប់ពីភាពតានកីដែនេះជាក្រឹមត្រូច (ប្រចាប់) ដាក់ការអនេសម្ងានយាមធម្មតា
ហើយការអនេសនីពេល ជាទុទេ នឹងលើវិនាទាងធម្មតា
- សម្ងានយាមធម្មតាបេស់បុគ្គលម្នាក់ទៅប្រប្រលតតណុយប័ណ្ណ អារ៉ាប៉ូយលើអ្នកដែលអ្នកកំពុងធ្វើ
និងអ្នកដែលអ្នកបានញ្ចាំ។ អ្នកដែលអ្នកដើម្បីការចមានតួនាទីពលខ្សោះ និងរបៀបលើសម្ងានយាមធម្មតាបេស់អ្នក។
- ខបករណ៍នេះដូចការស់ស្អែងចង្វាក់ហេះដូចបេស់ការប្រសិនបើអ្នកមានចង្វាក់ហេះដូចខ្សោយ
ប្រចិនឡើងទាក់ខបករណ៍នេះប្រាលបាត់បាតក្នុងការកំណត់សម្ងានយាមធម្មតាបេស់អ្នក។
- ប្រសិនបើខបករណ៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងបញ្ហាបញ្ហា សូមមេនទំនួរទៅថ្ងៃទី 6 សម្រាប់ការពណ៌នាគំពីនិមិត្តសញ្ញា។
- ខបករណ៍នេះសម្រាប់តែមនុស្សពេញវេលាប្រើប្រាស់។
ពីគ្រោះជាមួយត្រូវពេញរបស់អ្នកមុនពេលប្រើប្រាស់ខបករណ៍នេះលើកុមារា
កុមារមិនត្រូវប្រើប្រាស់ខបករណ៍នេះដោយមិនចាំបាច់។
- ដំណើរការមួយនឹងចំណែកដោយស្ម័យប្រវត្តិ អាចត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយ
សិក្សាត្រូវការណែនាំ បុសំណើម បុកម្យស់។


ការវាស់ TriCheck™

មុខងារ TriCheck™ ធ្វើការវាស់ដែងបីជាប់គ្នាដោយស្ម័យប្រវត្តិ ហើយបង្ហាញតម្លៃមួយនៃការវាស់តាំងបី។

ការវាស់ដោយប្រើមួយដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងការកំណត់សម្ងានយាមធម្មតាបេស់អ្នក


1. នៅក្នុងរបៀបកំណត់សម្ងានយាមធម្មតាបេស់អ្នក ចូលលើ **SET** ដើម្បីចូលទៅមុខងារការកំណត់ TriCheck™។
ការកំណត់ត្រូវត្រូវបានត្រូវបញ្ជូនដោយបញ្ចូនបញ្ជូន។
2. ចូលបីក្នុង **▲** ឬ **▼** ដើម្បីចូលទៅមុខងារ the TriCheck™។
បើក៏ មុខងារ TriCheck™
បិទេះ មួយដែលការវាស់ជម្លាត់ (តម្លៃជម្លាត់)
3. ចូលបីក្នុង **START** ឬ **SET** ដើម្បីចូលទៅការកំណត់ត្រូវបានត្រូវបញ្ជូន។
ប្រចាំពីរដែលដំណើរការបីនាទី
ខបករណ៍នេះប្រើប្រាស់ដោយស្ម័យប្រវត្តិ។

នៅក្នុងមួយដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងការកំណត់សម្ងានយាមធម្មតាបេស់អ្នក




ការកំណត់ត្រូវត្រូវបានត្រូវបញ្ជូនបញ្ជូន។

ផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ត្រូវត្រូវបានត្រូវបញ្ជូនបញ្ជូន។



ការវាស់ដោយប្រើម៉ឺនធ TriCheck™

- ចូចចូចតុង **START**។
គ្រប់ផ្ទួកបង្ហាញ គ្រូរបានបង្ហាញ។
សូន្យ (0) គ្រូរបានបង្ហាញដោយត្រូវការមួយត្រូវតិច
ហើយការវាស់លើកដំបូងនឹងចាប់ផ្តើម។
 - នៅពេលដែលការវាស់បានបញ្ចប់
អំណោនសម្ងាតសីសុលីក និងខិកសុលីក
និងអគ្គារីតចងគ្រូរបានបង្ហាញឡើង
បន្ទាប់មកការរៀបចំយករាយមួយនាទីនឹងចាប់ផ្តើមសម្រាប់ការវាស់ទីពីរ។
 - បន្ទាប់ពីមួយនាទី ការវាស់ដែងទីពីរចាប់ផ្តើម។
 - នៅពេលដែលការវាស់បានបញ្ចប់
ការអារេជាមួយនៃការវាស់ដែងទីមួយ
និងទីពីរគ្រូរបានបង្ហាញ
បន្ទាប់មកការរៀបចំយករាយមួយនាទីចាប់ផ្តើមសម្រាប់ការវាស់ទីបី។
 - បន្ទាប់ពីមួយនាទី ការវាស់ដែងទីចាប់ផ្តើម។
 - នៅពេលដែលការវាស់បានបញ្ចប់
ការអារេជាមួយនៃការវាស់ទាំងបីគ្រូរបានបង្ហាញ
និងក្សាងទុកក្សុងអង្គចងចាំ។
- ចំណាំ៖**
- អំឡុងពេលវាស់ មុខងារ TriCheck™
នឹងបង្ហាញឡើង។
 - ដើម្បីលូបចេលការវាស់ ស្វែងចូចចូច **START**។
ក្តុងករណីនេះ មិនមានទិន្នន័យគ្រូរបានក្សាងទុកក្សុង
អង្គចងចាំទេ។
 - នៅពេលដែលនិមិត្តសញ្ញាបញ្ចាក់ពីបញ្ហាបែស់ភាពណែន
ឲ្យរបស់ប្រជាប់រុញលេចឡើង អំឡុងពេលវាស់ដំបូង
ស្វែងលូបចេលការវាស់
ស្វែងជាក់ប្រជាប់រុញបានត្រឹមគ្រូឡើងវិញ
ហើយចាប់ផ្តើមការវាស់ជាមួយ។
 - បន្ទាប់ពីវាស់រួច ទិន្នន័យជាមួយនៃការវាស់ទាំងបីគ្រូរបានក្សាងទុកក្សុងអង្គចងចាំ។
មិនមានទិន្នន័យនឹងគ្រូរបានក្សាងទុកទេ នៅពេលលូបចេលការវាស់ មុនពេលបញ្ចប់ការវាស់ទីបី។

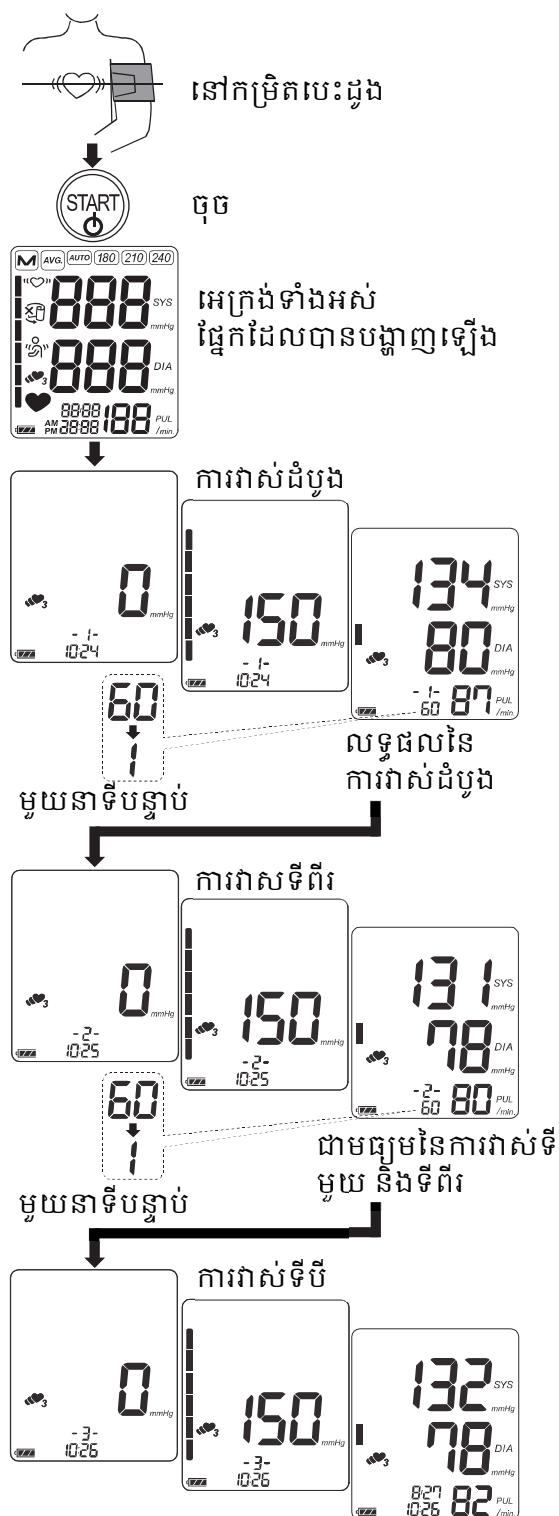

ការរំលើកទិន្នន័យអង្គចងចាំ

ចំណាំ ឧបករណ៍នេះរក្សាទុកការវារស់ចុងក្រោម 90 ដងក្នុងអង្គចងចាំ។

- ចូចចូចតួនាផ្លូវ ▲ ឬ ▼ ។
មធ្យមនៃការវារស់ទាំងអស់នឹងចំនួនទិន្នន័យត្រូវបានបង្ហាញ។ (ប្រសិនបើគ្មានទិន្នន័យទៅ “0” ត្រូវបានបង្ហាញ។) ចូចចូចតួនាផ្លូវ ▲, ▼ ឬ START ដើម្បីបិទឧបករណ៍។
- ភាល់ពេលដែលប្រើតួនាផ្លូវ ▼ (ប្រើតួនាផ្លូវ ▲ ដើម្បីបង្ហាញទិន្នន័យអង្គចងចាំត្រូវបានបង្ហាញជាប់បញ្ជាស) ត្រូវបានចូចទិន្នន័យអង្គចងចាំត្រូវបានបង្ហាញជាប់បញ្ជាស។
ពម្ពមធ្យមនៃការវារស់ AM (ពេលព្រឹក) ទាំងអស់ ដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពេល 4:00 ដល់ 9:59។ (នៅក្នុងខែបានការវារស់ 10 ដង។ ប្រសិនបើគ្មានទិន្នន័យទៅ “--” ត្រូវបានបង្ហាញ។)
កម្រិតមធ្យមនៃការវារស់ PM (ពេលល្ងាច) ទាំងអស់ ដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពេល 18:00 ដល់ 1:59។ (នៅក្នុងខែបានការវារស់ 9 ដង។ ប្រសិនបើគ្មានទិន្នន័យទៅ “--” ត្រូវបានបង្ហាញ។)
ទិន្នន័យចុងក្រោមបំផុត (No.n ក្នុងខែបានការវារស់ លេខ 35)
បីនាទីបន្ទាប់ពីការបង្ហាញលេខទិន្នន័យទិន្នន័យការវារស់ត្រូវបានបង្ហាញ។
⋮
ទិន្នន័យចុងក្រោម (លេខ 1)
បីនាទីបន្ទាប់ពីការបង្ហាញលេខទិន្នន័យទិន្នន័យការវារស់ត្រូវបានបង្ហាញ។
- បន្ទាប់ពីទិន្នន័យត្រូវបានបង្ហាញ សូមចូចប្រើតួនាផ្លូវ ▼ ។
ដើម្បីត្រួតឱ្យបានបង្ហាញមធ្យមនៃការវារស់ទាំងអស់។
- ចូចចូចតួនាផ្លូវ START ដើម្បីបិទឧបករណ៍។
បន្ទាប់ពីមួយនាទីនៃការមិនដំណើរការ ឧបករណ៍នឹងបិទដោយស្ម័យប្រភូត។



តើអ្វីទៅជាសុចនាករ IHB/AFib?

នៅពេលដែលមីនីទៅរកយើងឡាតាំងមិនទោះទាត់ក្នុងកំឡុងពេលធ្វើពេស្ត់ IHB/AFib
នឹងបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ជាមួយនឹងតម្លៃការភោស់។


ចំណាំ៖ យើងណែនាំឱ្យទាក់ទងគ្រែឡូបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកយើង (♥) សុចនាករ
IHB/AFib នេះជាត្រីកញ្ញាប់។

តើ AFib គឺជាអ្វី?

បែងចុះក្រោមក្នុងដោយសារសព្វាមីតិ៍សនិ៍ កៅតិ៍ឡើងក្នុងបែងចុះក្រោម ហើយបញ្ជានិយាយតាមរាយការ។
ការក្រោមក្នុងដែលបានបង្ហាញឡើង (AFib)
កៅតិ៍ឡើងនៅពេលដែលសព្វាមីតិ៍គ្រឿងនៅក្នុងបន្ទប់ប្រមុះមានភាពប្រុកប្រល័យ
និងនាំឱ្យមានការខាននៅក្នុងចន្ទោះប្រហោងដីចោរា ដីនី AFib
អាចបណ្តាលឈាយឈាយនៅជាប់ក្នុងបែងចុះក្រោម
ដែលបានបង្ហាញឡើងបានបង្ហាញបានបញ្ជាផ្ទាល់សម្រាប់សរស់សម្រាប់ការគំនិងបែងចុះក្រោម

សុចនាកររបាយសម្រាប់


សុចនាករគ្រឿងពិនិត្យខ្សោនភាពនៃសម្បាងអំឡុងពេលភស់។

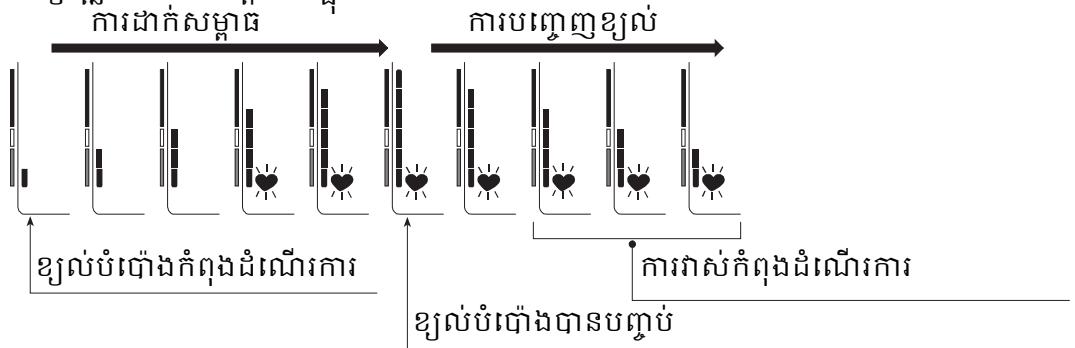

សូចនាករចំណាត់ថ្នាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក

ផ្លូវកន្លឹមយុទ្ធសាស្ត្រនៃសូចនាករបារគ្រែគ្មាននៅក្នុងបន្ទាន់សម្រាប់
ឈាមរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក
ដើម្បីជួយបានពាណាននៅទីតាំងរបស់ខ្លួន។

សូចនាករចំណាត់ថ្នាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក

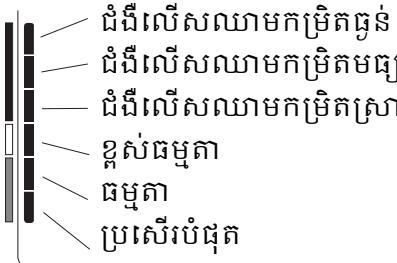

- សូចនាករបង្ហាញផ្លូវកន្លឹម
ដែលបានបង្ហាញផ្លូវកន្លឹមរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក។

ឧទាហរណ៍



ជំនួយលេបីសុលម្យកម្រិតមធ្យម



ជំនួយលេបីសុលម្យកម្រិតស្រាល



ជំនួយលេបីសុលម្យកម្រិតស្រាល

អំពីសម្ងាត់ធាយម

ເຕີສມ້າຜົດຍາມຕື່ອາກູ້?

សម្ងាត់ធម្មាម តើជាកម្មានំដិលបញ្ហាចោយធម្មាម ប្រាំងទល់នឹងជញ្ជាំងសរសើរ។
សម្ងាត់សុំស្សីលីក កើតឡើងនៅពេលបេះដួងក្រោកកំ។ សម្ងាត់ធម្មាម ឱ្យអាស្សីលីក
កើតឡើងនៅពេលដិលបេះដួងវិក។ សម្ងាត់ធម្មាមត្រូវបានភាគជាមីលីម៉ែត្រនៃបាន់ត (mmHg)។
សម្ងាត់ធម្មាមធ្លាបាតិរបស់មនុស្សម្មាកំត្រូវបានកំណត់ដោយសម្ងាត់មួលដ្ឋានដិលត្រូវបានភាគកំ
ប្រិតជំបួននៅពេលព្រឹកខណ្ឌ៖ដិលមិនទាន់ឡើក និងមួនពេលញា។

តើការលើសល្មាមគីបីអូហ៊ីយេតីវគ្គទានត្រប់ត្រង់ដោយរៀបណា?


សម្ងាត់រួសយាមខ្ពស់ និងជម្រើនបានយកចិត្តទុកដាក់ទេ អាចបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាសុខភាពជាថ្វីនដូចជាដីជីសិល្បៈរួសយាមខ្ពស់រក្សាល និងជីគីតាំងបែងជីវិះជីវិះ។ ការលើសយាមអាចត្រូវបានត្រូវប៉ុងប៉ុងដោយការផ្តល់បញ្ជីសំណង់ពាណិជ្ជការ និងជីវិះជីវិះ។ ជាមួយនឹងថ្មាំដែលស្ថិតិក្រោមការត្រូវតិន្នន័យបស់ផ្សេងបណ្តិតាំង ដើម្បីបង្ហាញការលើសយាមប្រកាសក្នុងការត្រូវប៉ុងប៉ុង។

- កំដកតារី
 - ភាគតែបន្ទយការព្យាមសិលនិជ្ជាប្បា
 - រក្សាទម្រន់សមរម្យ
 - ហាត់ប្រាងទេរងទាត់
 - មានការពិនិត្យការងារយកទេរងទាត់

ហេតុអ្នកបានត្រូវរាស់សម្ងាត់យោមនៅផ្លូវ?


សម្ងាត់ធម្មាយមធ្យេសកំណត់នឹងកប្បាហរិយាល័យដៃបណ្ឌិតអាចបង្កើមនករកឲយខ្សាចហើយអាចបង្កើមនកពី 25 ទៅ 30 mmHg ខ្លួនដែលបានកស់នៅផ្លូវ។
ការរកស់ដៃបន្ទុយជលប៉ះពាល់ពីតម្លៃទលខាងក្រោមឡើការអារ៉ាសម្ងាត់ធម្មាយ,
បន្ទាន់ការធ្វើគេស្ថុរបស់ដៃបណ្ឌិតនិងផ្លូវប្រភេទធនាព្យុសម្ងាត់ធម្មាយកាន់តែត្រីមត្រី
និងពេញលេញ។

ការបែងចែកសម្ងាត់ឈាមរបស់អង្គភាព
សុខភាពពិភពលោក
បទនានាដើម្បីរាយតម្លៃពីសម្ងាត់ឈាមផ្តល់
ដោយមិនគឺតិតិកាយត្រូវបានបង្កើតឡើង
ដោយអង្គភាពសុខភាពពិភពលោក (WHO)
ជូចដែលបានបង្ហាញនៅលើ
តារាង។

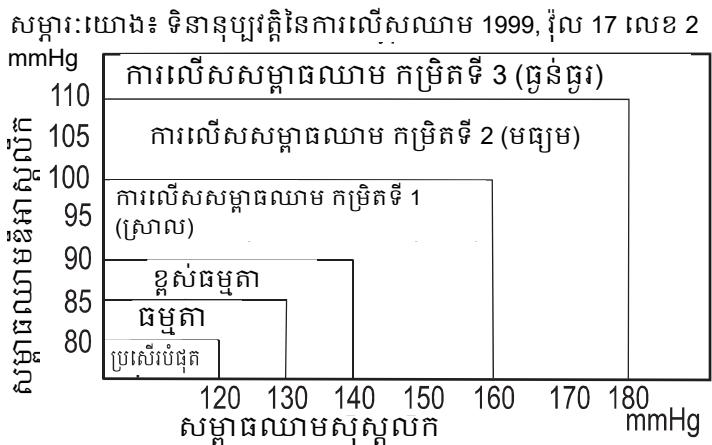

ការប្រើប្រាលសម្ងាត់យោម

សម្ងាត់យោមរបស់បុគ្គលម្នាក់ទាំងប្រើប្រាលយកឯងខ្សោះតាមមួលដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃនិងតាមរៀបរាប់។ ការប្រើប្រាល 30 ទៅ 50 mmHg ដោយសារពេលភូមិខ្លួនដូចជាអ្នកកំឡុងពេលថ្ងៃ។ នៅក្នុងការប្រើប្រាលរបស់បុគ្គលដើលមានសម្ងាត់យោមខ្ពស់តីមានភាពឆ្លាស់។ ជាងមួលតាមសម្ងាត់យោមកំឡុងពេលថ្ងៃនៅពេលធ្វើការប្រើប្រាលយកឯងខ្សោះដែលកំណត់ឡើងនៅពេលថ្ងៃ។ ដូច្នេះ សូមកំបានអំពីលទ្ធផលនៃការរាយការណ៍ដែលកំណត់ឡើងនៅពេលថ្ងៃ។ ការរាយការណ៍ដែលកំណត់ឡើងនៅពេលថ្ងៃមួលដ្ឋានតិចជាថាននៅក្នុងស្រីរកោត ដើម្បីដើរការណ៍ដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងស្រីរកោត ដើម្បីដើរការណ៍ដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងស្រីរកោត។ ការរាយការណ៍ដែលកំណត់ឡើងនៅពេលថ្ងៃនៅពេលថ្ងៃនៅក្នុងស្រីរកោត ដើម្បីដើរការណ៍ដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងស្រីរកោត។ ការប្រើប្រាលសម្ងាត់យោមរបស់អ្នក។ ពិគ្រោះជាមួលប្រើប្រាលនៅក្នុងស្រីរកោត។

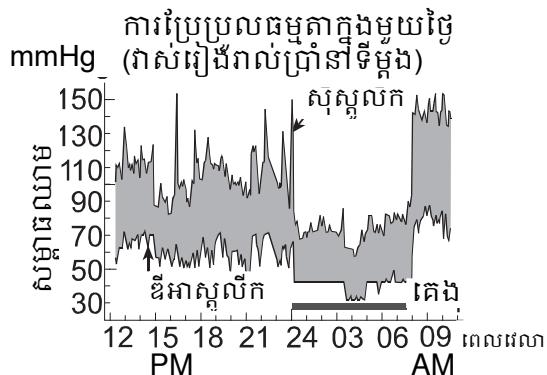

ការដោះស្រាយបញ្ហា

បញ្ហា	ហេតុផលដើលអាមេរិក	សកម្មភាពដើលបានណោនាំ
មិនមានអ្នកប្រើប្រាលឡើង នៅលើអេក្រង់នោះទេ សូមឱ្យតែនៅពេលបើកខាងក្រោម	មួលត្រូវបានបង្កើរា មួលស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងត្រឹមត្រូវទេ។	បូរុមុទំនៃដោយមួលត្រូវ។
ប្រជាប់រីនិង មិនបានពេញចំឡេ។	រូបមួលទេកា (សញ្ញាសម្ងាត់មួលខ្សោយ) លោកស្រីប៊ូតោ ប្រសិនបើមួលត្រូវបានបង្កើរទាំងប្រុង សញ្ញាមិនបានលេចឡើងទេ។	បូរុមុទំនៃដោយមួលត្រូវ។
ឧបករណ៍មិនភស់។ ការរាយការតីខ្ពស់ពេលបុគ្គលទេ	ជាក់ប្រជាប់រីនិងមិនត្រឹមត្រូវ។ អ្នកបានកំណើកដែល បុកកំណើកការយបស់អ្នកអំឡុងពេលវាស់។	ជាក់ប្រជាប់រីនិងប្រើប្រាលត្រឹមត្រូវ។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នក នៅស្ថាត់ស្រែមបំងុកពេលកំពុងវាស់។
_____	ទីតាំងប្រជាប់រីនិងមិនត្រឹមត្រូវ។	អង្គុយមានភាពងាយស្រួលនិងនៅនឹង ស្រីម។ ជាក់ដែលបស់អ្នកនៅលើគុម្ភយដោយបានដើរបស់អ្នករូបឡើងលើនិងប្រជាប់រីនិង នៅក្នុងក្រុងការកំណត់សម្ងាត់យោម របស់អ្នក។

បញ្ហា	ហេតុផលដែលអាចមាន	សកម្មភាពដែលបានណែនាំ
ផ្សេងៗទៀត	តម្លៃខុសត្រូវពីការរាស់នៅនៅត្រឹមត្រូវ ការិយាល័យដែលបណ្តិត។ _____	សូមមើល “ហេតុផលបានត្រូវរាស់សម្រាប់មាមពេលខ្លះ?”។ ដោះស្រាយច្បាប់ ដាក់ការត្រួតពិនិត្យការបង្កើតដែលបានត្រូវ។ រចបៀយសាកល្បងរាស់ មួយទៀត។

ចំណាំ៖ ប្រសិនបើសកម្មភាពដែលបានពិពណ៌នាទាងលើមិនដោះស្រាយបញ្ហា សូមទាក់ទងអ្នកលក់។
កំព្យូយាមបើក ឬដឹងសម្រាប់មិនដែលបានត្រូវ។
ព្រមទាំងបង្កើតច្បាប់នឹងត្រូវការធានាបែលៗអ្នកមិនត្រូវ។

ការថែទាំ

ក្នុងក្រុងបញ្ហាដែលបានបង្កើតឡើង នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រើប្រាស់ការត្រូវ។
ក្នុងក្រុងបញ្ហាដែលបានបង្កើតឡើង នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រើប្រាស់ការត្រូវ។
ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចបង្កើតឡើងបាន នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រើប្រាស់ការត្រូវ។
ក្នុងក្រុងបញ្ហាដែលបានបង្កើតឡើង នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រើប្រាស់ការត្រូវ។
ក្នុងក្រុងបញ្ហាដែលបានបង្កើតឡើង នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រើប្រាស់ការត្រូវ។
ក្នុងក្រុងបញ្ហាដែលបានបង្កើតឡើង នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រើប្រាស់ការត្រូវ។
ក្នុងក្រុងបញ្ហាដែលបានបង្កើតឡើង នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រើប្រាស់ការត្រូវ។

ឧបករណ៍នេះត្រូវបានចែកជាអ្នកប្រើប្រាស់បានយុទ្ធសាស្ត្រ។
គោលការណ៍នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រើប្រាស់ការត្រូវ។
ដើម្បីបានបង្កើតឡើង នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រើប្រាស់ការត្រូវ។
ដើម្បីបានបង្កើតឡើង នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រើប្រាស់ការត្រូវ។
ដើម្បីបានបង្កើតឡើង នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រើប្រាស់ការត្រូវ។

ទិន្នន័យបច្ចេកទេស

ប្រភេទ	UA-1020
វិធីរាស់	ការរាស់ស្វ័យប័ណ្ណ
លំដាប់ការរាស់	សម្រាប់ 0-299 mmHg សម្រាប់សុស្សលីក៖ 60 - 279 mmHg សម្រាប់អាស្សូលីក៖ 40 - 200 mmHg ដីចច់៖ 40 – 180 ដង / នាទី
សុវត្ថិភាពនៃការរាស់	សម្រាប់ ±3 mmHg ដីចច់៖ ±5 %
ការរាយតម្លៃ	DC 6V 3W

ការផ្តត់ផ្តច់បាមពល		ធ្វើ 4 x 1,5V (R6P, LR6 ឬ AA) ប្រអាណាប័ទ្ធខ្សែសម្រាប់ការងារ អាជាប់ទៀត AC (TB-233C ធានាចូលទៅ AC 100 – 240V 50 / 60 Hz 0,15A) (មិនរួមបញ្ចូល)
ចំនួនការវាយសំណង់		ប្រហែល ការវាយសំណង់ 1.000 នៃពេលដែលប្រើបានការងារ AA ត្រូវបានប្រើបាយនឹងតម្លៃសម្ងាត់ 180 mmHg នៃសីគុណភាព 23 អង្វាស់។
ការចាត់ខ្លាក់		ផ្តល់បាមពលខាងក្រុងដល់គ្រឿងបរិភោជ្រឈាន ME (ផ្តត់ផ្តច់ដោយផ្ទុក) ខ្លាក់ II (ផ្តត់ផ្តច់ដោយអាជាប់ទៀត) មុនការប្រព័ន្ធបានរាយការពាណិជ្ជកម្ម
ការធ្វើតេសត្តិនិក		នៅក្នុងការសិក្សាអំពីសុពលភាពត្តិនិក, K5 ត្រូវបានគេប្រើបាយនឹងតម្លៃសម្ងាត់ 85 សម្រាប់ការកំណត់សម្ងាត់សម្រាប់ការងារ។
EMD		IEC 60601-1-2: 2014
អង្គចងចាំ		ការវាយសំណង់ 90 ដងក្នុងក្រោយ
លក្ខខណ្ឌប្រព័ន្ធបានរាយការ		+10 to +40 °C / 15 ទៅ 85 %RH / 800 to 1.060 hPa
លក្ខខណ្ឌដីកដាក់		
ការក្រឡាងក		-20 to +60 °C / 10 ទៅ 95 %RH / 700 to 1.060 hPa
ខ្លាត		ប្រហែល 140 [W] x 60 [H] x 105 [D] mm
ទំនួន		ប្រហែល 285 ក្រាម, មិនកាប់បញ្ចូលមុខទេ
ការការពារជ្រមុជីក		ឧបករណ៍: IP20
ផ្ទៃកន្លែង		ប្រជាប់រឿង ប្រភេទ BF ដែលបានប្រើ 
ដើរិតមានប្រយោជន៍		ឧបករណ៍: 5 ឆ្នាំ (ប្រសិនបើប្រើបាយ 6 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ) ប្រជាប់រឿង: 2 ឆ្នាំ (ប្រសិនបើប្រើបាយជាក្នុងមួយថ្ងៃ) អាជាប់ទៀត AC: 5 ឆ្នាំ (ប្រសិនបើប្រើបាយជាក្នុងមួយថ្ងៃ)
អាជាប់ទៀត AC		
គ្រឿងបន្ទាប់បន្ទំ	TB-233C	អាជាប់ទៀត តើដើរិតមួយក្នុងមួយថ្ងៃនៃការសំណង់សម្ងាត់សម្រាប់ការងារ។ សូមទាក់ទងមកអ្នកចែកចាយ A&D ក្នុងតំបន់របស់អ្នកសម្រាប់ការទិញ។ តម្រូវការប្រើបាយតិន្នន័យ ប្រចាំថ្ងៃអាជាប់ទៀត AC ដាច់ឡើងទាក់។

និមិត្តសញ្ញាណិលត្របានពោះពុម្ពនៅលើអាម័រទេរ AC

និមិត្តសញ្ញា	មុខងារ / អត្ថនឹយ
	សម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ក្នុងអគារទៅបុណ្យ។
	ខែករណ៍ផ្ទាក់ទី ॥
	ហ្វួយហ្វួយបកឡូ
	ហ្វួយហ្វួយប
	ស្ថាកសញ្ញាលេចធីណែនាំអំពីខែករណ៍របស់ EC
	ស្ថាកបញ្ហាក់របស់ខែករណ៍ស្តីពី EAC
	ប៉ូលនៃខ្សោយដោតអាម័រទេរ AC

ក្រឹងបញ្ជាប់ស្ថិត្របានលក់ដោយខ្សោយទេរកតិត្យ
ប្រជាប់វិដេ

លេខការាណុក	ទំហំប្រជាប់វិដេ	ទំហំដេ
CUF-D-LA-ISO	ប្រជាប់វិដេទំហំដែលសម្រាប់មនុស្សពេញវេយ	31 សម ទៅ 45 សម
CUF-I-ISO	ប្រជាប់វិដេទំហំដែង	22 សម ទៅ 42 សម
CUF-D-MA-ISO	ប្រជាប់វិដេទំហំលួម	23 សម ទៅ 37 សម
CUF-F-A-ISO	ប្រជាប់វិដេសម្រាប់មនុស្សពេញវេយ	22 សម ទៅ 32 សម
CUF-D-SA-ISO	ប្រជាប់វិត្សិច	16 សម ទៅ 24 សម
CUF-G-A-ISO	ប្រជាប់វិសម្រាប់មនុស្សពេញវេយ SmoothFit	17 cm ទៅ 32 cm

អាម័រទេរ AC

លេខការាណុក	ខ្សោយដោត (ប្រភេទព្រឹងដោត)
TB-233C	ប្រភេទ C

ចំណាំ: លក្ខណៈបច្ចេកទេសអាចផ្តល់បញ្ជីបានបានបានបានបាន។

ការបែងចែក IP គឺជាដីក្រនៃការការពារដែលផ្តល់ជូនដោយឯកសារបាម IEC 60529 ។

ខែករណ៍នេះត្រូវបានការពារប្រចាំឆ្នាំនិងវគ្គធនីនមំនៅអង្គភាព 12 មមនិងជំនាញផ្ទុចជាម្រាមនៅ។
ខែករណ៍នេះមិនត្រូវបានការពារទៅទេប៉ុណ្ណោះទៀត។

ກຳណາດໍ່ເບາດຸ

Mga Nilalaman

Minamahal na Mga Customer	2
Mga Paunang Puna	2
Mga Pag-iingat	2
Mga Kontraindikasyon	3
Pagtukoy sa Mga Piyesa.....	4
Mga simbolo.....	5
Operation Mode.....	7
Paggamit sa Monitor.....	8
Pagkabit / Pagpalit ng Mga Bateria	8
Pagkabit sa Hose ng Hangin	9
Pagkabit sa AC Adapter	9
Pag-adjust sa Built-in na Orasan.....	10
Papgili sa Wastong Laki ng Cuff.....	11
Paglapat ng Cuff sa Braso	11
Paano Kumuha ng Mga Tumpak na Pagsukat	12
Pagsukat.....	12
Pagkatapos ng Pagsukat	12
Mga Pagsukat	13
Normal na Pagsukat	13
Pagsukat gamit ang NAKA-SET na Presyon	14
Pagsukat na may Ninanais na Systolic na Presyon	15
Mga Paalala para sa Tumpak na Pagsukat	15
TriCheck™ na Pagsukat.....	16
Pag-recall sa Data ng Memory.....	18
Ano ang Indicator ng IHB/AFib?.....	19
Ano Ang AFib?	19
Indicator ng Pressure Bar.....	19
Indicator ng Klasipikasyon ng WHO	19
Tungkol sa Presyon ng Dugo.....	20
Ano ang Presyon ng Dugo?.....	20
Ano ang Alta-presyon (Hypertension) at Paano ito Kinokontrol?.....	20
Bakit Dapat Magsukat ng Presyon ng Dugo sa Tahanan? ..	20
Klasipikasyon ng WHO sa Presyon ng Dugo	20
Mga Pagkakaiba-iba ng Presyon ng Dugo.....	21
Pag-troubleshoot	22
Pagmamantini.....	23
Teknikal na Data	23

Minamahal na Mga Customer

Binabati ka namin sa pagbili mo ng pinakamakabagong A&D monitor ng presyon ng dugo. Idinisено para sa dali ng paggamit at katumpakan, magbibigay-daan ang device na ito sa pang-araw-araw mong regimen sa presyon ng dugo.

Inirerekomenda naming basahin nang mabuti ang manwal na ito bago gamitin ang device sa unang pagkakataon.

Mga Paunang Puna

- Idinisено ang device para gamitin ng mga nasa hustong gulang (mga adult), hindi ng mga bagong silang o sanggol.
- Kaligiran na paggagamitan. Ikaw ang gagamit sa device sa kaligiran sa pangangalaga ng kalusugan sa tahanan.
- Idinisено ang device na ito para sukatin ang presyon ng dugo at bilis ng pulso ng mga tao para sa diagnosis.

Mga Pag-iingat


- Mga presiyon na piyesa ang ginamit sa pagbuo ng device na ito. Dapat iwasan ang mga kalabisan sa temperatura, halumigmig, direktang sikat ng araw, pagkabagsak o alikabok.
- Linisin ang device at cuff gamit ang tuyos, at malambot na tela o telang binasa ng tubig at sabon na neutral ang pH. Huwag kailanman gagamit ng alcohol, benzene, thinner o matatapang na kemikal para linisin ang device o cuff.
- Iwasan na tupiin nang mahigpit ang cuff o itago ang hose na mahigpit ang pagkakapulupot nang matagal na panahon, mapapaikli ng ganitong paggamit ang buhay ng mga piyesa nito.
- Mag-ingat para maiwasan ang di-sadyang pagkakasakal ng mga sanggol sa hose at kawad.
- Huwag pipilipitin ang hose ng hangin habang pagsukat. Maaari itong magdulot ng pinsala dahil sa tuloy-tuloy na presyon ng cuff.
- Hindi water resistant (hindi nababasa) ang device at cuff. Iwasan na marumihan ng ulan, pawis at tubig ang device at cuff.
- Maaaring hindi maging tumpak ang mga pagsukat kung ginagamit ang device malapit sa mga telebisyon, microwave oven, cellular phone, X-ray o iba pang mga device na may malakas na electrical field.
- Makakaapekto sa monitor ng presyon ng dugo na ito ang mga device ng wireless na komunikasyon, gaya ng mga networking device sa tahanan, mobile phone, cordless phone at mga base station nito ito, at mga walkie-talkie. Kaya, dapat na magpanatili ng minimum na distansya na 30 cm mula sa mga naturang device.
- Hindi itinuturing na karaniwang basura ng bahay ang mga gamit-nang kagamitan, mga piyesa at mga baterya, at dapat na itapon alinsunod sa mga umiiral na lokal na regulasyon.
- Kapag ginagamit ang AC adapter, tiyakin na madaling mahuhugot ang AC adapter mula sa saksakan ng kuryente kung kinakailangan.
- Kapag ginagamit muli ang device, kumpirmahin na malinis ang device.

- Huwag gagawa ng pagbabago sa device. Maaari itong magdulot ng mga aksidente o pagkasira ng device.
- Para sukatin ang presyon ng dugo, dapat na sapat na mapisil ng cuff ang braso para pansamantalang mahinto ang daloy ng dugo sa artery. Maaari itong magdulot ng pananakit, pamamanhid o pansamantalang pulang marka sa braso. Lilitaw ang kondisyon na ito lalo na kung sunod-sunod ang pag-ulit sa pagsukat.
Mawawala ang anumang pananakit, pamamanhid, o pamumula sa kalaunan.
- Maaaring magdulot ng pinsala sa interference ng daloy ng dugo ang masyadong madalas na pagsusukat ng presyon ng dugo. Tingnan na hindi magreresulta ang paggamit sa device sa matagal na pagpigel sa sirkulasyon ng dugo, kapag ginagamit nang paulit-ulit ang device.
- Hindi pa nagsasagawa ng klinikal na pagsubok sa mga bagong silang na sanggol at mga babaeng nagbubuntis. Huwag gagamitin sa mga bagong silang na sanggol o sa mga babaeng nagbubuntis.
- Kung sumailalim ka sa mastectomy, kumonsulta sa isang doktor bago gamitin ang device.
- Huwag payagan na gamitin ng mga bata ang device nang sila-sila lang at huwag gagamitin ang device sa lugar na naaabet ng mga sanggol. Maaari itong magdulot ng mga aksidente o pagkasira.
- Mayroong maliliit na piyesa na maaaring magdulot ng pagkakabulon kung aksidenteng malunon ng mga sanggol.
- Huwag hahawakan ang mga bateria, ang DC jack, at pasyente nang magkasabay. Maaari itong mauwi sa pagkakuryente.
- Hugutin ang AC adapter kapag hindi ginagamit habang pagsukat.
- Maaaring makakompromiso sa kaligtasan ang paggamit ng mga aksesorya na hindi nakadetalye sa manwal na ito.
- Sakaling mag-short-circuit ang bateria, maaaring uminit ito at posibleng magdulot ng pagkakapaso.
- Hayaang umakma ang device sa paligid nito bago gamitin (mga isang oras).
- Huwag magkarga ng hangin nang hindi ibinabalot ang cuff sa braso.



Mga Kontraindikasyon

- Ang mga sumusunod ay mga pag-iingat para sa wastong paggamit ng device.
- Huwag ilalapat ang cuff sa braso na may nakakabit na ibang Pangmedikal na De-kuryenteng Kagamitan. Maaaring hindi gumana nang waste ang kagamitan.
 - Dapat kumonsulta sa doktor ang mga taong may malubhang kakulangan sa sirkulasyon sa braso bago gamitin ang device, para maiwasan ang mga problemang medikal.
 - Huwag i-self diagnose ang mga resulta ng pagsukat at i-start ang sariling paggamot. Laging kumonsulta sa doktor mo para sa pagtatasa ng mga resulta at paggagamot.
 - Huwag ilalapat ang cuff sa braso na may hindi pa gumagaling na sugat.
 - Huwag ilalapat ang cuff sa braso na tumatanggap ng intravenous drip o pagsasalin ng dugo. Maaari itong magdulot ng pinsala o mga aksidente.
 - Huwag gagamitin ang device kung saan mayroong mga nagliliyab na gas gaya ng mga anesthetic gas. Maaari itong magdulot ng pagsabog.
 - Huwag gagamitin ang device sa mga lugar na mataas ang konsentrasyon ng oxygen, gaya ng high-pressure oxygen chamber o oxygen tent. Maaari itong magdulot ng sunog o pagsabog.


Pagtukoy sa Mga Piyesa

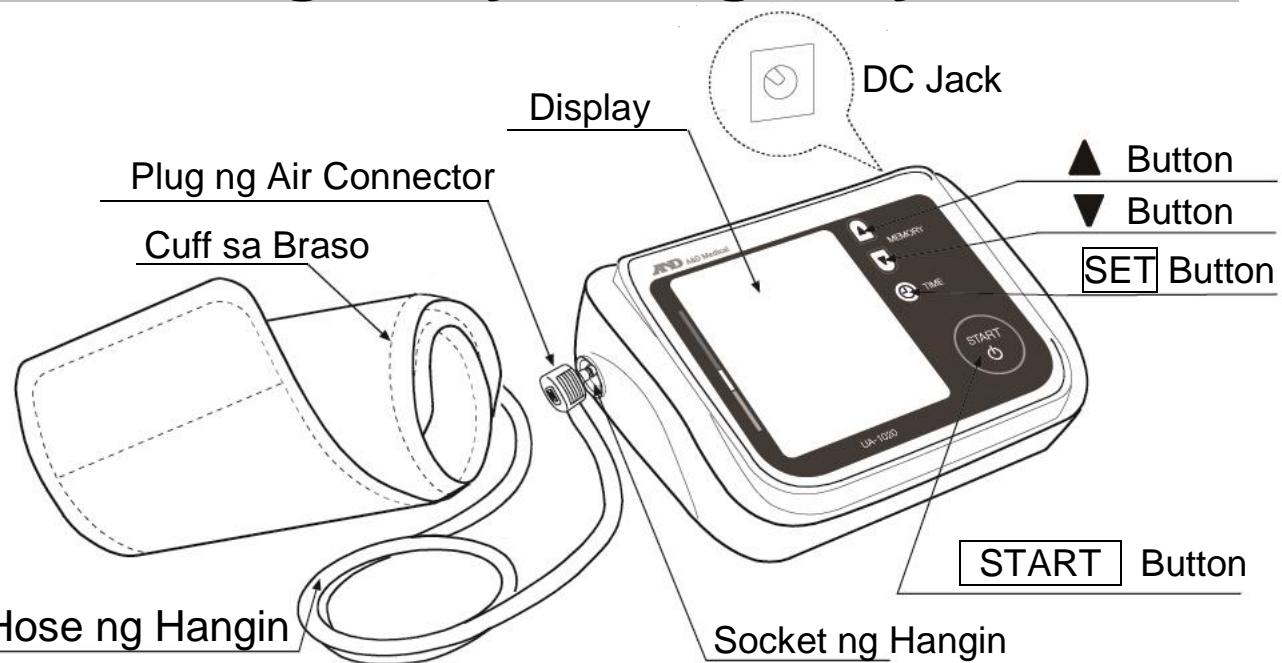

Sisidlan ng Baterya

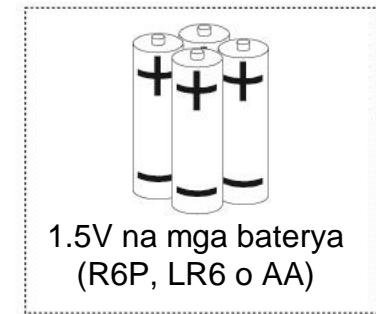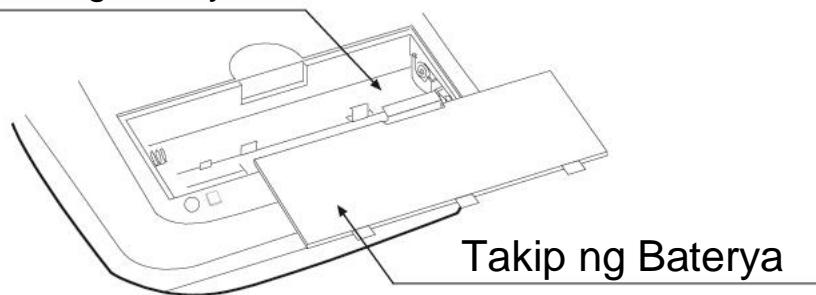

Display

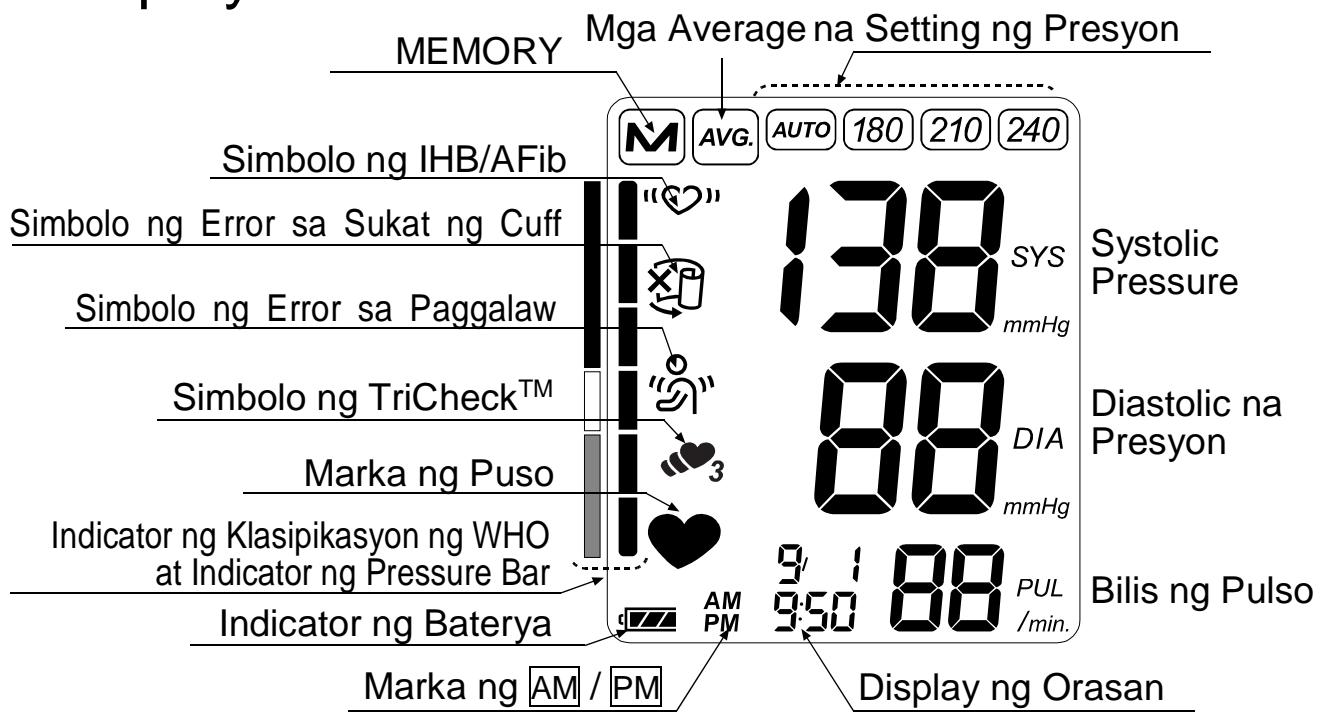

Mga simbolo

Mga simbolo na naka-print sa kaha ng device

Mga simbolo	Function / Kahulugan
	Standby at I-on ang device.
	Gabay sa pagkabit ng baterya
	Direct current
SN	Serial number
	Nag-manufacture
2020	Petsa ng pag-manufacture
	Type BF: Idiniseno ang cuff na magbigay ng espesyal na proteksyon laban sa mga pagkakuryente.
	Hindi itinuturing na karaniwang basura ng bahay ang mga gamit-nang kagamitan, mga piyesa at mga baterya, at dapat na itapon alinsunod sa mga umiiral na lokal na regulasyon.
	Sumangguni sa manwal / librito ng mga tagubilin
	Polarity ng DC jack
IP	Simbolo ng internasyonal na proteksyon
	Panatilihing tuyo

Mga simbolo na lumilitaw sa display

Mga simbolo	Function / Kahulugan	Inirerekomendang Aksiyon
	Lumilitaw habang may ginagawang pagsukat. Kumukurap ito kapag may nadetektang pulso.	May ginagawang pagsukat. Manatiling hindi kumikilos hangga't maaari.
	Simbolo ng IHB/AFib Lumilitaw kapag may nadetektang hindi regular na pagtibok ng puso. Maaari itong umilaw kapag may nadetektang napakahinang pagnginig gaya ng pangingilig o pangangatog.	_____
	TriCheck™ mode Awtomatikong kumuha ng tatlong magkakasunod na pagsukat at ipinapakita ang mga average na halaga ng tatlong pagsukat.	_____
	Lumilitaw kapag may nadetektang pagkilos ng katawan o braso.	Maaaring mali ang ibibigay na basa. Subukang muli ang pagsukat. Manatiling hindi kumikilos habang pagsukat.
	Lumilitaw habang pagsukat kapag maluwag ang pagkakasut sa cuff.	Maaaring mali ang ibibigay na basa. Ilapat nang wasto ang cuff, at subukang muli ang pagsukat.

Mga simbolo	Function / Kahulugan	Inirerekomendang Aksyon
	Naunang pagsukat na nakaimbak sa MEMORY.	_____
	Average na data	_____
	PUNO ANG BATERYA Ang indicator ng karga ng bateria habang pagsukat.	_____
	MAHINA ANG BATERYA Mahina na ang bateria kapag kumukurap ito.	Palitan ang lahat na mga bateria ng mga bago kapag kumukurap ang marka.
<i>Err</i>	Hindi matatag na presyon ng dugo dahil sa paggalaw habang pagsukat.	Subukang muli ang pagsukat. Manatiling hindi kumikilos habang pagsukat.
	Nasa 10 mmHg ang pagitan ng mga systolic at diastolic sa bawat isa.	Ilapat nang wasto ang cuff, at subukang muli ang pagsukat.
	Hindi tumaas ang halaga ng presyon habang pagkarga ng hangin.	
<i>Err</i> <i>CUF</i>	Hindi nailapat nang wasto ang cuff.	DISPLAY NG ERROR NG PUL Hindi nadetecta nang wasto ang pulso.
<i>E</i>	Internal na error ng monitor ng presyon ng dugo	
<i>Err</i> <i>E</i>	Alisin ang mga bateria at pindutin ang START button, at muling ikabit ang mga bateria. Kung patuloy na lumilitaw ang error, makipag-ugnayan sa dealer.	
SYS	Systolic na presyon ng dugo sa mmHg	_____
DIA	Diastolic na presyon ng dugo sa mmHg	_____
PUL	Pulso kada minuto	_____
AM	Lumilitaw kapag ipinapakita ang average na data. Kinuha ang data sa pagitan ng 4:00 at 9:59	_____
PM	Lumilitaw kapag ipinapakita ang average na data. Kinuha ang data sa pagitan ng 18:00 at 1:59	_____
	Mga Setting ng Presyon Ipinababatid ang halaga ng presyon na unang sinet ng gumagamit.	_____

Operation Mode

1. Normal na Pagsukat

Pindutin ang **START** button. Sinusukat ang presyon ng dugo at ini-store ang data sa memory. Maiimbak ng device na ito ang huling 90 na pagsukat sa memory.

2. Pag-recall ng Data

Pindutin ang **▲** o **▼** button para i-recall ang data na nasa memory. Ipinapakita ang average ng lahat na pagsukat, ayon sa ipinababatid sa pigura sa kanan.

Pagkatapos, sa tuwing pipindutin ang **▼** button, ipapakita ang data ng memory gaya ng sumusunod.


Average ng lahat na AM (morning) na pagsukat sa pagitan ng 4:00 at 9:59.

Average ng lahat na PM (gabi) na pagsukat sa pagitan ng 18:00 at 1:59.

Pinakahuling data
(No.n, in the halimbawa, No.35)

Huling data (No.1)

Para sa mga detalye sa pag-recall ng data,
Sumangguni sa "Pag-recall sa Data ng Memory".

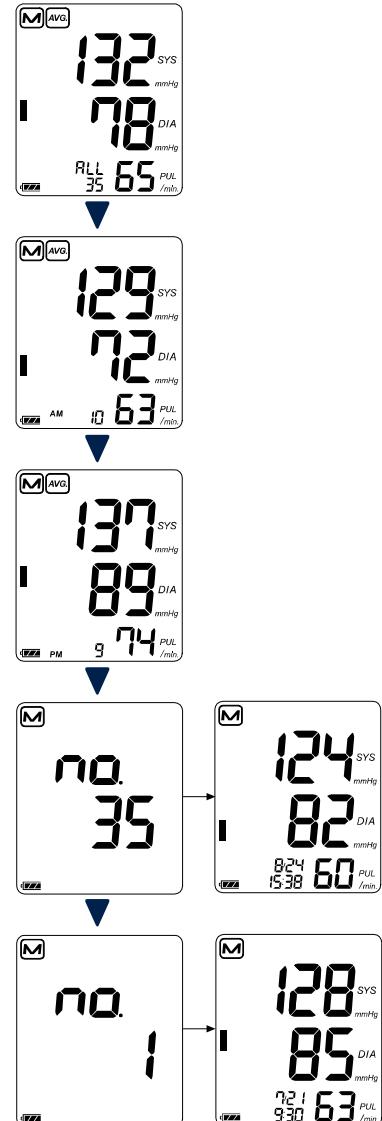

3. Pag-delete sa lahat ng Data na Nakaimbak sa Memory

Pindutin ang kapwa **▲** at **▼** button. Lilitaw ang markang **M** at indicator ng bateria. I-press and hold ang kapwa **▲** at **▼** button hanggang sa kumurap ang nakailaw na markang **M** para tanggalin ang lahat ng data na nakaimbak sa memory.




4. Pagsukat na may Ninanais na Systolic na Presyon

Sumangguni sa pahina 15 para sa pagsukat gamit ang ninanais na systolic na presyon.

Paggamit sa Monitor

Pagkabit / Pagpalit ng Mga Baterya

1. Alisin ang takip ng baterya.
2. Alisin ang mga gamit-nang baterya at ipasok ang mga baterya sa loob ng sisidlan ng baterya gaya ng ipinapakita, ingatan na wasto ang mga polarity (+ at -).
Gumamit ng R6P, LR6 o AA na mga baterya lang.
3. Ikabit ang takip ng baterya.

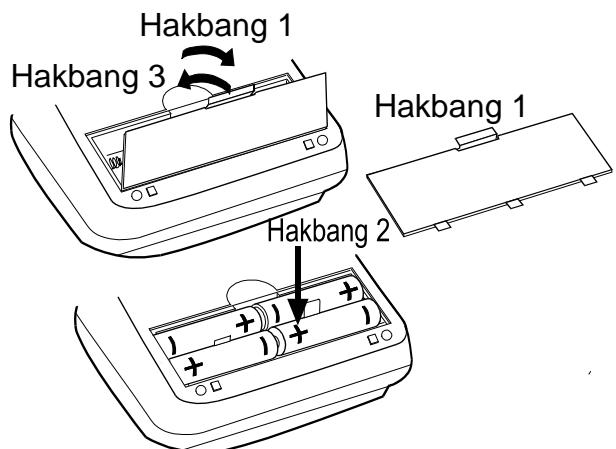


PAG-IINGAT

- Ipasok ang mga baterya gaya ng ipinapakita sa sisidlan ng baterya. Kung mali ang pagkakalagay, hindi gagana ang device.
- Kapag kumukurap ang (markang MAHINA ANG BATERYA) sa display, palitan ang lahat na mga baterya ng mga bago. Huwag pagsasamahin ang mga luma at bagong mga baterya. Maaaring umikli ang buhay ng baterya, o magdulot ng pagpalya ng device.
Palitan ang mga baterya dalawang segundo o higit pa pagkaraang mag-off ng device.
Kung lumitaw ang (markang MAHINA ANG BATERYA) kahit na bagong palit ang mga baterya, magsagawa ng pagsukat sa presyon ng dugo. Maaaring kilalanin na ng device ang bagong mga baterya.
- Hindi lumilitaw ang (markang MAHINA ANG BATERYA) kapag wala nang karga ang mga baterya.
- Nagiiba-iba ang haba ng buhay ng mga baterya kasabay ng temperatura ng paligid at maaaring mas maikli sa mga mababang temperatura. Sa kadalasan, tatagal ang apat na bagong LR6 mga baterya nang humigit-kumulang sa isang taon kapag ginagamit sa pagsukat nang dalawang beses sa bawat araw.
- Gamitin ang tinukoy na mga baterya lang. Ang mga baterya na kasama ng device ay para lang sa pagsubok sa paggana ng monitor at maaaring maikli lang ang buhay.
- Alisin ang mga baterya kung matagal na hindi gagamitin ang device.
Maaaring mag-leak ang mga baterya at magdulot ng pagpalya.

Paggamit sa Monitor

Pagkabit sa Hose ng Hangin

Ipasok nang mahigpit ang plug ng air connector sa socket ng hangin.

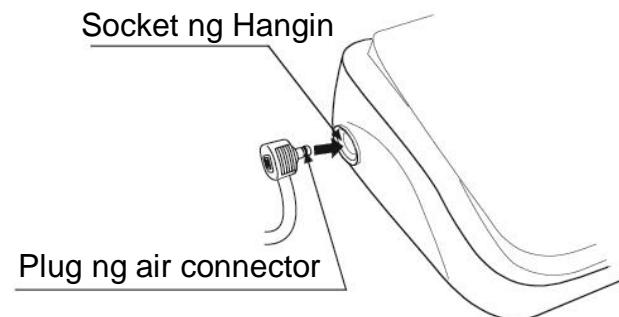


Pagkabit sa AC Adapter

Ipasok ang plug na AC adapter sa DC jack.

Susunod, ikabit ang AC adapter sa isang saksakan ng kuryente.

Plug na AC adapter



- Gamitin ang tinukoy na AC adapter.
(Sumangguni sa pahina 22.)
- Kapag hinuhugot ang AC adapter mula sa saksakan ng kuryente, hawakan at hatakin ang katawan ng AC adapter mula sa saksakan ng kuryente.
- Kapag hinuhugot ang plug na AC adapter mula sa monitor ng presyon ng dugo, hawakan at hatakin ang plug na AC adapter mula sa monitor.

Paggamit sa Monitor

Pag-adjust sa Built-in na Orasan

I-adjust ang orasan bago gamitin.

1. Pindutin ang **SET** button hanggang sa magsimulang kumurap ang taon.
2. Piliin ang taon gamit ang **▲** o **▼** button. Pindutin ang **SET** button para i-set ang kasalukuyang taon at lumipat sa pagpili ng buwan/araw. Maaaring i-set ang petsa saanman sa pagitan ng mga taon na 2010 at 2059.
3. Piliin ang buwan gamit ang **▲** o **▼** button. Pindutin ang **SET** button para i-set ang kasalukuyang buwan at lumipat sa pagpili ng araw.
4. Piliin ang araw gamit ang **▲** o **▼** button. Pindutin ang **SET** button para i-set ang kasalukuyang araw at lumipat sa pagpili ng oras/minuto.
5. Piliin ang oras gamit ang **▲** o **▼** button. Pindutin ang **SET** button para i-set ang kasalukuyang oras at lumipat sa pagpili ng minuto.
6. Piliin ang minuto gamit ang **▲** o **▼** button. (Pindutin ang **SET** button para pumunta sa mode ng pag-set ng presyon. Para sa mga detalye, sumangguni sa pahina 14.) Pindutin ang **START** button para i-off ang device.

Tandaan: Pagkalipas ng tatlong minuto na hindi ginagamit, awtomatikong mag-o-off ang device.

Kapag hindi naka-set ang orasan, magpapabatid ng mga gitling ang display ng orasan gaya ng ipinapakita sa kanan.

Kapag gagamitin ang device sa unang pagkakataon, hindi naka-set ang orasan.

Kapag nadiskonekta ang device mula sa power supply nang higit sa 30 segundo, mabubura ang naka-set na petsa, oras at halaga ng presyon.

Kapag nabura ang naka-set na petsa, oras at halaga ng presyon, paki-adjust muli.

- Babaguhin nang tuloy-tuloy ng pagpindot nang matagal sa **▲** o **▼** button ang halaga.



I-off ng pagpindot sa **START** button ang device anumang oras.

Mode ng setting ng presyon

Paggamit sa Monitor

Pagpili sa Wastong Laki ng Cuff

Importanteng gamitin ang wastong laki ng cuff para sa tumpak na basa. Kung hindi wasto ang laki ng cuff, maaaring mali ang maging basa sa halaga presyon ng dugo.

- Naka-print ang laki ng braso sa bawat cuff.
- Nakokonsumo ang cuff sa braso. Kung gamit na gamit na ito, bumili ng panibago.

Laki ng Braso	Inirerekomendang Laki ng Cuff	Numero sa Katalogo
31 cm hanggang 45 cm	Large Adult cuff	CUF-D-LA-ISO
22 cm hanggang 42 cm	Wide range cuff	CUF-I-ISO
23 cm hanggang 37 cm	Semi Large cuff	CUF-D-MA-ISO
22 cm hanggang 32 cm	Adult cuff	CUF-F-A-ISO
16 cm hanggang 24 cm	Maliit na Cuff	CUF-D-SA-ISO
17 cm hanggang 32 cm	SmoothFit Adult cuff	CUF-G-A-ISO

Laki ng braso: Ang sukat palibot ng biceps.

Paglapat ng Cuff sa Braso

1. Ibalot ang cuff sa palibot ng braso, may 1-2 cm sa itaas ng loob ng siko, gaya ng ipinapakita. Ilagay ang cuff nang direkta sa balat, dahil maaaring magdulot ng mahinang pulso ang damit, at magresulta ng error sa pagsukat.
2. Maaaring mapigil ng pagbara sa braso, na dulot ng mahigpit na pagrolyo ng manggas, ang tumpak na basa sa pagsukat.



Mga simbolo na naka-print sa cuff

Mga simbolo	Function/Kahulugan	Inirerekomendang Aksiyon
●	Marka ng Posisyon ng Artery	I-set ang ● marka sa artery ng braso o kapantay ng palasingsingan sa loob ng braso.
[REF]	Numero sa Katalogo	_____
[LOT]	Lot number	_____
[MF]	Pag-manufacture	_____
[MD]	Medikal na Device	_____

Paggamit sa Monitor

Paano Kumuha ng Mga Tumpak na Pagsukat

Para sa pinakatumpak na pagsukat sa presyon ng dugo:

- Umupo nang komportable sa silya. Ilapag ang braso mo sa mesa. Huwag ikrus ang mga paa. Panatilihing nakalapat sa sahig ang mga paa mo at ituwid ang likod mo.
- Mag-relax nang lima hanggang sampung minuto bago pagsukat.
- Ilagay ang gitna ng cuff sa parehong taas ng puso mo.
- Manatiling hindi kumikilos at tahimik habang pagsukat.
- Huwag magsukat agad pagkatapos ng hersisyo o pagligo. Magpahinga nang dalawampu o tatlumpung minuto bago kumuha ng pagsukat.
- Subukang sukatin ang presyon ng dugo mo sa parehong oras bawat araw.

Pagsukat

Habang pagsukat, normal para sa cuff na maging mahigpit. (Huwag mababahala).

Pagkatapos ng Pagsukat

Pagkatapos ng pagsukat, pindutin ang **START** button para i-off ang device.

Alisin ang cuff at itala ang data mo.

Tandaan: Mayroong awtomatikong power shut-off na function ang device, na nag-o-off sa device humigit-kumulang sa isang minuto pagkatapos ng pagsukat.


Magbigay ng tatlong minuto man lang sa pagitan ng mga pagsukat sa parehong tao.

Mga Pagsukat

Bago pagsukat, sumangguni sa "Mga Paalala para sa Tumpak na Pagsukat" sa pahina 15.

Normal na Pagsukat

1. Ilagay ang cuff sa braso (mas mainam sa kaliwang braso).
Maupo nang tahimik habang pagsukat.
2. Pindutin ang **START** button.
Ipinapakita ang lahat na mga bahagi ng display.
Ipinapakita ang zero (0) na panandaliang kumukurap.
Nagbabago ang display, ayon sa ipinababatid sa pigura sa kanan, sa pagsisimula ng pagsukat. Magsisimulang magkarga ng hangin ang cuff. Normal para sa cuff na maging mahigpit. Isang indicator ng pressure bar ang ipapakita, sa kaliwang gilid ng display, habang pagkarga ng hangin.
Tandaan: Kung nais mong ihinto ang pagkarga ng hangin sa anumang oras, pindutin muli ang **START** button.
3. Kapag tapos nang pagkarga ng hangin, awtomatikong magsisimula ang pagsingaw ng hangin at kukurap ang **♥** (marka ng puso), na nagpapabatid na isinasagawa na ang pagsukat. Sa sandaling madetekta ang pulso, kukurap ang marka kasabay ng bawat pitik ng pulso.
Tandaan: Kung hindi makamit ang angkop na presyon, awtomatikong magsisimula muli na magkarga ng hangin ang device.
Para maiwasan ang muling pagkarga ng hangin, sumangguni sa "Pagsukat gamit ang NAKA-SET na Presyon" sa susunod na pahina.

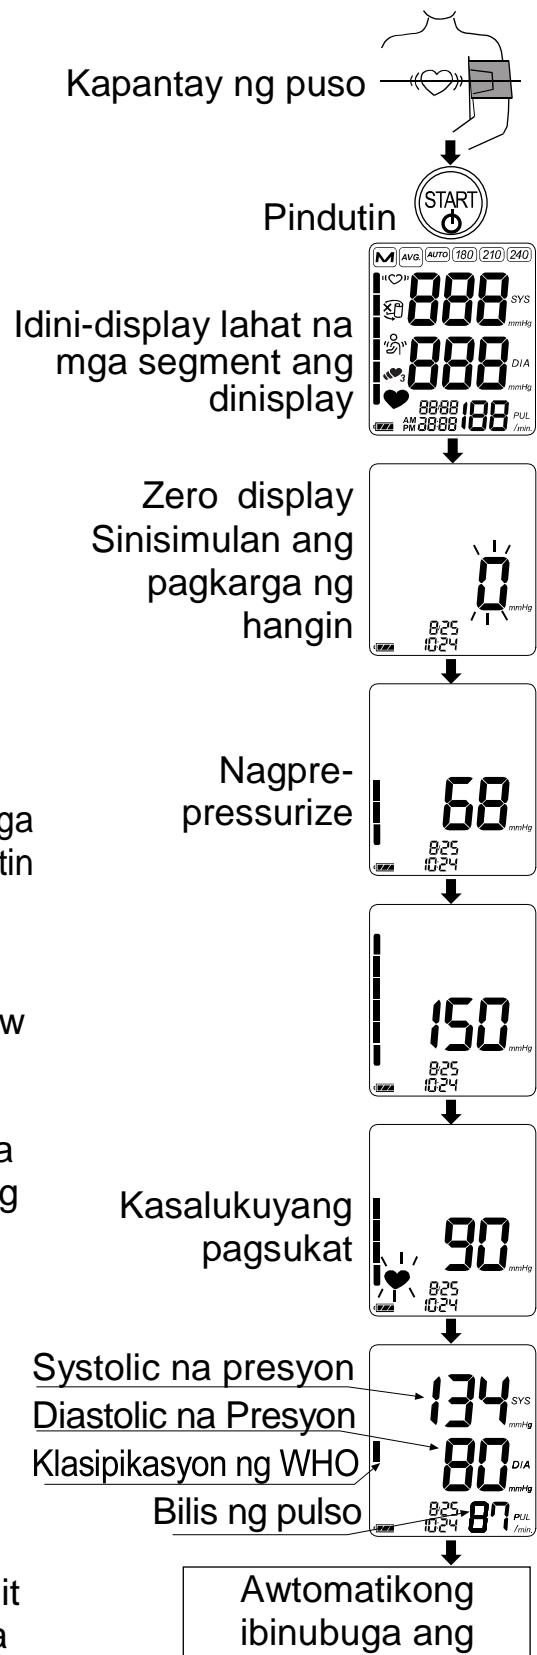

4. Kapag tapos na ang pagsukat, ipapakita ang mga basa sa systolic at diastolic na presyon at bilis ng pulso.
Papakawalan ng cuff ang nalalabing hangin at ganap nang mawawalan ng hangin.
5. Pindutin ang **START** button para i-off ang device.
Pagkalipas ng isang minuto na hindi ginagamit, awtomatikong mag-o-off ang device.

Tandaan: Magbigay ng tatlong minuto man lang sa pagitan ng mga pagsukat sa parehong tao.


Mga Pagsukat

Idiniseryo ang UA-1020 na awtomatikong magdetekta ng pulso at kargahan ng hangin ang cuff hanggang sa level ng systolic na presyon. Kung paulit-ulit ang muling pagkarga ng hangin, gamitin ang mga sumusunod na paraan.

Pagsukat gamit ang NAKA-SET na Presyon

Habang pagsukat sa presyon ng dugo, maaaring maganap ang muling pagkarga ng hangin.
Maaaring mag-set ng nakatakdang halaga ng presyon para maiwasan ang muling pagkarga ng hangin.

1. Sa hakbang 6 ng proseso ng pag-adjust sa orasan (sumangguni sa pahina 10), pindutin ang **SET** button para pumunta sa pressure setting mode. Kumukurap ang kasalukuyang setting.
2. Pindutin ang **▲** o **▼** button para pumili ng halaga ng presyon na nasa 30 mmHg o higit pa na mas mataas kaysa sa inaasahang systolic na presyon mula sa sumusunod.
 - AUTO**: Awtomatikong pag-pressurize (default na halaga)
 - 180**: Halaga ng presyon na 180 mmHg (naka-fix)
 - 210**: Halaga ng presyon na 210 mmHg (naka-fix)
 - 240**: Halaga ng presyon na 240 mmHg (naka-fix)
3. Pindutin ang **SET** button para pumunta sa TriCheck™ setting mode. Pindutin ang **START** button para i-off ang device. Pagkalipas ng tatlong minuto na hindi ginagamit, awtomatikong mag-o-off ang device. Ang susunod na pagsukat ay isasagawa gamit ang bagong halaga ng presyon.

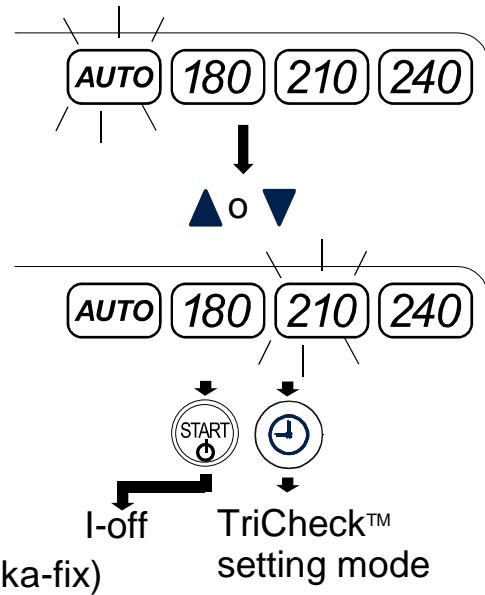


Pagsukat na may Ninanais na Systolic na Presyon

Gamitin ang paraan na ito kapag paulit-ulit na nagaganap ang muling pagkarga ng hangin kahit na naka-set ang halaga ng presyon sa **240** sa proseso sa itaas o kapag hindi ipinapakita ang resulta kahit na bumaba ang presyon sa 20 mmHg o mas mababa pa.

1. Ilagay ang cuff sa braso (mas mainam sa kaliwang braso).
2. I-press and hold ang **START** button hangang sa lumitaw ang numero na may 30 hanggang 40 mmHg na mas mataas kaysa sa inaabahang systolic na presyon.
3. Kapag naabot na ang gustong numero, bitiwan ang **START** button para simulan ang pagsukat. Patuloy na sukatin ang presyon ng dugo mo gaya ng inilarawan sa naunang pahina.

Kapantay ng puso



Bitiwan ang button sa ninanais na systolic na



Sumangguni sa naunang pahina para sa pagsukat

Mga Paalala para sa Tumpak na Pagsukat

- Umupo sa komportableng posisyon. Ilapag ang braso mo sa mesa na nakatihaya ang palad at kapantay ng cuff ang puso mo.
- Mag-relax nang mga lima hanggang sampung minuto bago kumuha ng pagsukat. Kung excited o depressed ka dahil sa emosyonal na stress, makikita ang stress na ito bilang mas mataas (o mas mababa) kaysa sa normal na basa ng presyon ng dugo at karaniwang mas mabilis ang basa sa pulso kaysa sa normal.
- Palaging nagbabago ang presyon ng dugo ng isang indibidwal, depende sa kung ano ang ginagawa mo at kung ano ang kinain mo. Ang iniinom mo ay maaaring magkaroon ng napakalakas at mabilis na epekto sa presyon ng dugo mo.
- Binabatay ng device na ito ang mga pagsukat sa tibok ng puso. Kung napakahina o hindi regular na pagtibok ng puso mo, maaaring mahirapan ang device na matukoy ang presyon ng dugo mo.
- Kung may madetekta ang device na hindi normal na kondisyon, ihihinto nito ang pagsukat at nagdi-display ng simbolo ng error. Sumangguni sa pahina 6 para sa paglalarawan sa mga simbolo.
- Inilaan ang device na ito na gamitin ng mga nasa hustong gulang. Kumonsulta sa doktor mo bago gamitin ang device na ito sa bata. Hindi dapat gamitin ng isang bata ang device na ito nang walang nagbabantay.
- Maaaring maapektuhan ang paggana ng awtomatikong monitor ng presyon ng dugo ng labis na init o halumigmig, o taas ng lugar.

TriCheck™ na Pagsukat


Awtomatikong kumukuha ng tatlong magkakasunod na pagsukat ang TriCheck™ mode at ipinapakita ang mga average na halaga ng tatlong pagsukat.

Pagpili sa TriCheck™ Mode

1. Sa mode ng setting ng presyon, pindutin ang **SET** button para pumasok sa TriCheck™ setting mode. Kumukurap ang kasalukuyang setting.
2. Pindutin ang **▲** o **▼** button para i-ON o i-OFF ang TriCheck™ mode.
ON: TriCheck™ mode
OFF: Mode ng normal na pagsukat (default na halaga)
3. Pindutin ang **START** o **SET** button para i-off ang device.
Pagkalipas ng tatlong minuto na hindi ginagamit, awtomatikong mag-o-off ang device.


Mode ng setting ng presyon,

Pindutin 



Kumukurap ang kasalukuyang setting

 o 
Baguhin ang setting




Pagsukat Gamit ang TriCheck™ Mode

1. Pindutin ang **START** button. Ipinapakita ang lahat na mga bahagi ng display. Ipinapakita ang zero (0) na panandaliang kumukurap at magsisimula ang unang pagsukat.
2. Kapag tapos na ang pagsukat, ipapakita ang mga basa sa systolic at diastolic na presyon at bilis ng pulso, tapos magsisimula ang isang minutong pag-countdown para sa ikalawang pagsukat.
3. Pagkalipas ng isang minuto, magsisimula ang ikalawang pagsukat.
4. Kapag tapos na ang pagsukat, ipapakita ang mga average na reading ng una at ikalawang pagsukat, tapos magsisimula ang isang minutong pag-countdown para sa ikalawang pagsukat.
5. Pagkalipas ng isang minuto, magsisimula ang ikatlong pagsukat.
6. Kapag tapos na ang pagsukat, ipapakita ang mga average na reading ng tatlong pagsukat at iimbak ito sa memory.

Mga Tatandaan:


- Habang pagsukat, ipapakita ang Simbolo ng TriCheck™.
- Para kanselahanin ang pagsukat, pindutin ang **START** button. Sa ganitong kaso, walang iniimbak na data sa memory.
- Kapag lumitaw ang simbolo ng error sa sukat ng cuff sa unang pagsukat, kanselahanin ang pagsukat, muling ikabit ang cuff nang wasto at i-start ng panibagong pagsukat.
- Pagkatapos ng pagsukat, iimbak sa memorya ng average na data ng tatlong pagsukat. Walang data na iimbak, kapag kinakansela ang mga pagsukat, bago matapos ang ikatlong pagsukat.

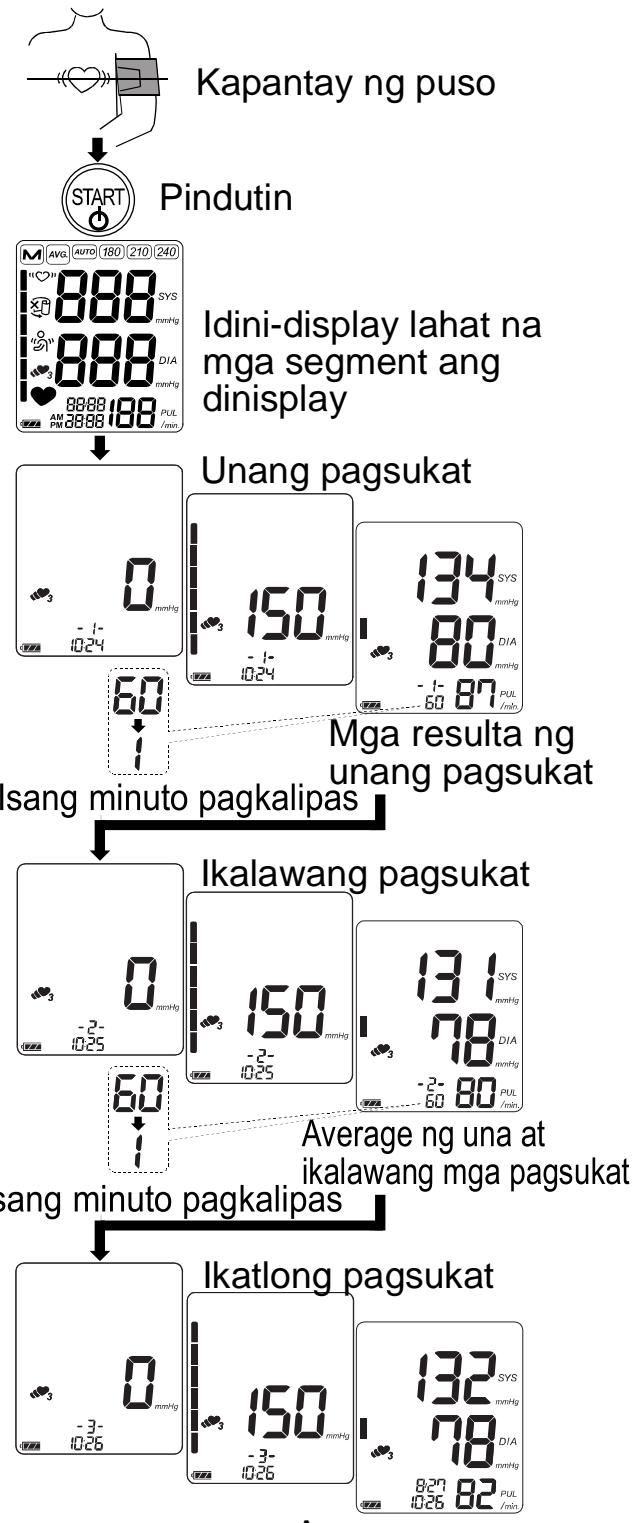

Pag-recall sa Data ng Memory

Tandaan: Iniiimbak ng device na ito sa memory ang huling 90 na pagsukat.

1. Pindutin ang **▲** o **▼** button. Ipinapakita ang average ng lahat na pagsukat at bilang ng data. (Kung walang data, "0" ang ipapakita. Pindutin ang **▲**, **▼** o **START** button para i-off ang device.)
2. Sa tuwing pipindutin ang **▼** button (o ang **▲** button para ipakita ang data nang pabalik ang pagkasunod-sunod), idi-display ang data ng memory gaya ng sumusunod.
Average ng lahat na AM (morning) na pagsukat sa pagitan ng 4:00 at 9:59. (Sa halimbawa, 10 pagsukat. Kung walang data, "--" ang ipapakita.)
Average ng lahat na PM (gabi) na pagsukat sa pagitan ng 18:00 at 1:59. (Sa halimbawa, 9 na pagsukat. Kung walang data, "--" ang ipapakita.)
Pinakahuling data (No.n, in the halimbawa, No.35)
Tatlong segundo pagkaraang ipakita ang numero ng data, i-display ang data ng pagsukat.
Huling data (No.1)
Tatlong segundo pagkaraang ipakita ang numero ng data, i-display ang data ng pagsukat.
3. Pagkaraang ipakita ang huling data, pindutin ang **▼** button para ibalik ang average na display ng lahat na pagsukat.
4. Pindutin ang **START** button para i-off ang device. Pagkalipas ng isang minuto na hindi ginagamit, awtomatikong mag-o-off ang device.

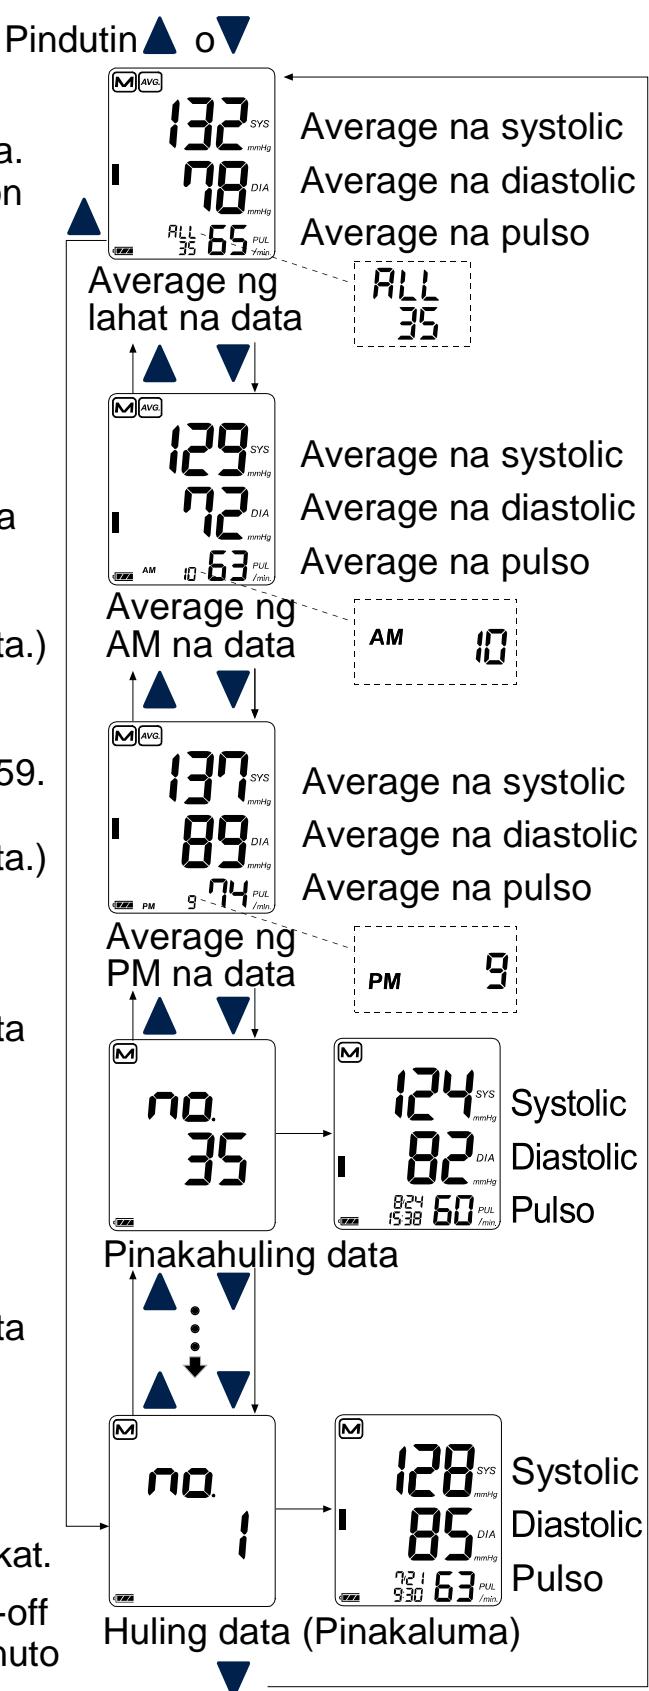

Ano ang Indicator ng IHB/AFib?

Kapag may nadetecta ang monitor na hindi regular na ritmo habang pagsukat, lilitaw ang indicator ng IHB/AFib sa display kasama ng mga halaga ng pagsukat.


Tandaan: Inirerekомenda namin na makipag-ugnayan sa doktor mo kung madalas mong makita ang Indicator ng IHB/AFib na ito.

Ano Ang AFib?

Nagsisikap ang puso dahil sa mga electrikal na signal na nagaganap sa puso at nagpapadala ito ng dugo sa buong katawan. Nangyayari ang Atrial fibrillation (AFib) kapag nalilito ang electrikal na signal sa atrium at nauuwi sa kaguluhan sa pagitan ng pulso. Puwedeng magdulot ang AFib ng pananatili ng dugo sa puso, na madaling makalilikha ng mga pamumuo ng dugo, na isang dahilan ng stroke at atake sa puso.

Indicator ng Pressure Bar

Sinusubaybayan ng indicator ang progreso ng presyon habang pagsukat.

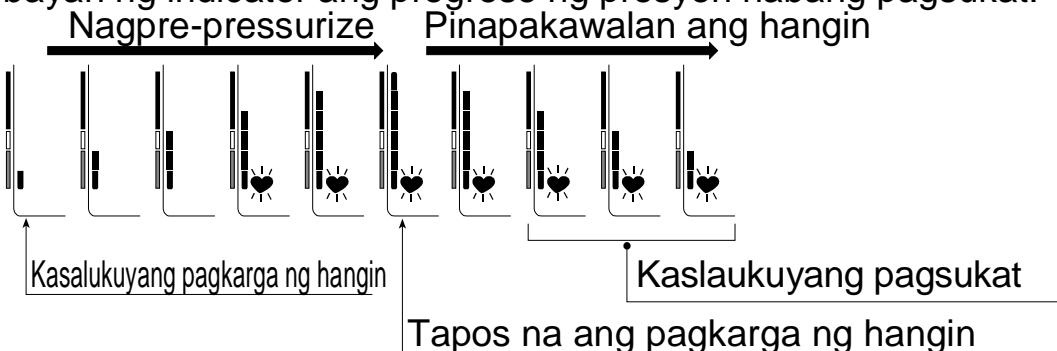

Indicator ng Klasipikasyon ng WHO

Bawat bahagi ng bar indicator ay katumbas ng klasipikasyon ng WHO sa presyon ng dugo na inilalarawan sa susunod na pahina.

Indicator ng Klasipikasyon ng WHO

- Malubhang alta-presyon
- Katamtamang alta-presyon
- Banayad na alta-presyon
- Mataas na normal
- Normal
- Optimal

- : Nagpapakita ng segment ang indicator, batay sa kasalukuyang data, na katumbas ng klasipikasyon ng WHO.

Halimbawa:



Katamtamang alta-presyon



Banayad na alta-presyon



Mataas na normal

Tungkol sa Presyon ng Dugo

Ano ang Presyon ng Dugo?

Ang presyon ng dugo (blood pressure) ay ang pwersa ng dugo sa mga talakop ng mga artery. Nagaganap ang systolic na presyon kapag naghigpit ang puso. Nagaganap ang diastolic na presyon kapag nagluwag ang puso. Nasusukat ang presyon ng dugo sa millimeters of mercury (mmHg). Kinakatawan ng fundamental pressure ang natural na presyon ng dugo ng isang tao, na nasusukat sa paggising sa umaga habang nakapahinga at bago kumain.

Ano ang Alta-presyon (Hypertension) at Paano ito Kinokontrol?

Ang Hypertension (Alta-presyon), isang hindi normal na taas ng arterial na presyon ng dugo, kung hindi kokontrolin, ay maaaring magdulot ng maraming problema sa kalusugan kabilang ang stroke at atake sa puso. Nakokontrol ang alta-presyon sa pamamagitan ng pagbago sa pamumuhay, pag-iwas sa stress, at paggagamot na may pagbabantay ng doktor.

Para mapigilan ang alta-presyon o kontrolin ito:


- Huwag magsigarilyo Regular na mag-ehersisy
- Bawasan ang kinakain na asin at fat
- Regular na magpa-physical checkup
- Magpanatili ng wastong timbang

Bakit Dapat Magsukat ng Presyon ng Dugo sa Tahanan?

Ang presyon ng dugo na sinukat sa isang klinika o tanggapan ng doktor ay maaaring magdulot ng pagkabahala at maaaring magbigay ng mataas na basa, 25 hanggang 30 mmHg na mas mataas kaysa sa sinukat sa tahanan. Binabawasan ng pagsukat sa tahanan ang mga epekto ng mga panlabas na salik sa mga basa sa presyon ng dugo, nakadaragdag sa mga basa ng doktor at nakapagbibigay ng mas tumpak, at kumpletong kasaysayan ng presyon ng dugo.

Klasipikasyon ng WHO sa Presyon ng Dugo


Itinatag ng World Health Organization (WHO) ang mga pamantayan para sa mataas na presyon ng dugo, nang walang pasubali sa edad, gaya ng ipinapakita sa talaan.

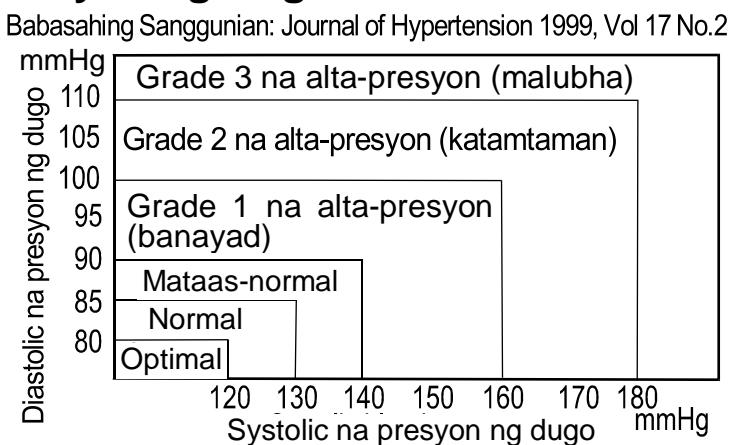

Mga Pagkakaiba-iba ng Presyon ng Dugo

Malaki ang pagkakaiba-iba ng presyon ng dugo ng isang indibidwal sa batayang kada araw at pana-panahon. Maaari itong mag-iba nang 30 hanggang 50 mmHg dahil sa iba-ibang kondisyon sa buong araw. Sa mga indibidwal na may alta-presyon, lalo pang lumalaki ang mga pagkakaiba-iba. Sa karaniwan, tumataas ang presyon ng dugo habang nagtatrabaho o naglalaro at bumababa sa pinakamababa nitong mga level habang natutulog. Kaya, huwag gaanong mag-alala sa mga resulta ng isang pagsukat.

Kumuha ng mga pagsukat sa parehong oras bawat araw gamit ang pamamaraan na nasa manwal na ito para malaman ang normal na presyon ng dugo mo. Nagbibigay ang mga regular na pagsukat ng mas komprehensibong kasaysayan ng presyon ng dugo. Tiyakin na tandaan ang petsa at oras kapag itinatala ang presyon ng dugo mo. Kumonsulta sa doktor mo para mabigyan ng paliwanag ang data ng presyon ng dugo mo.

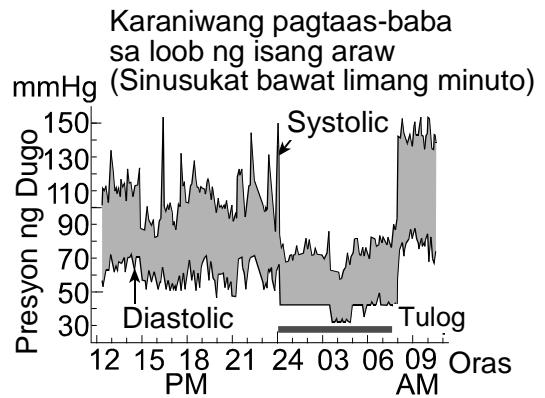

Pag-troubleshoot

Problema	Posibleng Dahilan	Inirerekomendang Aksyon
Walang lumilitaw sa display, kahit na naka-on ang device.	Wala nang karga ang mga baterya. Wala sa tamang posisyon ang mga terminal ng baterya.	Palitan ng bago ang lahat na mga baterya. Muling ikabit ang mga baterya na tumutugma ang mga negative at positive na terminal sa mga isinaad na sisidlan ng baterya.
Hindi nagkakarga ng hangin ang cuff.	Napakababa ng boltahe ng baterya. Kumukurap ang  (Markang MAHINA ANG BATERYA). Kung ganap nang walang karga ang mga baterya, hindi lilitaw ang marka.	Palitan ng bago ang lahat na mga baterya.
Hindi nagsusukat ang device. Napakataas o napakababa ng mga basa.	Hindi nakalapat nang wasteo ang cuff. Iginalaw mo ang braso o katawan mo habang pagsukat. Hindi wasteo ang posisyon ng cuff.	Ilapat nang wasteo ang cuff. Tiyakin na mananatili kang hindi kumikilos at tahimik habang pagsukat. Maupo nang komportable at hindi kumikilos. Ilapag ang braso mo sa mesa na nakatihaya ang palad at kapantay ng cuff ang puso mo.
Iba pa	Naiiba ang basa sa sinukat sa klinika o tanggapan ng doktor.	Sumangguni sa "Bakit Dapat Magsukat ng Presyon ng Dugo sa Tahanan?". Alisin ang mga baterya. Ikabit muli nang wasteo ang mga ito at subukang muli ang pagsukat.

Tandaan: Kung hindi malutas ng mga inilarawang aksyon sa itaas ang problema, makipag-ugnayan sa dealer. Huwag tangkain na buksan o kumpunihin ang produktong ito, dahil magiging hindi balido ang warranty mo kung gagawin ito.

Pagmamantini

Huwag bubuksan ang device. Gumagamit ito ng maseselan na mga piyesang elektrikal at mabusising air unit na maaaring masira. Kung hindi mo maayos ang problema gamit ang mga tagubilin sa pag-troubleshoot, makipag-ugnayan sa awtorisadong dealer sa inyong lugar o sa aming customer service department. Magbibigay ang customer service ng A&D ng teknikal na impormasyon, mga piyesang pamalit at mga unit sa mga awtorisadong dealer.

Idiniseno at binuo ang device para sa mahabang serbisyo. Gayunpaman, karaniwang inirerekомenda na ipasuri ang device bawat 2 taon, para matiyak ang wastong paggana at katumpakan. Makipag-ugnayan sa awtorisadong dealer sa inyong lugar o sa A&D para sa pagmamantini.

Teknikal na Data

Type	UA-1020
Paraan ng pagsukat	Oscillometric na pagsukat
Saklaw ng pagsukat	Pressure: 0 - 299 mmHg Systolic na presyon: 60 - 279 mmHg Diastolic na presyon: 40 - 200 mmHg Pulso: 40 - 180 tibok / minuto
Katumpakan ng pagsukat	Pressure: ±3 mmHg Pulso: ±5 %
Saklaw ng rating	DC 6V 3W
Power supply	4 x 1.5V na mga bateria (R6P, LR6 o AA) o AC adapter (TB-233C INPUT: AC 100 – 240V 50 / 60 Hz 0.15A) (Hindi kasama)
Bilang ng mga pagsukat	Humigit-kumulang 1000 na pagsukat, kapag AA na mga alkaline battery ang ginagamit, na may halaga ng presyon na 180 mmHg sa temperatura ng silid na 23°C
Klasipikasyon	Internally powered Kagamitang ME (Mula sa mga bateria) / Class II (Mula sa adapter) Continuous operation mode

Klinikal na pagsubok	Ayon sa ISO81060-2 : 2013 Sa klinikal na pag-aaral para sa pag-validate, ginamit ang K5 sa 85 katao para sa pagtukoy ng diastolic na presyon ng dugo.																
EMD	IEC 60601-1-2: 2014																
Memory	Huling 90 na pagsukat																
Kondisyon sa paggamit	+10 hanggang +40 °C / 15 hanggang 85 %RH / 800 hanggang 1060 hPa																
Mga kondisyon sa Pagdala / Pagtago	-20 hanggang +60 °C / 10 hanggang 95 %RH / 700 hanggang 1060 hPa																
Mga dimensyon	Humigit-kumulang 140 [W] x 60 [H] x 105 [D] mm																
Timbang	Humigit-kumulang 285 g, hindi kasama ang mga baterya																
Proteksiyon sa pagsuot	Device: IP20																
Bahaging inilalapat	Cuff Type BF 																
Kapaki-pakinabang na buhay	Device: 5 taon (kapag ginagamit nang anim na beses sa isang araw) Cuff: 2 taon (kapag ginagamit nang anim na beses sa isang araw) AC adapter: 5 taon (kapag ginagamit nang anim na beses sa isang araw)																
Aksesorya AC adapter	Ang adapter ay para ikabit ang monitor ng presyon ng dugo sa pagkukunan ng kuryente sa tahanan.																
TB-233C	Makipag-ugnayan sa inyong lokal na dealer ng A&D para sa pagbili. Kinakailangang masuri o mapalitan ang AC adapter paminsan-minsan.																
Mga simbolo na naka-print sa AC adapter																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mga simbolo</th> <th>Function / Kahulugan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Para sa indoor na paggamit lang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Class II na device</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Thermal fuse</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fuse</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Label ng EC directive ng device</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Label ng EAC certification ng device</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Polarity ng plug na AC adapter</td> </tr> </tbody> </table>		Mga simbolo	Function / Kahulugan		Para sa indoor na paggamit lang		Class II na device		Thermal fuse		Fuse		Label ng EC directive ng device		Label ng EAC certification ng device		Polarity ng plug na AC adapter
Mga simbolo	Function / Kahulugan																
	Para sa indoor na paggamit lang																
	Class II na device																
	Thermal fuse																
	Fuse																
	Label ng EC directive ng device																
	Label ng EAC certification ng device																
	Polarity ng plug na AC adapter																

Hiwalay na binebenta ang mga aksesorya

Cuff

Numero sa Katalogo	Laki ng Cuff	Laki ng Braso
CUF-D-LA-ISO	Large Adult cuff	31 cm hanggang 45 cm
CUF-I-ISO	Wide range cuff	22 cm hanggang 42 cm
CUF-D-MA-ISO	Semi Large cuff	23 cm hanggang 37 cm
CUF-F-A-ISO	Adult cuff	22 cm hanggang 32 cm
CUF-D-SA -ISO	Maliit na Cuff	16 cm hanggang 24 cm
CUF-G-A-ISO	SmoothFit Adult cuff	17 cm hanggang 32 cm

AC adapter

Numero sa Katalogo	Plug (Uri ng Saksakan)
TB-233C	Type C

Tandaan: Sasailalim sa mga pagbabago ang mga partikular nang walang paunang abiso.

Ang IP classification ay ang bilang ng proteksyon na hatid ng mga takip alinsunod sa IEC 60529. Protektado ang device na ito laban sa mga solidong bagay na may 12 mm ang diameter at higit pa gaya ng daliri. Hindi protektado ang device na ito laban sa tubig.

MEMO



A&D Company, Limited

1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585 Japan
Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119

A&D INSTRUMENTS LIMITED

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxon, OX14 1DY,
UNITED KINGDOM
Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485

A&D Engineering, Inc.

4622 Runway Boulevard Ann Arbor, MI 48108 USA
Telephone: [1] (888) 726-9966

A&D AUSTRALASIA PTY LTD

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409

ООО А&Д RUS ООО "ЭЙ энд ДИ РУС"

121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17
(Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17)
тел.: [7] (495) 937-33-44 факс: [7] (495) 937-55-66

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd 爱安德技研贸易（上海）有限公司

中国 上海市自由贸易试验区浦东南路855号世界广场32楼C, D室 邮编200120
(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone,
200120, China)
电话: [86] (21) 3393-2340 传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED ऐंडी इन्स्ट्रुमेन्ट्स इण्डिया प्रा० लिमिटेड

509, उद्योग विहार , फेस -5, गुडगांव – 122016, हरियाणा , भारत
(509, Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon – 122 016, Haryana, India)
फोन : 91-124-4715555 फैक्स : 91-124-4715599